



# ABUTMENT COMPATIBILI



CATALOGO

ABUTMENT   
COMPATIBILI.COM



Con un'offerta di Dispositivi Implantologici di altissima qualità, compatibili con i Sistemi di Implantologia più conosciuti nel mondo, la **Biaggini Medical Devices** entra decisa nel mondo del E-Commerce, con il proprio brand **AbutmentCompatibili.com**, e una organizzazione produttiva, logistica e di assistenza senza precedenti.

La programmazione della produzione, la tempestività del servizio, la qualità del prodotto, la qualità dell'informazione, dell'assistenza, non bastano a definire questo fenomeno commerciale che ha rotto tutti i confini dell'area di mercato di un'Azienda che ha dedicato allo sviluppo dell'implantologia in Italia, a partire dal 1987, tante risorse e passione.

Dai primi anni di ricerca e sviluppo del prodotto si è arrivati oggi ad un deciso sviluppo del mercato, un mercato alimentato dalla ricerca e globalizzazione della produzione e dai metodi più moderni di distribuzione.

Oggi **Biaggini Medical Devices** con il suo catalogo di dispositivi protesici Vi raggiunge ovunque siate in poche ore, vi può assistere con una competenza anch'essa globale, la competenza essenziale per un mercato senza confini, il mercato più esigente che mai abbia conosciuto.

L'Azienda intera è felice di potervi mettere a disposizione tutta la competenza necessaria a comprendere le vostre richieste nel modo più semplice, attraverso il contatto diretto telefonico, il grande valore aggiunto del nostro metodo On-Line.

Con questo nostro nuovo catalogo chiunque potrà testare, apprezzare l'intensità, la forza della nostra proposta per una profonda e reciproca conoscenza.

Per questo oggi, assieme a Voi, possiamo rivolgerci al futuro.

*Dr. Piero Biaggini*

Distributore esclusivo per l'Italia: IPD 2004





Catalogo interattivo: Fare click con il mouse sulla sezione desiderata.

<b>AA</b>	Nobel Biocare Branemark	11
<b>AC</b>	Nobel Replace Select	15
<b>AD</b>	Nobel Active CC Conical Connection	19
<b>BA</b>	Biomet 3i Esagono Esterno	25
<b>BB</b>	Biomet 3i Certain	29
<b>DA</b>	Straumann Tissue Level	35
<b>DB</b>	Straumann Bone Level	39
<b>EA</b>	Astra Osseospeed Tx	45
<b>EB</b>	Astra Evolution EV	49
<b>IA</b>	Dentsply Friadent Xive	53
<b>IB</b>	Dentsply Friadent Ankilos C/X	55
<b>FA</b>	Zimmer ScrewVent	59
<b>LB</b>	Biohorizons	65
<b>MB</b>	Sweden & Martina Premium Kohno	71
<b>GB</b>	BTI Interna Universal	77



Catalogo interattivo: Fare click con il mouse sulla sezione desiderata.

	Multi Unit MUA	83
	Sistema PSD	89
	Sistema IPD	93
	Viti TPA	104
	Viti	105
	Strumenti e Accessori	108
	Condizioni di Vendita	111
	Listino Prezzi	113





Hollow Screw System® è stato progettato per essere utilizzato con le basi da incollaggio CAD-CAM, fornendo un ancoraggio meccanico provvisorio della protesi alla base da incollaggio senza bisogno di adesivi.

La sua caratteristica principale è il fatto di essere una ghiera cava che consente il transito della vite passante dell'impianto, per fissare o allentare la base da incollaggio alla fixture.

Ciò consente di trasferire il sistema protesi/interfaccia già assemblato, dal laboratorio alla bocca del paziente per effettuare i test occlusali e di adattamento protesico e di effettuare eventuali modifiche in numero illimitato.

Questo nuovo concetto semplifica notevolmente il lavoro in laboratorio, in quanto non vi è necessità di cementazione temporanea, con tutti i problemi e gli svantaggi che ciò comporta.


In entrambi i casi, la cementazione permanente può essere fatta in laboratorio, facilitando il lavoro dello specialista clinico.

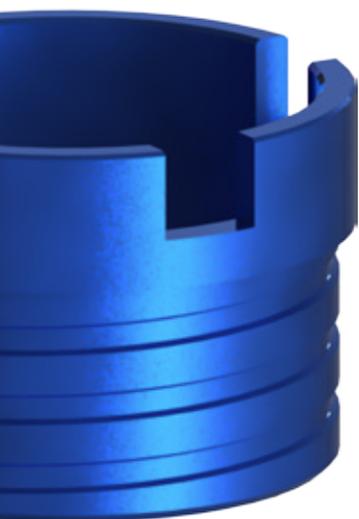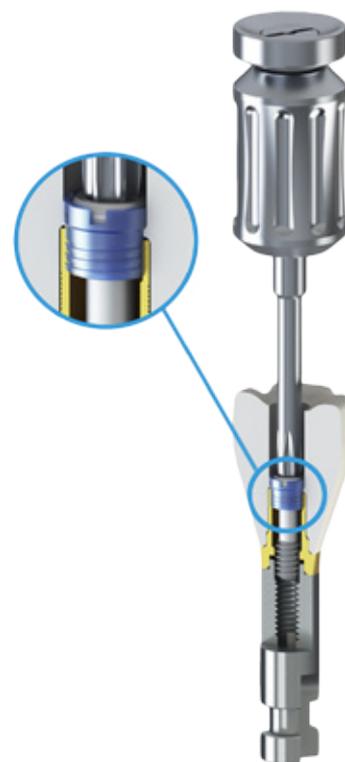

Hollow Screw System® è realizzato in titanio grado 5, garantendo così una totale biocompatibilità e consentendo, a discrezione, la possibilità di lasciare in permanenza il dispositivo nella bocca del paziente, fungendo da complemento alla cementazione e migliorando la stabilità, l'affidabilità e la durata della struttura. Il dispositivo è azzurro anodizzato per facilitarne la rilevazione.


Questo sistema di ancoraggio è completato da un cacciavite appositamente progettato, esso ha un design pratico ed ergonomico che facilita la presa e la ritenzione del dispositivo, grazie alla forma di croce conica con riduzione di diametro che funge da guida per facilitare la presa.

Detto cacciavite è dotato di attacco RA che ne consente l'inserzione in tutte le più comuni tipologie di manici, manipoli e contrangoli dentali.

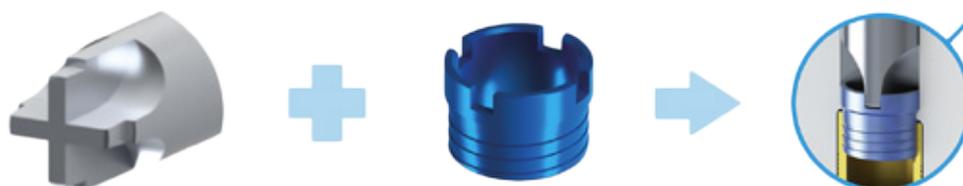

- CAD-CAM: consente di semplificare il processo di scansione in laboratorio, facilitando la manipolazione degli allegati.
- Senza cementazione provvisoria: Non esiste alcuna necessità di cementazione provvisoria in nessuna delle fasi di regolazione della protesi: Prova metallo, prova biscotto e prova occlusione.
- Senza ossidazione: poiché l'interfaccia non richiede di essere riscaldata nel forno per rimuovere il cemento temporaneo, non esiste alcuna ossidazione sulla sua superficie. Mantiene l'integrità dimensionale e il colore delle superfici, ottenendo un aspetto superiore e una regolazione più precisa con l'impianto.
- Meno tempo e costi: il tempo ed il costo di lavoro di laboratorio si riducono in quanto non c'è bisogno di eliminare la cementazione provvisoria.
- Sistema di fissaggio di sicurezza: Essendo realizzato in titanio grado 5, può essere lasciato in modo permanente nella bocca del paziente come elemento di sicurezza complementare, mantenendo inoltre il manufatto libero dall'eccesso di cemento. In nessun caso sostituisce la cementazione permanente che ancora la protesi all'interfaccia.
- Differenti altezze gengivali: offre una soluzione praticamente per tutti i casi clinici e consente di mantenere il cemento lontano dai tessuti.
- Ritenzione: Le incisioni sulle superfici offrono una ritenzione supplementare al cemento, che consente di evitare il processo di sabbiatura.
- Rivestimento TiN: Il rivestimento di nitruro di titanio dorato offre un colore più caldo e naturale per il restauro, oltre ad essere chimicamente inerte e uniforme riduce l'aderenza batterica.
- Spessore ceramico superiore: le sue pareti parallele permettono un apporto di ceramica più spesso, riducendo le ombre anche in restauri complessi.
- Connessioni standardizzate: consente di ridurre lo stoccaggio di componenti necessari. Di conseguenza il sistema di interfaccia IPD è il sistema di interfaccia più conveniente sul mercato.

## Vantaggi

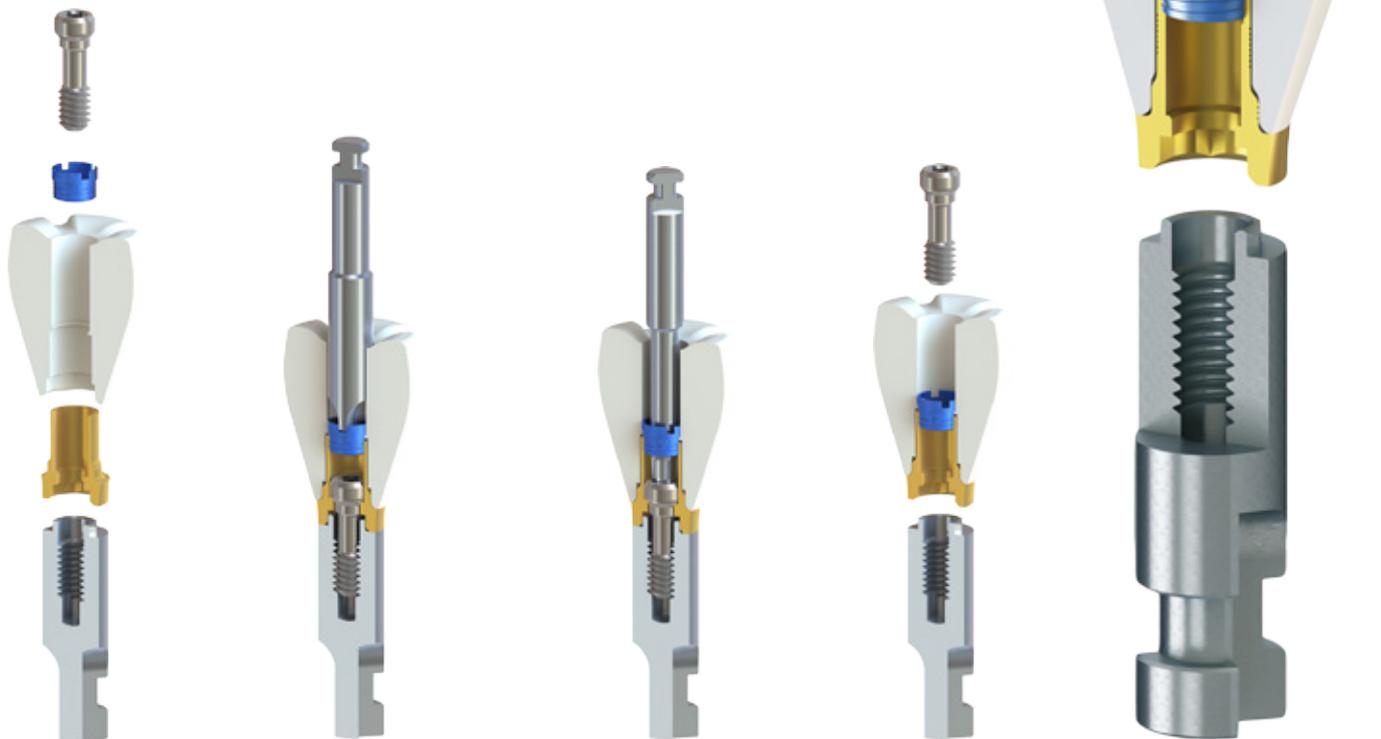

← TORNA ALL'INDICE



Le vite TPA per la protesi angolata permettono di correggere l'asse implantare riportandolo in una posizione protesica più corretta, al fine di migliorare la funzionalità e l'estetica.

Le vite sono utilizzate con un cacciavite "Torx ellittico" che consente di avvitare fino ad un angolo di 28°.

Il cacciavite, lungo 25 mm, ha un punto di rottura controllato il quale assicura che in caso di serraggio eccessivo non si vada a danneggiare la vite mentre sarà il cacciavite a fratturarsi in detto punto.

Tutte le vite TPA mantengono lunghezze ed ingaggi invariati rispetto alle controparti originali e possono essere utilizzate con qualsiasi libreria implantare CAD-CAM compatibile con il sistema a disposizione, senza richiedere alcuna libreria o programma aggiuntivo.

Il rivestimento TiN, applicato alla vite TPA, riduce il rischio di allentamento, evita la deformazione laterale del filetto, aumenta il pre-carico e la resistenza alle fratture e, in aggiunta, riduce l'adesione batterica.

La vite TPA può essere usata sia con le basi da incollaggio coordinate che con gli abutment angolati da sovrapposizione con base in Co-Cr.



La vite TPA può essere usata sia con:

**le basi da incollaggio coordinate** che con **gli abutment angolati da sovrapposizione con base in Co-Cr.**

## AsseAngolato 360 CoCr (Cromo Cobalto da sovrapposizione)

## AsseAngolato IPD



AsseAngolato 360 CoCr 15°

AsseAngolato 360 CoCr 25°



AsseAngolato IPD  
Non Rotante

Scan Abutment  
Non Rotante

AsseAngolato IPD  
Rotante

Scan Abutment  
Rotante


# Protocollo protesico - Fasi di laboratorio



ODT. Emanuele GIUNCHI

Ravenna • Italy

*Ponte in zirconia avvitato e realizzato su monconi MultiUnit, sono state utilizzate le basi da incollaggio AsseAngolato IPD® e il relativo protocollo di scansione: L'utilizzo degli scan abutments e del Hallow Screw hanno permesso lavorazioni di laboratorio e alla poltrona semplici e precise.*

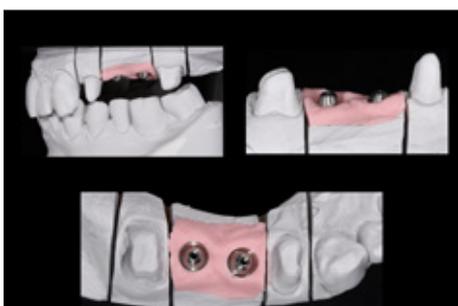


01




02




03

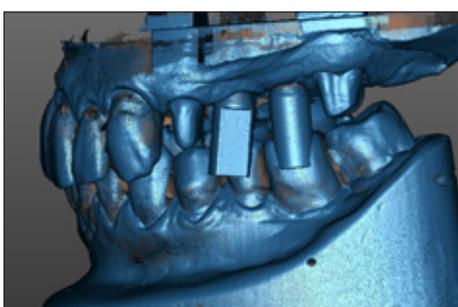

04

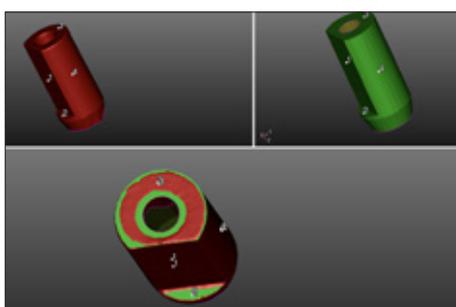


05

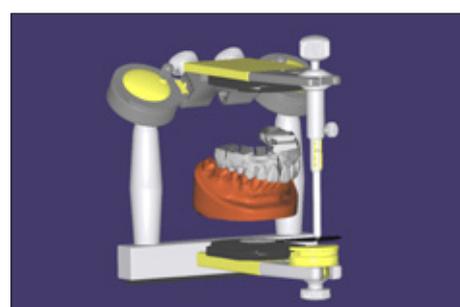

06



07

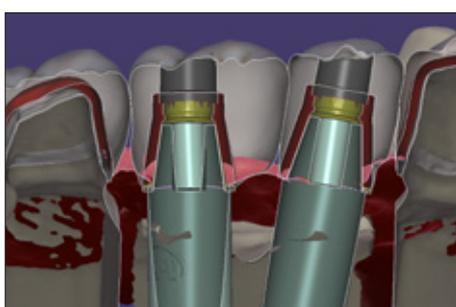

08




09



10




11

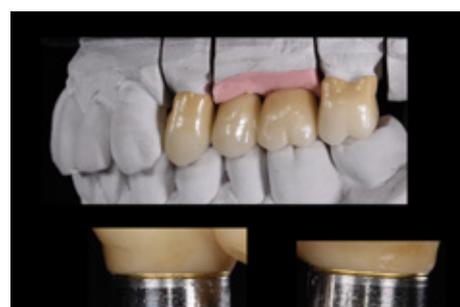

12

[← TORNA ALL'INDICE](#)

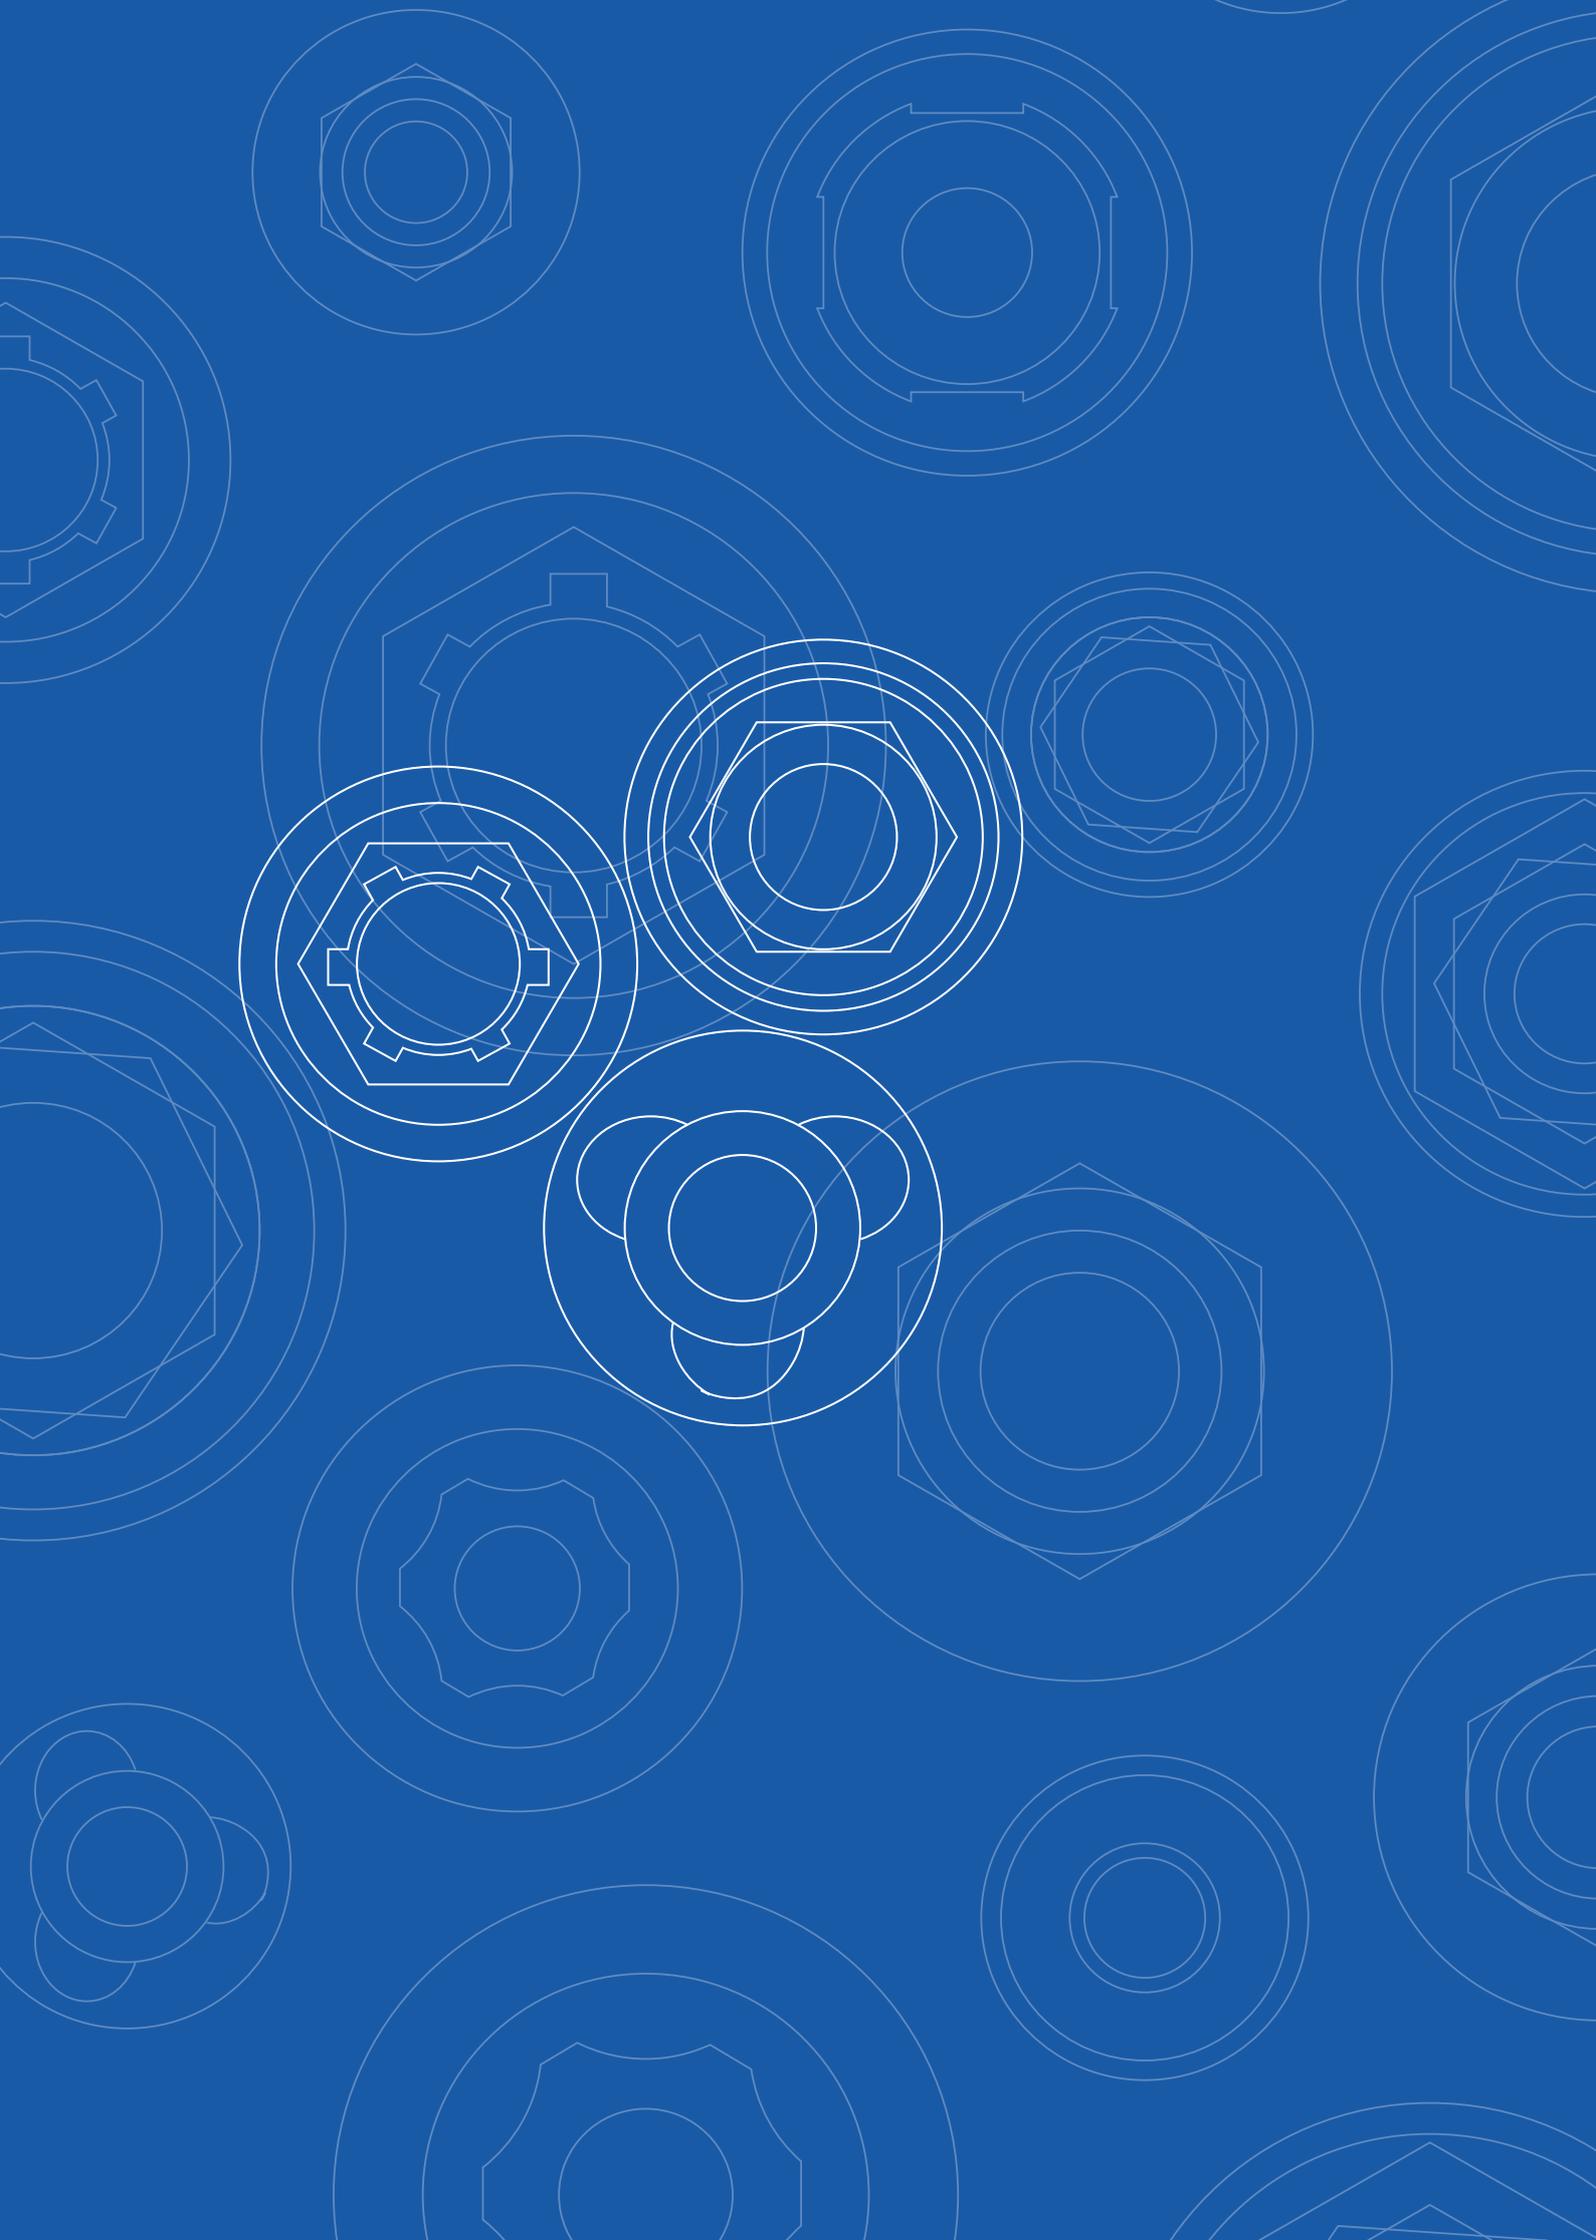

# NOBEL BIOCARE®

COMPATIBILITA'

**BRANEMARK  
SYSTEM®**

**REPLACE  
SELECT®**


**NOBEL  
ACTIVE®**

SERIE

**AA**

**AC**

**AD**

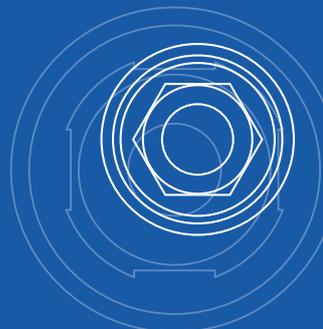



COMPATIBILE

Nobel Biocare® Branemark®

Ø 3.5 - Ø 4.1 - Ø 5.1

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

AA

## Nobel Biocare® Branemark®

Compatibile con:

BIOHORIZONS® EXTERNAL®

MEGAGEN® EXFEEL® EXTERNAL®

## Analogo



Ø	Codice
3.5	ABC/AA-AN-00
4.1	ABC/AA-AR-00
5.1	ABC/AA-AW-00

## Viti TPA



Ø	Codice
3.5	ABC/AA-TN-50
4.1	ABC/AA-TR-50
4.1	ABC/AA-TR-52
5.1	ABC/AA-TW-50

ABC/AA-TR-52 è una vite a testa piatta.

## Viti Unigrip

TiN



Ø	Codice
3.5	ABC/AA-TN-00
3.5	ABC/AA-TN-00/TiN
4.1	ABC/AA-TR-00
4.1	ABC/AA-TR-00/TiN
5.1	ABC/AA-TW-00
5.1	ABC/AA-TW-00/TiN

## Incollaggio



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	1	NR	ABC/AA-IN-00
3.5	1	R	ABC/AA-IN-01
3.5	2.5	NR	ABC/AA-IN-02
3.5	2.5	R	ABC/AA-IN-03
4.1	0.2	NR	ABC/AA-IR-00
4.1	0.2	R	ABC/AA-IR-01
4.1	1.5	NR	ABC/AA-IR-02
4.1	1.5	R	ABC/AA-IR-03
4.1	2.5	NR	ABC/AA-IR-04
4.1	2.5	R	ABC/AA-IR-05

## Asse Angolato



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	1	NR	ABC/AA-IN-30
3.5	1	R	ABC/AA-IN-31
4.1	0.2	NR	ABC/AA-IR-30
4.1	0.2	R	ABC/AA-IR-31



COMPATIBILE

Nobel Biocare® Branemark®

Ø 3.5 - Ø 4.1 - Ø 5.1

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

AA

## Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R.	Codice
3.5	NR	ABC/AA-BN-00
3.5	R	ABC/AA-BN-01
4.1	NR	ABC/AA-BR-00
4.1	R	ABC/AA-BR-01

AsseAngolato 360 CoCr TPA<sup>30°</sup>

Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Ang.	NR/R	Codice
3.5	15°	NR	ABC/AA-BN-10
3.5	15°	R	ABC/AA-BN-11
3.5	25°	NR	ABC/AA-BN-20
3.5	25°	R	ABC/AA-BN-21
4.1	15°	NR	ABC/AA-BR-10
4.1	15°	R	ABC/AA-BR-11
4.1	25°	NR	ABC/AA-BR-20
4.1	25°	R	ABC/AA-BR-21

## Calcinabile



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.5	NR	ABC/AA-HN-00
3.5	R	ABC/AA-RN-00
4.1	NR	ABC/AA-HR-00
4.1	R	ABC/AA-RR-00
5.1	NR	ABC/AA-HW-00
5.1	R	ABC/AA-RW-00

## Monconi Provvisori



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	1	NR	ABC/AA-PN-06
3.5	1	R	ABC/AA-PN-07
4.1	1	NR	ABC/AA-PR-06
4.1	1	R	ABC/AA-PR-07

← TORNA ALL'INDICE



COMPATIBILE

Nobel Biocare® Branemark®

Ø 3.5 - Ø 4.1 - Ø 5.1

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

AA

## Monconi 0° - 15° - 25°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5	1	0°	ABC/DP-50-B
3.5	3	0°	ABC/DP-50
4.1	1	0°	ABC/AA-PR-00
4.1	2	0°	ABC/DP-06-TA
4.1	3	0°	ABC/DP-07-TA
4.1	4	0°	ABC/DP-08-TA
5.1	2	0°	ABC/DP-50-D
5.1	4	0°	ABC/DP-50-A

Ø	Alt.	Ang.	Codice
4.1	1	15°	ABC/AA-PR-02
4.1	2	15°	ABC/AA-PR-04
4.1	1	25°	ABC/AA-PR-03
4.1	2	25°	ABC/AA-PR-05

## Monconi di Guarigione



Ø	Alt.	Codice
3.5	2	ABC/AA-DN-02
3.5	3	ABC/AA-DN-03
3.5	4	ABC/AA-DN-04
4.1	2	ABC/AA-DR-02
4.1	3	ABC/AA-DR-03
4.1	4	ABC/AA-DR-04
4.1	5	ABC/AA-DR-05
5.1	2	ABC/AA-DW-02
5.1	3	ABC/AA-DW-03
5.1	4	ABC/AA-DW-04

## Transfer Impronta

Cucchiaio  
ApertoCucchiaio  
Chiuso

Qty.	Tipo	Codice
3.5	Aperto	ABC/AA-CN-00
4.1	Aperto	ABC/AA-CR-00
5.1	Aperto	ABC/AA-CW-00
4.1	Chiuso	ABC/AA-CR-01

## PSD Compatibile Locator



Ø	Alt.	Codice
3.5	1	ABC/AA-LN-01
3.5	3	ABC/AA-LN-03
3.5	5	ABC/AA-LN-05
4.1	1	ABC/AA-LR-01
4.1	2	ABC/AA-LR-02
4.1	3	ABC/AA-LR-03
4.1	4	ABC/AA-LR-04
4.1	5	ABC/AA-LR-05

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00

ULTERIORI ACCESSORI E RICAMBI VEDERE PAGINA 91



COMPATIBILE

Nobel Biocare® Branemark®

Ø 3.5 - Ø 4.1 - Ø 5.1

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

AA


### MultiUnit 0° - 17° - 30°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5	1	0°	ABC/PD-18-01
3.5	2	0°	ABC/PD-18-02
3.5	3	0°	ABC/PD-18-03
4.1	1	0°	ABC/AB-MR-01
4.1	2	0°	ABC/AB-MR-02
4.1	3	0°	ABC/AB-MR-03
4.1	4	0°	ABC/AB-MR-04
4.1	5	0°	ABC/AB-MR-05

Ø	Alt.	Ang.	Codice
4.1	2	17°	ABC/AB-MR-12
4.1	3	17°	ABC/AB-MR-13
4.1	4	17°	ABC/AB-MR-14
4.1	3	30°	ABC/AB-MR-33
4.1	4	30°	ABC/AB-MR-34
4.1	5	30°	ABC/AB-MR-35

### Strumenti e Accessori

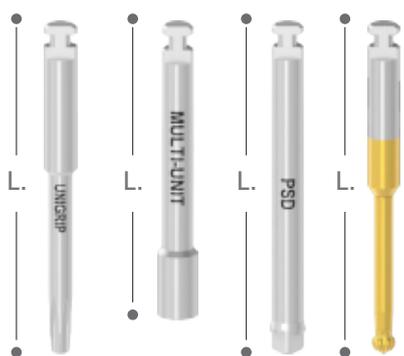

Unigrip M-Unit 0° PSD TPA

Punta	L.	Codice
Unigrip	18 mm.	ABC/PU-00-18
Unigrip	25 mm.	ABC/PU-00-25
Unigrip	32 mm.	ABC/PU-00-32
M-Unit 0°	20 mm.	ABC/LL-AB-00
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01

### MultiUnit System



Codice	Analogo
ABC/AB-AR-00	



Codice	Incollaggio
ABC/AB-IR-01	



Codice	CoCr
ABC/AB-BR-01	



Ang.	Codice	CoCr 360
15°	ABC/AB-BR-11	TPA <sup>30°</sup>
25°	ABC/AB-BR-21	



Codice	Calcinabile
ABC/AB-RR-00	



Codice	Provisori Ti
ABC/AB-PR-00	



Tipo	Codice	Viti
Unigrip	ABC/AB-TR-00	
TiN	ABC/AB-TR-00/TiN	
TPA	ABC/AB-TR-50	



Tipo	Codice	Transfer Impronta
Aperto	ABC/AB-CR-00	
Chiuso	ABC/AB-CR-01	



Tipo	Codice	Guarigione
Plastica	ABC/AB-DR-00	
Titanio	ABC/AB-DR-01	

← TORNA ALL'INDICE



COMPATIBILE

Nobel Replace® Select®

Ø 3.5 - Ø 4.3 - Ø 5.0

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

AC

## Nobel Replace® Select®

Compatibile con:

IMPLANT DIRECT® TRI-LOBE®

SOUTHERN IMPLANTS® TRI-NEX®

## Viti TPA



Ø	Codice
3.5	ABC/AC-TN-50
3.5	ABC/AC-TN-51
4.3/5.0	ABC/AC-TR-50
4.3/5.0	ABC AC-TR-51

ABC/AC-TR-50 Solo per connessione CAD CAM librerie Nobel®.  
 ABC/AC-TN-51 è una vite specifica per ABC/AC-BN-20 e ABC/AC-BN-21.  
 ABC/AC-TR-51 è una vite specifica per IPD Incollaggio e Co-Cr.

## Incollaggio



Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	1.0	NR	ABC/AC-IN-00
3.5	1.0	R	ABC/AC-IN-01
3.5	2.5	NR	ABC/AC-IN-02
3.5	2.5	R	ABC/AC-IN-03
4.3	0.2	NR	ABC/AC-IR-00
4.3	0.2	R	ABC/AC-IR-01
4.3	1.5	NR	ABC/AC-IR-02
4.3	1.5	R	ABC/AC-IR-03
4.3	2.5	NR	ABC/AC-IR-04
4.3	2.5	R	ABC/AC-IR-05
5.0	0.2	NR	ABC/AC-IW-00
5.0	0.2	R	ABC/AC-IW-01
5.0	1.5	NR	ABC/AC-IW-02
5.0	1.5	R	ABC/AC-IW-03
5.0	2.5	NR	ABC/AC-IW-04
5.0	2.5	R	ABC/AC-IW-05

## Analogo



Ø	Codice
3.5	ABC/AC-AN-00
4.3	ABC/AC-AR-00
5.0	ABC/AC-AW-00

## Viti Unigrip



Ø	Codice
3.5	ABC/AC-TN-00
3.5	ABC/AC-TN-00/TiN
4.3/5.0	ABC/AC-TR-00
4.3/5.0	ABC/AC-TR-00/TiN

## AsseAngolato



Non Rotante/NR		Rotante/R	
Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	1.0	NR	ABC/AC-IN-30
3.5	1.0	R	ABC/AC-IN-31
4.3	0.2	NR	ABC/AC-IR-30
4.3	0.2	R	ABC/AC-IR-31
5.0	0.2	NR	ABC/AC-IW-30
5.0	0.2	R	ABC/AC-IW-31



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/**NR**                      Rotante/**R**

Ø	NR/R	Codice
3.5	NR	ABC/AC-BN-00
3.5	R	ABC/AC-BN-01
4.3	NR	ABC/AC-BR-00
4.3	R	ABC/AC-BR-01


## AsseAngolato 360 CoCr **TPA<sup>30°</sup>**



Non Rotante/**NR**                      Rotante/**R**

Ø	Ang.	NR/R	Codice
3.5	15°	NR	ABC/AC-BN-10
3.5	15°	R	ABC/AC-BN-11
3.5	25°	NR	ABC/AC-BN-20
3.5	25°	R	ABC/AC-BN-21
4.3	15°	NR	ABC/AC-BR-10
4.3	15°	R	ABC/AC-BR-11

## Calcinabile

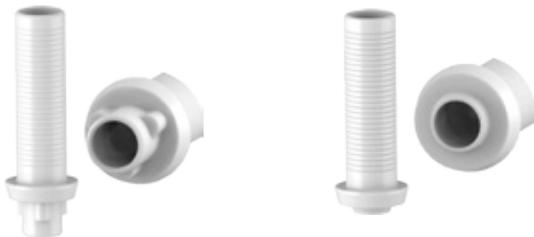

Non Rotante/**NR**                      Rotante/**R**

Ø	NR/R	Codice
3.5	NR	ABC/AC-HN-00
3.5	R	ABC/AC-RN-00
4.3	NR	ABC/AC-HR-00
4.3	R	ABC/AC-RR-00
5.0	NR	ABC/AC-HW-00
5.0	R	ABC/AC-RW-00

## Monconi Provvisori



Non Rotante/**NR**                      Rotante/**R**

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	1	NR	ABC/AC-PN-06
3.5	1	R	ABC/AC-PN-07
4.3	1	NR	ABC/AC-PR-06
4.3	1	R	ABC/AC-PR-07
5.0	1	NR	ABC/RPL-50-PRV
5.0	1	R	ABC/RPL-50-PRVR



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

AC

## Monconi 0° -15°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5	1	0°	ABC/RPL-35-T1
3.5	3	0°	ABC/AC-PN-00
4.3	1	0°	ABC/RPL-43-T1
4.3	3	0°	ABC/AC-PR-00
5.0	1	0°	ABC/RPL-50-T1
5.0	3	0°	ABC/AC-PW-00
Ø	Alt.	Ang.	Codice
3,5	1	15°	ABC/RPL-35A-151
3,5	3	15°	ABC/RPL-35A-153
4,3	1	15°	ABC/RPL-43A-151
4,3	3	15°	ABC/RPL-43A-153
5,0	1	15°	ABC/RPL-50A-151
5,0	3	15°	ABC/RPL-50A-153

## Monconi di Guarigione



Ø	Alt.	Codice
3.5	3	ABC/AC-DN-03
3.5	5	ABC/AC-DN-05
3.5	7	ABC/AC-DN-07
4.3	3	ABC/AC-DR-03
4.3	5	ABC/AC-DR-05
5.0	3	ABC/AC-DW-03
5.0	5	ABC/AC-DW-05

## Transfer Impronta



Cucchiaino  
Aperto



Cucchiaino  
Chiuso

Qty.	Tipo	Codice
3.5	Aperto	ABC/AC-CN-00
3.5	Chiuso	ABC/AC-CN-01
4.3	Aperto	ABC/AC-CR-00
4.3	Chiuso	ABC/AC-CR-01
5.0	Aperto	ABC/AC-CW-00
5.0	Chiuso	ABC/AC-CW-01

## PSD Compatibile Locator



Ø	Alt.	Codice
3.5	1	ABC/AC-LN-01
3.5	3	ABC/AC-LN-03
3.5	5	ABC/AC-LN-05
4.3	1	ABC/AC-LR-01
4.3	3	ABC/AC-LR-03
4.3	5	ABC/AC-LR-05

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00

ULTERIORI ACCESSORI E RICAMBI VEDERE PAGINA 91



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

### MultiUnit 0° - 17° - 30°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5	1	0°	ABC/AC-MN-01
3.5	2	0°	ABC/AC-MN-02
4.3	1	0°	ABC/AC-MR-01
4.3	2	0°	ABC/AC-MR-02
4.3	3	0°	ABC/AC-MR-03
4.3	4	0°	ABC/AC-MR-04
4.3	5	0°	ABC/AC-MR-05
Ø	Alt.	Ang.	Codice
4.3	2	17°	ABC/AC-MR-12
4.3	3	17°	ABC/AC-MR-13
4.3	4	17°	ABC/AC-MR-14
4.3	4	30°	ABC/AC-MR-34
4.1	5	30°	ABC/AC-MR-35

### MultiUnit System



Codice	Analogo
ABC/AB-AR-00	



Codice	Incollaggio
ABC/AB-IR-01	



Codice	CoCr
ABC/AB-BR-01	



Ang.	Codice	CoCr 360
15°	ABC/AB-BR-11	TPA <sup>30°</sup>
25°	ABC/AB-BR-21	



Codice	Calcinabile
ABC/AB-RR-00	



Codice	Provisori Ti
ABC/AB-PR-00	



Tipo	Codice	Viti
Unigrip	ABC/AB-TR-00	
TiN	ABC/AB-TR-00/TiN	
TPA	ABC/AB-TR-50	




Tipo	Codice	Transfer Impronta
Aperto	ABC/AB-CR-00	
Chiuso	ABC/AB-CR-01	



Tipo	Codice	Guarigione
Plastica	ABC/AB-DR-00	
Titanio	ABC/AB-DR-01	

### Strumenti e Accessori

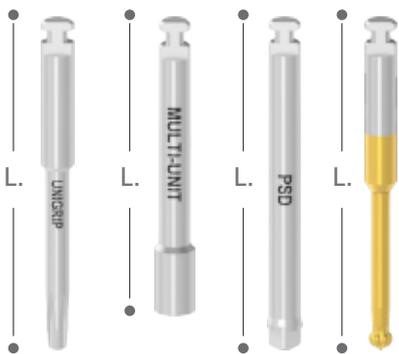

Unigrip M-Unit 0° PSD TPA

Punta	L.	Codice
Unigrip	18 mm.	ABC/PU-00-18
Unigrip	25 mm.	ABC/PU-00-25
Unigrip	32 mm.	ABC/PU-00-32
M-Unit 0°	20 mm.	ABC/LL-AB-00
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01



COMPATIBILE

## Nobel Active® CC Conical Connection

Ø 3.0 - Ø 3.5 - Ø 4.3

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

AD

## Nobel Active® CC

Compatibile con:

NOBEL BIOCARE® NOBEL PARALLEL®  
 NOBEL BIOCARE® NOBEL REPLACE® CC  
 JDENTAL CARE® JD ICON®  
 IMPLANT DIRECT® INTERACTIVE™

## Analogo



Ø	Codice
3.0	ABC/AD-AT-00
3.5	ABC/AD-AN-00
4.3	ABC/AD-AR-00

## Viti TPA



Ø	Codice
3.0	ABC/AD-TT-50
3.5	ABC/AD-TN-50
4.3	ABC/AD-TR-50

## Viti Unigrip

TiN



Ø	Codice
3.0	ABC/AA-TT-00
3.0	ABC/AA-TT-00/TiN
3.5	ABC/AA-TN-00
3.5	ABC/AA-TN-00/TiN
4.3	ABC/AA-TR-00
4.3	ABC/AA-TR-00/TiN

## Incollaggio



Non Rotante/NR			Rotante/R
Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	0.9	NR	ABC/AD-IN-00
3.5	0.9	R	ABC/AD-IN-01
3.5	2.5	NR	ABC/AD-IN-02
3.5	2.5	R	ABC/AD-IN-03
4.3	1.0	NR	ABC/AD-IR-00
4.3	1.0	R	ABC/AD-IR-01
4.3	2.5	NR	ABC/AD-IR-02
4.3	2.5	R	ABC/AD-IR-03

## AsseAngolato



Non Rotante/NR			Rotante/R
Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	0.9	NR	ABC/AD-IN-30
3.5	0.9	R	ABC/AD-IN-31
4.3	1.0	NR	ABC/AD-IR-30
4.3	1.0	R	ABC/AD-IR-31



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R.	Codice
3.0	NR	ABC/AD-BT-00
3.0	R	ABC/AD-BT-01
3.5	NR	ABC/AD-BN-00
3.5	R	ABC/AD-BN-01
4.3	NR	ABC/AD-BR-00
4.3	R	ABC/AD-BR-01

AsseAngolato 360 CoCr **TPA<sup>30°</sup>**

Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Ang.	NR/R	Codice
3.0	15°	NR	ABC/AD-BT-10
3.0	15°	R	ABC/AD-BT-11
3.0	25°	NR	ABC/AD-BT-20
3.0	25°	R	ABC/AD-BT-21
3.5	15°	NR	ABC/AD-BN-10
3.5	15°	R	ABC/AD-BN-11
3.5	25°	R	ABC/AD-BN-20
3.5	25°	NR	ABC/AD-BN-21
4.3	15°	R	ABC/AD-BR-10
4.3	15°	NR	ABC/AD-BR-11
4.3	25°	R	ABC/AD-BR-20
4.3	25°	NR	ABC/AD-BR-21

## Calcinabile



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R.	Codice
3.5	NR	ABC/AD-HN-00
3.5	R	ABC/AD-RN-00
4.3	NR	ABC/AD-HR-00
4.3	R	ABC/AD-RR-00

## Monconi Provvisori



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	1	NR	ABC/AD-PN-06
3.5	1	NR	ABC/AD-PN-07
4.3	1	NR	ABC/AD-PR-06
4.3	1	NR	ABC/AD-PR-07



COMPATIBILE

Nobel Active® CC Conical Connection

Ø 3.5 - Ø 4.3

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

AD

## Monconi 0° - 17°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5	1	0°	ABC/NAM-T35-1
3.5	3	0°	ABC/NAM-T35-3
4.3	1	0°	ABC/NAM-T43-1
4.3	3	0°	ABC/NAM-T43-3

Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5	1	17°	ABC/NAM-T35-171
3.5	3	17°	ABC/NAM-T35-173
4.3	1	17°	ABC/NAM-T43-171
4.3	3	17°	ABC/NAM-T43-173

## Monconi di Guarigione



Ø	Alt.	Codice	STANDARD
3.0	3	ABC/AD-DT-03	
3.0	5	ABC/AD-DT-05	
3.0	7	ABC/AD-DT-07	
3.5	0.4	ABC/AD-DN-00	
3.5	1.5	ABC/AD-DN-01	
3.5	3	ABC/AD-DN-03	
3.5	5	ABC/AD-DN-05	
4.3	0.4	ABC/AD-DR-00	
4.3	1.5	ABC/AD-DR-01	
4.3	3	ABC/AD-DR-03	
4.3	5	ABC/AD-DR-04	

Ø	Alt.	Codice	WIDE
3.5	3	ABC/AD-DN-13	
3.5	5	ABC/AD-DN-15	

## Transfer Impronta

Cucchiaio  
Aperto

Ø	Tipo	Codice
3.0	Aperto	ABC/AD-CT-00
3.5	Aperto	ABC/AD-CN-00
4.3	Aperto	ABC/AD-CR-00

## PSD Compatibile Locator



Ø	Alt.	Codice
3.5	1	ABC/AD-LN-01
3.5	2	ABC/AD-LN-02
3.5	3	ABC/AD-LN-03
3.5	4	ABC/AD-LN-04
3.5	5	ABC/AD-LN-05
4.3	1	ABC/AD-LR-01
4.3	2	ABC/AD-LR-02
4.3	3	ABC/AD-LR-03
4.3	4	ABC/AD-LR-04
4.3	5	ABC/AD-LR-05

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00

ULTERIORI ACCESSORI E RICAMBI VEDERE PAGINA 91



COMPATIBILE

# Nobel Active® CC Conical Connection

Ø 3.5 - Ø 4.3

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

AD

## MultiUnit 0° - 17° - 30°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5	1.5	0°	ABC/AD-MN-01
3.5	2.5	0°	ABC/AD-MN-02
3.5	3.5	0°	ABC/AD-MN-03
3.5	4.5	0°	ABC/AD-MN-04
4.3	1.5	0°	ABC/AD-MR-01
4.3	2.5	0°	ABC/AD-MR-02
4.3	3.5	0°	ABC/AD-MR-03
4.3	4.5	0°	ABC/AD-MR-04

Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5	2.5	17°	ABC/AD-MN-12
3.5	3.5	17°	ABC/AD-MN-13
4.3	2.5	17°	ABC/AD-MR-12
4.3	3.5	17°	ABC/AD-MR-13
3.5	3.5	30°	ABC/AD-MN-33
3.5	4.5	30°	ABC/AD-MN-34
4.3	3.5	30°	ABC/AD-MR-33
4.3	4.5	30°	ABC/AD-MR-34

## MultiUnit System



Codice	Analogo
ABC/AB-AR-00	



Codice	Incollaggio
ABC/AB-IR-01	



Codice	CoCr
ABC/AB-BR-01	



Ang.	Codice	CoCr 360
15°	ABC/AB-BR-11	TPA <sup>30°</sup>
25°	ABC/AB-BR-21	



Codice	Calcinabile
ABC/AB-RR-00	



Codice	Provisori Ti
ABC/AB-PR-00	



Tipo	Codice	Viti
Unigrip	ABC/AB-TR-00	
TiN	ABC/AB-TR-00/TiN	
TPA	ABC/AB-TR-50	




Tipo	Codice	Transfer Impronta
Aperto	ABC/AB-CR-00	
Chiuso	ABC/AB-CR-01	



Tipo	Codice	Guarigione
Plastica	ABC/AB-DR-00	
Titanio	ABC/AB-DR-01	

## Strumenti e Accessori

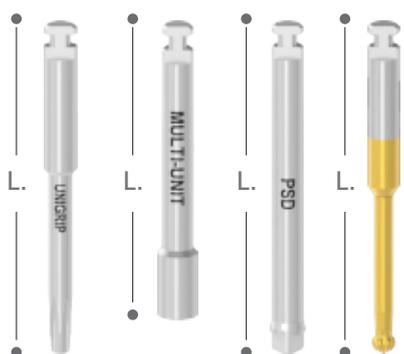

Unigrip M-Unit 0° PSD TPA

Punta	L.	Codice
Unigrip	18 mm.	ABC/PU-00-18
Unigrip	25 mm.	ABC/PU-00-25
Unigrip	32 mm.	ABC/PU-00-32
M-Unit 0°	20 mm.	ABC/LL-AB-00
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01

← TORNA ALL'INDICE



# BIOMET® 3i®

COMPATIBILITA'

ESAGONO  
ESTERNO 3i®

CERTAIN®



SERIE

BA

BB



COMPATIBILE

## Biomet 3i® Esagono esterno

Ø 3.4 - Ø 4.1 - Ø 5.0

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

BA

## Biomet® Esagono esterno

Compatibile con:

SWEDEN &amp; MARTINA® OUTLINK® (Ø 4,1 - Ø 5,0)

GEASS® VENEZIA®

BIOTEC® BT CLASSIC EXT® (Ø ER - Ø EW)

WINSIX® TTX® (Ø 3,8 - Ø 4,5 - Ø 5,2 - Ø 5,9)

## Analogo



Ø	Codice
3.4	ABC/BA-AN-00
4.1	ABC/AA-AR-00
5.0	ABC/BA-AW-00

## Viti TPA



Ø	Codice
3.4/4.1/ 5.0	ABC/AA-TR-50

## Viti Esagono 1.20



Ø	Codice
3.4/4.1/ 5.0	ABC/BA-TR-00
3.4/4.1/ 5.0	ABC/BA-TR-00/TiN

## Incollaggio



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.4	1	NR	ABC/BA-IN-00
3.4	1	R	ABC/BA-IN-01
3.4	2.5	NR	ABC/BA-IN-02
3.4	2.5	R	ABC/BA-IN-03
4.1	0.2	NR	ABC/AA-IR-00-3i
4.1	0.2	R	ABC/AA-IR-01-3i
4.1	1.5	NR	ABC/AA-IR-02-3i
4.1	1.5	R	ABC/AA-IR-03-3i
4.1	2.5	NR	ABC/AA-IR-04-3i
4.1	2.5	R	ABC/AA-IR-05-3i
5.0	0.2	NR	ABC/BA-IW-00
5.0	0.2	R	ABC/BA-IW-01
5.0	1.5	NR	ABC/BA-IW-02
5.0	1.5	R	ABC/BA-IW-03
5.0	2.5	NR	ABC/BA-IW-04
5.0	2.5	R	ABC/BA-IW-05

## AsseAngolato



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.4	1	NR	ABC/BA-IN-30
3.4	1	R	ABC/BA-IN-31
4.1	0.2	NR	ABC/AA-IR-30
4.1	0.2	R	ABC/AA-IR-31
5.0	0.2	NR	ABC/BA-IW-30
5.0	0.2	R	ABC/BA-IW-31



COMPATIBILE

## Biomet 3i® Esagono esterno

Ø 3.4 - Ø 4.1 - Ø 5.0

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.4	NR	ABC/BA-BN-00
3.4	R	ABC/BA-BN-01
4.1	NR	ABC/AA-BR-00-3i
4.1	R	ABC/AA-BR-01-3i
5.0	NR	ABC/BA-BW-00
5.0	R	ABC/BA-BW-01

## AsseAngolato 360 CoCr



BA



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Ang.	NR/R	Codice
3.4	15°	NR	ABC/BA-BN-10
3.4	15°	R	ABC/BA-BN-11
3.4	25°	NR	ABC/BA-BN-20
3.4	25°	R	ABC/BA-BN-21
4.1	15°	NR	ABC/AA-BR-10
4.1	15°	R	ABC/AA-BR-11
4.1	25°	NR	ABC/AA-BR-20
4.1	25°	R	ABC/AA-BR-21
5.0	15°	NR	ABC/AA-BW-10
5.0	15°	R	ABC/AA-BW-11
5.0	25°	NR	ABC/AA-BW-20
5.0	25°	R	ABC/AA-BW-21

## Calcinabile



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.4	NR	ABC/BA-HN-00
3.4	R	ABC/BA-RN-00
4.1	NR	ABC/AA-HR-00-3i
4.1	R	ABC/AA-RR-00-3i
5.0	NR	ABC/BA-HW-00
5.0	R	ABC/BA-RW-00

## Monconi Provvisori



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.4	NR	ABC/BA-PN-06
3.4	R	ABC/BA-PN-07
4.1	NR	ABC/AA-PR-06-3i
4.1	R	ABC/AA-PR-07-3i



COMPATIBILE

## Biomet 3i® Esagono esterno

Ø 3.4 - Ø 4.1 - Ø 5.0

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

BA

## Monconi 0° - 15° - 25°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
4.1	1.0	0°	ABC/AA-PR-00-3i
4.1	2.0	0°	ABC/DP-06-A
4.1	3.0	0°	ABC/DP-07-A
4.1	4.0	0°	ABC/DP-08-A
5.0	1.0	0°	ABC/DP-10-0
5.0	3.0	0°	ABC/DP-10-2

Ø	Alt.	Ang.	Codice
4.1	1.0	15°	ABC/AA-PR-02-3i
4.1	2.0	15°	ABC/AA-PR-04-3i
4.1	1.0	25°	ABC/AA-PR-03-3i
4.1	2.0	25°	ABC/AA-PR-05-3i

## Monconi di Guarigione



Anatomico

Ø	Alt.	Codice Anatomico
3.4	2.0	ABC/BA-DN-02
3.4	3.0	ABC/BA-DN-03
3.4	4.0	ABC/BA-DN-04
4.1	2.0	ABC/AA-DR-02
4.1	3.0	ABC/AA-DR-03
4.1	4.0	ABC/AA-DR-04
4.1	5.0	ABC/AA-DR-05
5.0	2.0	ABC/BA-DW-02
5.0	3.0	ABC/BA-DW-03
5.0	4.0	ABC/BA-DW-04

## Transfer Impronta



Ø	Tipo	Codice
3.4	Aperto	ABC/BA-CN-00
4.1	Aperto	ABC/AA-CR-00
4.1	Chiuso	ABC/AA-CR-01
5.0	Aperto	ABC/BA-CW-00

## PSD Compatibile Locator



Ø	Alt.	Codice
3.4	1	ABC/BA-LN-01
3.4	3	ABC/BA-LN-03
3.4	5	ABC/BA-LN-05
4.1	1	ABC/AA-LR-01
4.1	2	ABC/AA-LR-02
4.1	3	ABC/AA-LR-03
4.1	4	ABC/AA-LR-04
4.1	5	ABC/AA-LR-05

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00

ULTERIORI ACCESSORI E RICAMBI VEDERE PAGINA 91



COMPATIBILE

# Biomet 3i® Esagono esterno

Ø 3.4 - Ø 4.1 - Ø 5.0

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

BA

## MultiUnit 0° - 17° - 30°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
4.1	1	0°	ABC/AB-MR-01
4.1	2	0°	ABC/AB-MR-02
4.1	3	0°	ABC/AB-MR-03
4.1	4	0°	ABC/AB-MR-04
4.1	5	0°	ABC/AB-MR-05

Ø	Alt.	Ang.	Codice
4.1	2	17°	ABC/AB-MR-12
4.1	3	17°	ABC/AB-MR-13
4.1	4	17°	ABC/AB-MR-14
4.1	3	30°	ABC/AB-MR-33
4.1	4	30°	ABC/AB-MR-34
4.1	5	30°	ABC/AB-MR-35

## MultiUnit System



Codice	Analogo
ABC/AB-AR-00	



Codice	Incollaggio
ABC/AB-IR-01	



Codice	CoCr
ABC/AB-BR-01	



Ang.	Codice	CoCr 360
15°	ABC/AB-BR-11	TPA <sup>30°</sup>
25°	ABC/AB-BR-21	



Codice	Calcinabile
ABC/AB-RR-00	



Codice	Provisori Ti
ABC/AB-PR-00	



Tipo	Codice	Viti
Unigrip	ABC/AB-TR-00	
TiN	ABC/AB-TR-00/TiN	
TPA	ABC/AB-TR-50	




Tipo	Codice	Transfer Impronta
Aperto	ABC/AB-CR-00	
Chiuso	ABC/AB-CR-01	



Tipo	Codice	Guarigione
Plastica	ABC/AB-DR-00	
Titanio	ABC/AB-DR-01	

## Strumenti e Accessori

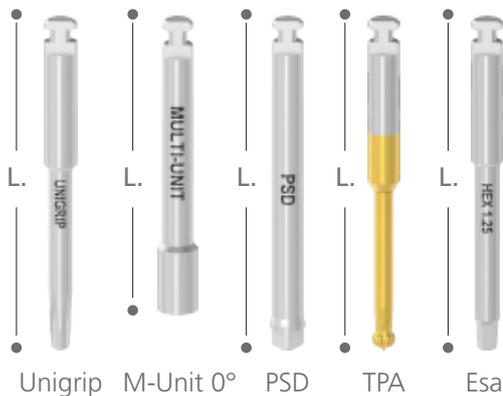

Punta	L.	Codice
Unigrip	18 mm.	ABC/PU-00-18
Unigrip	25 mm.	ABC/PU-00-25
Unigrip	32 mm.	ABC/PU-00-32
M-Unit 0°	20 mm.	ABC/LL-AB-00
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01
Esagonale 1.25	18 mm.	ABC/PH-25-18
Esagonale 1.25	25 mm.	ABC/PH-25-25
Esagonale 1.25	32 mm.	ABC/PH-25-32

← TORNA ALL'INDICE



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

BB

### Viti TPA



Ø	Codice
3.4/4.1/5.0	ABC/BB-TR-51

### Incollaggio



Non Rotante/NR			Rotante/R	
Ø	Alt.	NR/R	Codice	
3.4	0.9	NR	ABC/BB-IN-00	
3.4	0.9	R	ABC/BB-IN-01	
3.4	2.5	NR	ABC/BB-IN-02	
3.4	2.5	R	ABC/BB-IN-03	
4.1	0.3	NR	ABC/BB-IR-00	
4.1	0.3	R	ABC/BB-IR-01	
4.1	1.5	NR	ABC/BB-IR-02	
4.1	1.5	R	ABC/BB-IR-03	
4.1	2.5	NR	ABC/BB-IR-04	
4.1	2.5	R	ABC/BB-IR-05	
5.0	0.3	NR	ABC/BB-IW-00	
5.0	0.3	R	ABC/BB-IW-01	
5.0	1.5	NR	ABC/BB-IW-02	
5.0	1.5	R	ABC/BB-IW-03	
5.0	2.5	NR	ABC/BB-IW-04	
5.0	2.5	R	ABC/BB-IW-05	

### Analogo



Ø	Codice
3.4	ABC/BB-AN-00
4.1	ABC/BB-AR-00
5.0	ABC/BB-AW-00

### Viti Esagono 1.20

TiN



Ø	Codice
3.4/4.1/5.0	ABC/BB-TR-01
3.4/4.1/5.0	ABC/BB-TR-01/TiN
4.1/5.0	ABC/BB-TR-02**

\*\*SOLO PER CALCINABILI ROTANTI

### Asse Angolato



Non Rotante/NR			Rotante/R	
Ø	Alt.	NR/R	Codice	
3.4	0.9	NR	ABC/BB-IN-30	
3.4	0.9	R	ABC/BB-IN-31	
4.1	0.3	NR	ABC/BB-IR-30	
4.1	0.3	R	ABC/BB-IR-31	
5.0	0.3	NR	ABC/BB-IW-30	
5.0	0.3	R	ABC/BB-IW-31	



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/**NR**

Rotante/**R**

Ø	NR/R	Codice
3.4	NR	ABC/BB-BN-00
3.4	R	ABC/BB-BN-01
4.1	NR	ABC/BB-BR-00
4.1	R	ABC/BB-BR-01

## Asse Angolato 360 CoCr **TPA<sup>30°</sup>**



Non Rotante/**NR**

Rotante/**R**

Ø	Ang.	NR/R	Codice
3.4	15°	NR	ABC/BB-BN-10
3.4	15°	R	ABC/BB-BN-11
3.4	25°	NR	ABC/BB-BN-20
3.4	25°	R	ABC/BB-BN-21
4.1	15°	NR	ABC/BB-BR-10
4.1	15°	R	ABC/BB-BR-11
4.1	25°	NR	ABC/BB-BR-20
4.1	25°	R	ABC/BB-BR-21

BB

## Calcinabile



Non Rotante/**NR**

Rotante/**R**

Ø	NR/R	Codice
3.4	NR	ABC/BB-HN-00
3.4	R	ABC/BB-RN-00
4.1	NR	ABC/BB-HR-00
4.1	R	ABC/BB-RR-00**
5.0	NR	ABC/BB-HW-00
5.0	R	ABC/BB-RW-00**

\*\* VITE ABC/BB-TR-02

## Monconi Provvisori



Non Rotante/**NR**

Rotante/**R**

Ø	NR/R	Codice
3.4	NR	ABC/BB-PN-06
3.4	R	ABC/BB-PN-07
4.1	NR	ABC/BB-PR-06
4.1	R	ABC/BB-PR-07



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

BB

## Monconi 0° - 15°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.4	2.0	0°	ABC/BB-PN-00
3.4	4.0	0°	ABC/C3-MT-34
4.1	2.0	0°	ABC/BB-PR-00
4.1	4.0	0°	ABC/C3-MT-44
5.0	2.0	0°	ABC/BB-PW-00
5.0	4.0	0°	ABC/C3-MT-54

Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.4	2.0	15°	ABC/C3-MT-31-52
3.4	4.0	15°	ABC/C3-MT-31-54
4.1	2.0	15°	ABC/C3-MT-41-52
4.1	4.0	15°	ABC/C3-MT-41-54
5.0	2.0	15°	ABC/C3-MT-51-52

## Monconi di Guarigione



Standard

Ø	Alt.	Codice Standard
3.4	2.0	ABC/BB-DN-02
3.4	3.0	ABC/BB-DN-03
3.4	4.0	ABC/BB-DN-04
4.1	2.0	ABC/BB-DR-02
4.1	3.0	ABC/BB-DR-03
4.1	4.0	ABC/BB-DR-04
5.0	2.0	ABC/BB-DW-02
5.0	3.0	ABC/BB-DW-03
5.0	4.0	ABC/BB-DW-04

## Transfer Impronta



Cucchiaio  
Aperto

Ø	Tipo	Codice
3.4	Aperto	ABC/BB-CN-00
4.1	Aperto	ABC/BB-CR-00
5.0	Aperto	ABC/BB-CW-00

## PSD Compatibile Locator



Ø	Alt.	Codice
3.4	1	ABC/BB-LN-01
3.4	3	ABC/BB-LN-03
3.4	5	ABC/BB-LN-05
4.1	1	ABC/BB-LR-01
4.1	3	ABC/BB-LR-03
4.1	5	ABC/BB-LR-05

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00

ULTERIORI ACCESSORI E RICAMBI VEDERE PAGINA 91



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

### MultiUnit 0° - 17° - 30°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
4.1	1.0	0°	ABC/BB-MR-01
4.1	2.0	0°	ABC/BB-MR-02
4.1	3.0	0°	ABC/BB-MR-03
4.1	4.0	0°	ABC/BB-MR-04
4.1	5.0	0°	ABC/BB-MR-05

Ø	Alt.	Ang.	Codice
4.1	2.0	17°	ABC/BB-MR-12
4.1	3.0	17°	ABC/BB-MR-13
4.1	4.0	17°	ABC/BB-MR-14
4.1	4.0	30°	ABC/BB-MR-34
4.1	5.0	30°	ABC/BB-MR-35

### MultiUnit System



Codice	Analogo
ABC/AB-AR-00	



Codice	Incollaggio
ABC/AB-IR-01	



Codice	CoCr
ABC/AB-BR-01	



Ang.	Codice	CoCr 360
15°	ABC/AB-RR-11	TPA <sup>30°</sup>
25°	ABC/AB-RR-21	



Codice	Calcinabile
ABC/AB-RR-00	



Codice	Provisori Ti
ABC/AB-PR-00	



Tipo	Codice	Viti
Unigrip	ABC/AB-TR-00	
TiN	ABC/AB-TR-00/TiN	
TPA	ABC/AB-TR-50	




Tipo	Codice	Transfer Impronta
Aperto	ABC/AB-CR-00	
Chiuso	ABC/AB-CR-01	



Tipo	Codice	Guarigione
Plastica	ABC/AB-DR-00	
Titanio	ABC/AB-DR-01	

### Strumenti e Accessori

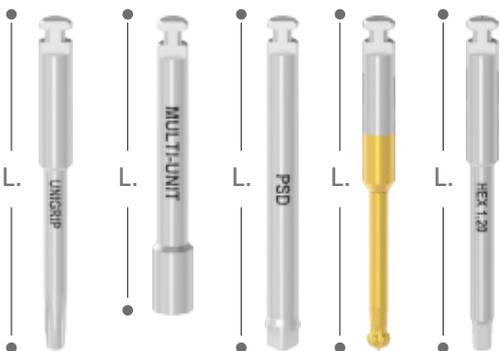

Unigrip M-Unit 0° PSD TPA Esa

Punta	L.	Codice
Unigrip	18 mm.	ABC/PU-00-18
Unigrip	25 mm.	ABC/PU-00-25
Unigrip	32 mm.	ABC/PU-00-32
M-Unit 0°	20 mm.	ABC/LL-AB-00
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01
Esagonale 1.20	18 mm.	ABC/PH-20-18
Esagonale 1.20	25 mm.	ABC/PH-20-25
Esagonale 1.20	32 mm.	ABC/PH-20-32





**STRAUMANN®**

**COMPATIBILITA'**

**TISSUE LEVEL®**

**BONE LEVEL®**

**SERIE**

**DA**

**DB**



COMPATIBILE

Straumann® Tissue Level®

Ø 4.8 - Ø 6.5

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

DA

## Straumann® Tissue Level®

Compatibile con:

ZIMMER® SWISSPLUS®

IMPLANT DIRECT® SWISHPLUS™

IMPLANT DIRECT® TAPERED™

MIS® MISTRAL®

GEASS® WAY ROMA®

OSTEM® SS SYSTEM®

JDENTAL CARE® JD OCTA®

## Viti TPA



Ø	Codice
4.8/6.5	ABC/DA-TR-50
4.8/6.5	ABC/DA-TR-51

ABC/DA-TR-50 • VITE SYNOCTA®  
ABC/DA-TR-51 • VITE STANDARD

## Analogo



Ø	Codice
4.8	ABC/DA-AR-00
6.5	ABC/DA-AW-00

## Viti Torx

TiN



Ø	Codice
4.8/6.5	ABC/DA-TR-01
4.8/6.5	ABC/DA-TR-01/TiN
4.8/6.5	ABC/DA-TR-03
SYN	ABC/DA-TR-00
SYN	ABC/DA-TR-00/TiN

ABC/DA-TR-01 • VITE STANDARD  
ABC/DA-TR-03 • VITE RICAMBIO ORIGINALI STRAUMANN®  
ABC/DA-TR-00 • VITE RICAMBIO SYNOCTA®

Ø	Codice	SWISSPLUS®
4.8	ABC/FB-TR-00	
4.8	ABC/FB-TR-00/TiN	
4.8	ABC/FB-TR-01	
4.8	ABC/FB-TR-01/TiN	

ABC/FB-TR-00 • VITE RICAMBIO ORIGINALI SWISSPLUS®  
ABC/FB-TR-01 • VITE STANDARD

## Incollaggio



Non Rotante/NR		Rotante/R	
Ø	Alt.	NR/R	Codice
4.8	0.85	NR	ABC/DA-IR-00
4.8	0.85	NR	ABC/DA-IR-01
SYN	0.85	NR	ABC/DA-IR-11

ABC/DA-IR-11 PER SYNOCTA®

## AsseAngolato



Non Rotante/NR		Rotante/R	
Ø	Alt.	NR/R	Codice
4.8	0.85	NR	ABC/DA-IR-30
4.8	0.85	NR	ABC/DA-IR-31



COMPATIBILE

Straumann® Tissue Level®

Ø 4.8 - Ø 6.5

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

DA

## Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
4.8	NR	ABC/DA-BR-00
4.8	R	ABC/DA-BR-01
6.5	NR	ABC/DA-BW-00
6.5	R	ABC/DA-BW-01
SYN	NR	ABC/DA-BR-03*
SYN	R	ABC/DA-BR-02*

\*PER MONCONI SYNOCTA®

AsseAngolato 360 CoCr **TPA<sup>30°</sup>**

Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Ang.	NR/R	Codice
4.8	15°	NR	ABC/DA-BR-10
4.8	15°	R	ABC/DA-BR-11
4.8	25°	NR	ABC/DA-BR-20
4.8	25°	R	ABC/DA-BR-21
6.5	15°	NR	ABC/DA-BW-10
6.5	15°	R	ABC/DA-BW-11
6.5	25°	NR	ABC/DA-BW-20
6.5	25°	R	ABC/DA-BW-21
SYN	15°	NR	ABC/DA-BR-13
SYN	15°	R	ABC/DA-BR-12
SYN	25°	NR	ABC/DA-BR-23
SYN	25°	R	ABC/DA-BR-22

## Calcinabile



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
4.8	NR	ABC/DA-HR-01
4.8	R	ABC/DA-RR-01
SYN	NR	ABC/DA-HR-00*
SYN	R	ABC/DA-RR-00*

\*PER MONCONI SYNOCTA®

## Monconi Provvisori



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
4.8	NR	ABC/DA-PR-06
4.8	R	ABC/DA-PR-07
SYN	NR	ABC/DA-PR-09*
SYN	R	ABC/DA-PR-08*

\*PER MONCONI SYNOCTA®



COMPATIBILE

Straumann® Tissue Level®

Ø 4.8 - Ø 6.5

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

DA

## Monconi 0° - 15° - 25°



Ø	Ang.	Codice
4.8	0°	ABC/DA-PR-01
6.5	0°	ABC/DA-PW-00

Ø	Ang.	Codice
4.8	17°	ABC/MA-XX-50-17
4.8	25°	ABC/MA-XX-50-25

## Synocta®



Ø	Tipo	Codice
4.8	Synocta®	ABC/DA-PR-00

## Monconi di Guarigione



Ø	Alt.	Codice Standard
4.8	0	ABC/DA-DR-00
4.8	1.5	ABC/DA-DR-01
4.8	3.0	ABC/DA-DR-03
4.8	4.5	ABC/DA-DR-04

## Transfer Impronta

Cucchiaio  
Aperto

Ø	Tipo	Codice
4.8	Aperto	ABC/DA-CR-00

## PSD Compatibile Locator



Ø	Alt.	Codice
4.8	1	ABC/DA-LR-01
4.8	2	ABC/DA-LR-02
4.8	3	ABC/DA-LR-03

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00

ULTERIORI ACCESSORI E RICAMBI VEDERE PAGINA 91



COMPATIBILE

Straumann® Tissue Level®

Ø 4.8 - Ø 6.5

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

DA

### MultiUnit 0°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
4.8	0,9	0°	ABC/DA-MR-01

### MultiUnit System



Codice	Analogo
ABC/AB-AR-00	



Codice	Incollaggio
ABC/AB-IR-01	



Codice	CoCr
ABC/AB-BR-01	



Ang.	Codice	CoCr 360
15°	ABC/AB-BR-11	TPA <sup>30°</sup>
25°	ABC/AB-BR-21	



Codice	Calcinabile
ABC/AB-RR-00	



Codice	Provisori Ti
ABC/AB-PR-00	



Unigrip	TiN	TPA	Tipo	Codice	Viti
			Unigrip	ABC/AB-TR-00	
			TiN	ABC/AB-TR-00/TiN	
			TPA	ABC/AB-TR-50	




Aperto	Chiuso	Tipo	Codice	Transfer Impronta
		Aperto	ABC/AB-CR-00	
		Chiuso	ABC/AB-CR-01	



Plastica	Titanio	Tipo	Codice	Guarigione
		Plastica	ABC/AB-DR-00	
		Titanio	ABC/AB-DR-01	

### Strumenti e Accessori

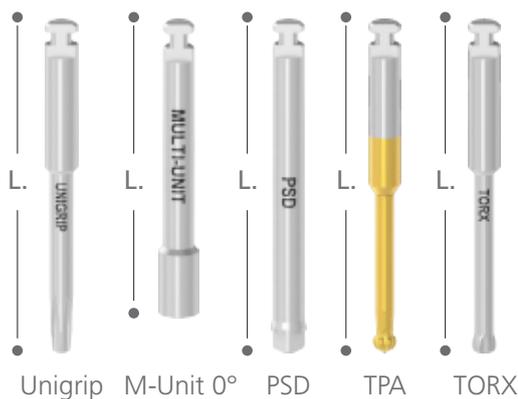

Punta	L.	Codice
Unigrip	18 mm.	ABC/PU-00-18
Unigrip	25 mm.	ABC/PU-00-25
Unigrip	32 mm.	ABC/PU-00-32
M-Unit 0°	20 mm.	ABC/LL-AB-00
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01
Torx	18 mm.	ABC/PT-00-18
Torx	25 mm.	ABC/PT-00-25
Torx	32 mm.	ABC/PT-00-32

← TORNA ALL'INDICE



COMPATIBILE

Straumann® Bone Level®

Ø 3.3 - Ø 4.1

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

DB

## Straumann® Bone Level®

Compatibile con:  
**IMPLANT DIRECT® SWISHACTIVE™**

## Analogo



Ø	Codice
3.3	ABC/DB-AN-00
4.1	ABC/DB-AR-00

## Viti TPA



Ø	Codice
3.3/4.1	ABC/DB-TR-50

## Viti Torx

TiN



Ø	Codice
3.3/4.1	ABC/DB-TR-00
3.3/4.1	ABC/DB-TR-00/TiN

## Incollaggio



Non Rotante/NR      Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.3	1.0	NR	ABC/DB-IN-00
3.3	1.0	R	ABC/DB-IN-01
3.3	2.5	NR	ABC/DB-IN-02
3.3	2.5	R	ABC/DB-IN-03
4.1	1.0	NR	ABC/DB-IR-00
4.1	1.0	R	ABC/DB-IR-01
4.1	2.5	NR	ABC/DB-IR-02
4.1	2.5	R	ABC/DB-IR-03

## Asse Angolato



Non Rotante/NR      Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.3	1.0	NR	ABC/DB-IN-30
3.3	1.0	R	ABC/DB-IN-31
4.1	1.0	NR	ABC/DB-IR-30
4.1	1.0	R	ABC/DB-IR-31



COMPATIBILE

Straumann® Bone Level®

Ø 3.3 - Ø 4.1

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggi Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.3	NR	ABC/DB-BN-00
3.3	R	ABC/DB-BN-01
4.1	NR	ABC/DB-BR-00
4.1	R	ABC/DB-BR-01

## Asse Angolato 360 CoCr

TPA<sup>30°</sup>

Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Ang.	NR/R	Codice
3.3	15°	NR	ABC/DB-BN-10
3.3	15°	R	ABC/DB-BN-11
4.1	15°	NR	ABC/DB-BR-10
4.1	15°	R	ABC/DB-BR-11

DB

## Calcinabile



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.3	NR	ABC/DB-HN-00
3.3	R	ABC/DB-RN-00
4.1	NR	ABC/DB-HR-00
4.1	R	ABC/DB-RR-00

## Monconi Provvisori



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.3	NR	ABC/DB-PN-06
3.3	R	ABC/DB-PN-07
4.1	NR	ABC/DB-PR-06
4.1	R	ABC/DB-PR-07

← TORNA ALL'INDICE



COMPATIBILE

Straumann® Bone Level®

Ø 3.3 - Ø 4.1

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

DB

## Monconi 0° - 17°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.3	2	0°	ABC/BOL-MT-332
4.1	2	0°	ABC/DB-PR-00

Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.3	2	17°	ABC/BOL-MT-3317
4.1	2	17°	ABC/BOL-MT-4717

## Monconi di Guarigione



Ø	Alt.	Codice
3.3	2	ABC/DB-DN-02
3.3	3,5	ABC/DB-DN-03
3.3	5	ABC/DB-DN-05
4.1	2	ABC/DB-DR-02
4.1	4	ABC/DB-DR-04
4.1	6	ABC/DB-DR-06

## Transfer Impronta

Cucchiaio  
Aperto

Ø	Tipo	Codice
3.3	Aperto	ABC/DB-CN-00
4.1	Aperto	ABC/DB-CR-00

## PSD Compatibile Locator



Ø	Alt.	Codice
3.3	1	ABC/DB-LN-01
3.3	2	ABC/DB-LN-02
3.3	3	ABC/DB-LN-03
3.3	4	ABC/DB-LN-04
3.3	5	ABC/DB-LN-05
4.1	1	ABC/DB-LR-01
4.1	2	ABC/DB-LR-02
4.1	3	ABC/DB-LR-03
4.1	4	ABC/DB-LR-04
4.1	5	ABC/DB-LR-05

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00

ULTERIORI ACCESSORI E RICAMBI VEDERE PAGINA 91



COMPATIBILE

Straumann® Bone Level®

Ø 3.3 - Ø 4.1

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

DB

## MultiUnit 0° - 17° - 30°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.3	1.5	0°	ABC/DB-MN-01
3.3	2.5	0°	ABC/DB-MN-02
3.3	3.5	0°	ABC/DB-MN-03
3.3	4.5	0°	ABC/DB-MN-04
4.1	1.5	0°	ABC/DB-MR-01
4.1	2.5	0°	ABC/DB-MR-02
4.1	3.5	0°	ABC/DB-MR-03
4.1	4.5	0°	ABC/DB-MR-04

Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.3	2.5	17°	ABC/DB-MN-12
3.3	3.5	17°	ABC/DB-MN-13
4.1	2.5	17°	ABC/DB-MR-12
4.1	3.5	17°	ABC/DB-MR-13
3.3	3.5	30°	ABC/DB-MN-33
3.3	4.5	30°	ABC/DB-MN-34
4.1	3.5	30°	ABC/DB-MR-33
4.1	4.5	30°	ABC/DB-MR-34

## MultiUnit System



Codice	Analogo
ABC/AB-AR-00	



Codice	Incollaggio
ABC/AB-IR-01	



Codice	CoCr
ABC/AB-BR-01	



Ang.	Codice	CoCr 360
15°	ABC/AB-BR-11	TPA <sup>30°</sup>
25°	ABC/AB-BR-21	



Codice	Calcinabile
ABC/AB-RR-00	



Codice	Provisori Ti
ABC/AB-PR-00	



Tipo	Codice	Viti
Unigrip	ABC/AB-TR-00	
TiN	ABC/AB-TR-00/TiN	
TPA	ABC/AB-TR-50	




Tipo	Codice	Transfer Impronta
Aperto	ABC/AB-CR-00	
Chiuso	ABC/AB-CR-01	




Tipo	Codice	Guarigione
Plastica	ABC/AB-DR-00	
Titanio	ABC/AB-DR-01	

## Strumenti e Accessori

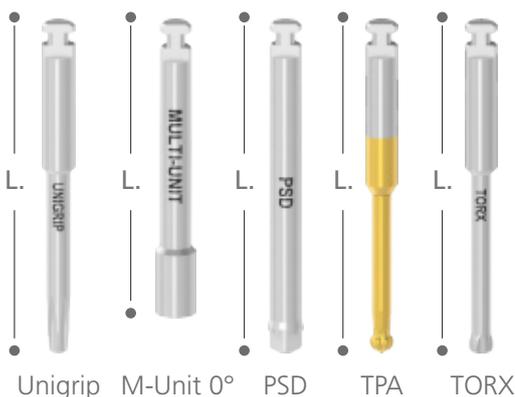

Punta	L.	Codice
Unigrip	18 mm.	ABC/PU-00-18
Unigrip	25 mm.	ABC/PU-00-25
Unigrip	32 mm.	ABC/PU-00-32
M-Unit 0°	20 mm.	ABC/LL-AB-00
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01
Torx	18 mm.	ABC/PT-00-18
Torx	25 mm.	ABC/PT-00-25
Torx	32 mm.	ABC/PT-00-32

← TORNA ALL'INDICE

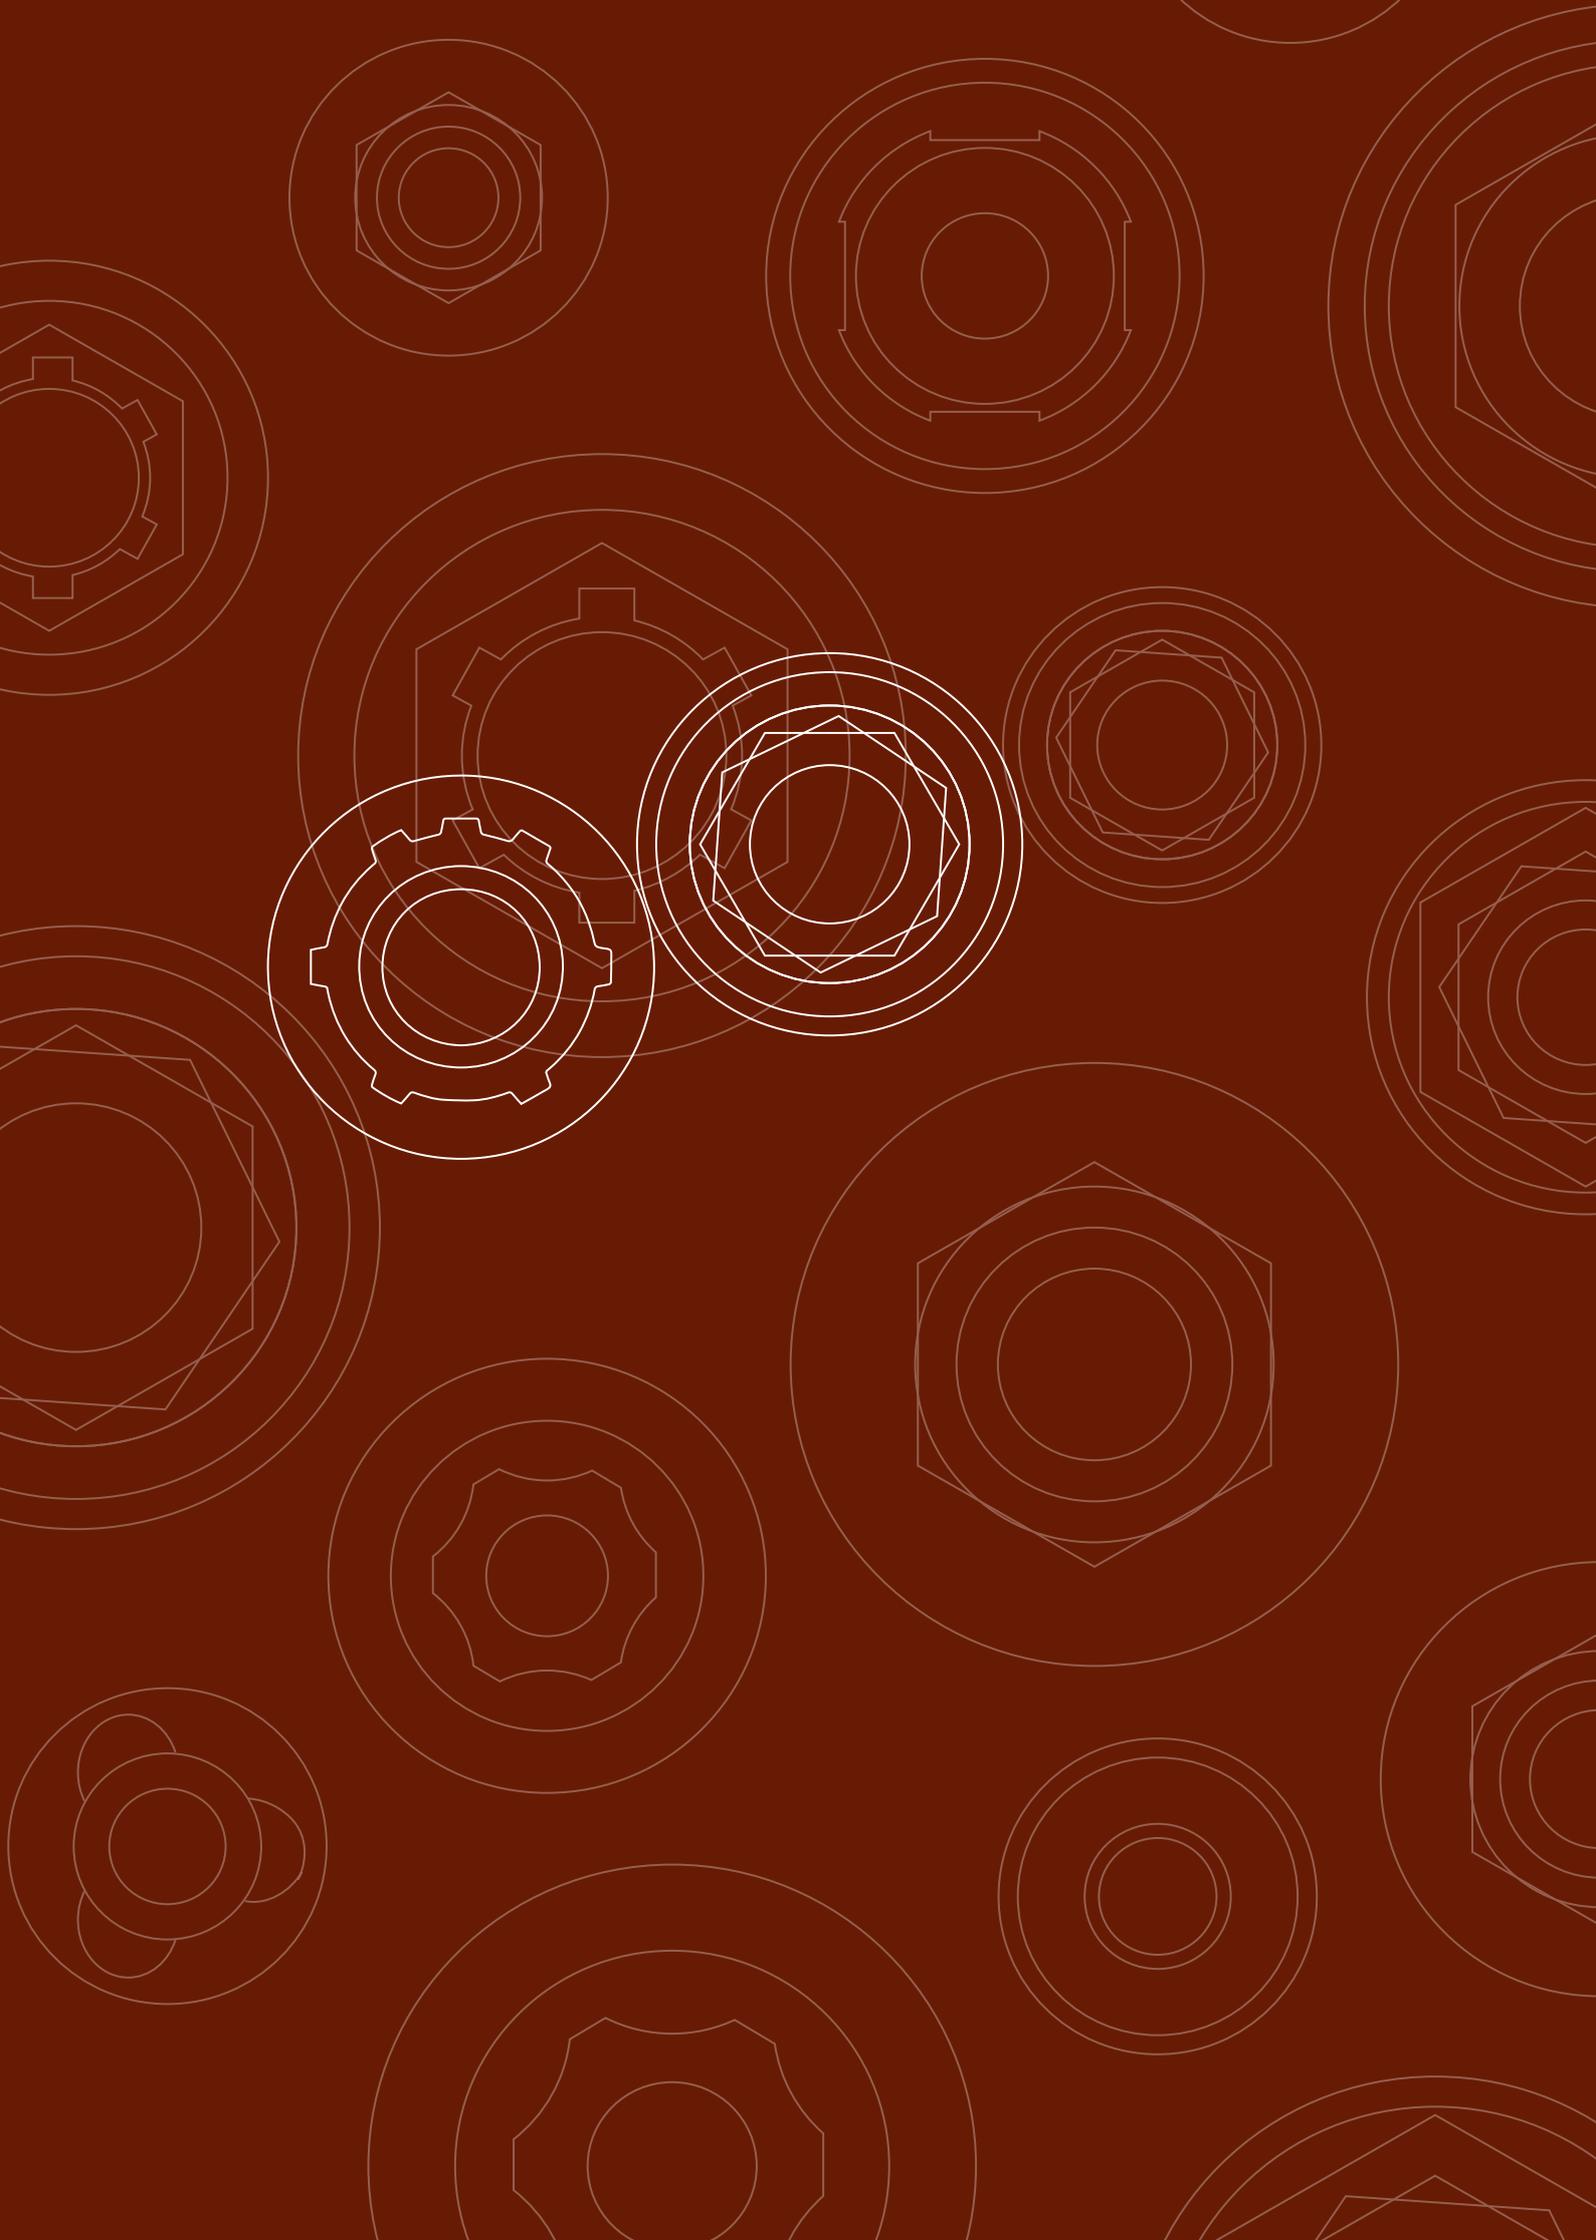

**ASTRA®**

**COMPATIBILITA'**

**OSSEOSPEED™**

**EVOLUTION®**

**SERIE**

**EA**

**EB**



COMPATIBILE

Astra® Osseospeed™ Tx

Ø 3.0 - Ø 3.5-4 - Ø 4.5-5

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

EA

## Astra® Osseospeed™ Tx

Compatibile con:  
GEASS® WAY MILANO®

## Viti TPA



Ø	Codice
3.0	ABC/EA-TN-50
3.5-4	ABC/EA-TR-50
3.5-4	ABC/AC-TR-51
3.5-4/ 4.5-5	ABC/EA-TR-51*

\*PER UNI ABUTMENT 20°

## Incollaggio



Non Rotante/NR		Rotante/R	
Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.0	1.5	NR	ABC/EA-IN-00
3.0	1.5	R	ABC/EA-IN-01
3.0	2.5	NR	ABC/EA-IN-02
3.0	2.5	R	ABC/EA-IN-03
3.5-4	1.1	NR	ABC/EA-IR-00
3.5-4	1.1	R	ABC/EA-IR-01
3.5-4	2.5	NR	ABC/EA-IR-02
3.5-4	2.5	R	ABC/EA-IR-03
4.5-5	0.9	NR	ABC/EA-IW-00
4.5-5	0.9	R	ABC/EA-IW-01
4.5-5	2.5	NR	ABC/EA-IW-02
4.5-5	2.5	R	ABC/EA-IW-03

## Analogo



Ø	Codice
3.0	ABC/EA-AN-00
3.5-4	ABC/EA-AR-00
4.5-5	ABC/EA-AW-00
UNI20°	ABC/EA-AR-01*

\*PER UNI ABUTMENT 20°

## Viti Esagono 1.27

TiN



Ø	Codice
3.0	ABC/EA-TN-00
3.0	ABC/EA-TN-00/TiN
3.5-4	ABC/EA-TR-00
3.5-4	ABC/EA-TR-00/TiN
4.5-5	ABC/EA-TW-00
4.5-5	ABC/EA-TW-00/TiN
UNI20°	ABC/EA-TR-01*

\*PER UNI ABUTMENT 20°

## Asse Angolato



Non Rotante/NR		Rotante/R	
Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.0	1.5	NR	ABC/EA-IN-30
3.0	1.5	R	ABC/EA-IN-31
3.5-4	1.1	NR	ABC/EA-IR-30
3.5-4	1.1	R	ABC/EA-IR-31
4.5-5	0.9	NR	ABC/EA-IW-30
4.5-5	0.9	R	ABC/EA-IW-31



COMPATIBILE

Astra® Osseospeed™ Tx

Ø 3.0 - Ø 3.5-4 - Ø 4.5-5

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

EA

## Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.0	NR	ABC/EA-BN-00
3.0	R	ABC/EA-BN-01
3.5-4	NR	ABC/EA-BR-00
3.5-4	R	ABC/EA-BR-01
4.5-5	NR	ABC/EA-BW-00
4.5-5	R	ABC/EA-BW-01

AsseAngolato 360 CoCr TPA<sup>30°</sup>

Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Ang	NR/R	Codice
3.0	15°	NR	ABC/EA-BN-10
3.0	15°	R	ABC/EA-BN-11
3.0	25°	NR	ABC/EA-BN-20
3.0	25°	R	ABC/EA-BN-21
3.5-4	15°	NR	ABC/EA-BR-10
3.5-4	15°	R	ABC/EA-BR-11
3.5-4	25°	NR	ABC/EA-BR-20
3.5-4	25°	R	ABC/EA-BR-21
4.5-5	15°	NR	ABC/EA-BW-10
4.5-5	15°	R	ABC/EA-BW-11

## Calcinabile



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.0	NR	ABC/AT-30-CA
3.5-4	R	ABC/EA-RR-00
3.5-4	NR	ABC/EA-HR-00
4.5-5	R	ABC/EA-RW-00
4.5-5	NR	ABC/EA-HW-00
UNI20°	R	ABC/EA-RR-01*

\*PER UNI ABUTMENT 20°

## Monconi Provvisori



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.5-4	NR	ABC/EA-PR-06
3.5-4	R	ABC/EA-PR-07
4.5-5	NR	ABC/EA-PW-06
4.5-5	R	ABC/EA-PW-07

## UNI Abutment 20°



Ø	Alt.	Codice
3.5-4	0.5	ABC/PD-430-05
3.5-4	1.0	ABC/PD-430-1
3.5-4	2.0	ABC/PD-430-2
3.5-4	3.0	ABC/PD-430-3
3.5-4	4.0	ABC/PD-430-4
4.5-5	0.5	ABC/PD-431-05
4.5-5	1.0	ABC/PD-431-1
4.5-5	2.0	ABC/PD-431-2
4.5-5	4.0	ABC/PD-431-4

← TORNA ALL'INDICE



COMPATIBILE

Astra® Osseospeed™ Tx

Ø 3.0 - Ø 3.5-4 - Ø 4.5-5

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

EA

## Monconi 0° - 15° - 25°



Ø	Ang.	Alt.	Codice
3.0	0°	-	ABC/AT-30-MTF
3.5-4	0°	2.0	ABC/EA-PR-00
4.5-5	0°	2.0	ABC/EA-PW-00

Ø	Ang.	Alt.	Codice
3.0	15°	2.0	ABC/AT-30-MT-152
3.5-4	15°	2.0	ABC/AT-35-MT-152
3.5-4	15°	3.0	ABC/AT-35-MT-153
3.5-4	25°	2.0	ABC/AT-35-MT-252
4.5-5	15°	2.0	ABC/AT-45-MT-152
4.5-5	15°	3.0	ABC/AT-45-MT-153
4.5-5	25°	2.0	ABC/AT-45-MT-252

## Monconi di Guarigione



Ø	Alt.	Codice
3.0	2.0	ABC/AT-30-VG2
3.0	4.0	ABC/AT-30-VG4
3.5-4	2.0	ABC/EA-DR-02
3.5-4	4.0	ABC/EA-DR-04
3.5-4	6.0	ABC/EA-DR-06
4.5-5	2.0	ABC/EA-DW-02
4.5-5	4.0	ABC/EA-DW-04
4.5-5	6.0	ABC/EA-DW-06

## Transfer Impronta

Cucchiaio  
Aperto

Ø	Tipo	Codice
3.0	Aperto	ABC/EA-CN-00
3.5-4	Aperto	ABC/EA-CR-00
4.5-5	Aperto	ABC/EA-CW-00

## PSD Compatibile Locator



Ø	Alt.	Codice
3.5-4	1	ABC/EA-LR-01
3.5-4	3	ABC/EA-LR-03
3.5-4	5	ABC/EA-LR-05
4.5-5	1	ABC/EA-LW-01
4.5-5	3	ABC/EA-LW-03
4.5-5	5	ABC/EA-LW-05

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00

ULTERIORI ACCESSORI E RICAMBI VEDERE PAGINA 91



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.


### MultiUnit 0° - 17° - 30°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5-4	1.5	0°	ABC/EA-MR-01
3.5-4	2.5	0°	ABC/EA-MR-02
3.5-4	3.5	0°	ABC/EA-MR-03
3.5-4	4.5	0°	ABC/EA-MR-04
4.5-5	1.5	0°	ABC/EA-MW-01
4.5-5	2.5	0°	ABC/EA-MW-02
4.5-5	3.5	0°	ABC/EA-MW-03
4.5-5	4.5	0°	ABC/EA-MW-04

Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5-4	2.5	17°	ABC/EA-MR-12
3.5-4	3.5	17°	ABC/EA-MR-13
4.5-5	2.5	17°	ABC/EA-MW-12
4.5-5	3.5	17°	ABC/EA-MW-13
3.5-4	3.5	30°	ABC/EA-MR-33
3.5-4	4.5	30°	ABC/EA-MR-34
4.5-5	3.5	30°	ABC/EA-MW-33
4.5-5	4.5	30°	ABC/EA-MW-34

### Strumenti e Accessori

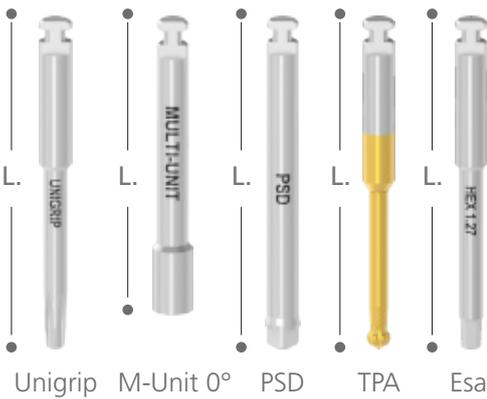

Punta	L.	Codice
Unigrip	18 mm.	ABC/PU-00-18
Unigrip	25 mm.	ABC/PU-00-25
Unigrip	32 mm.	ABC/PU-00-32
M-Unit 0°	20 mm.	ABC/LL-AB-00
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01
Esagonale 1.27	18 mm.	ABC/PH-27-18
Esagonale 1.27	25 mm.	ABC/PH-27-25
Esagonale 1.27	32 mm.	ABC/PH-27-32

### MultiUnit System



Codice	Analogo
ABC/AB-AR-00	



Codice	Incollaggio
ABC/AB-IR-01	



Codice	CoCr
ABC/AB-BR-01	



Ang.	Codice	CoCr 360
15°	ABC/AB-BR-11	TPA <sup>30°</sup>
25°	ABC/AB-BR-21	



Codice	Calcinabile
ABC/AB-RR-00	



Codice	Provisori Ti
ABC/AB-PR-00	



Tipo	Codice	Viti
Unigrip	ABC/AB-TR-00	
TiN	ABC/AB-TR-00/TiN	
TPA	ABC/AB-TR-50	



Tipo	Codice	Transfer Impronta
Aperto	ABC/AB-CR-00	
Chiuso	ABC/AB-CR-01	



Tipo	Codice	Guarigione
Plastica	ABC/AB-DR-00	
Titanio	ABC/AB-DR-01	



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

EB

### Analogo



Ø	Codice
3.6	ABC/EB-AN-00
4.2	ABC/EB-AR-00

### Viti TPA



Ø	Codice
3.6	ABC/EB-TN-50
4.2	ABC/EB-TR-50

### Viti Esagono 1.27

TiN



Ø	Codice
3.6	ABC/EB-TN-00
3.6	ABC/EB-TN-00/TiN
4.2	ABC/EB-TR-00
4.2	ABC/EB-TR-00/TiN

### Incollaggio



Non Rotante/NR			Rotante/R
Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.6	1.0	NR	ABC/EB-IN-00
3.6	1.0	R	ABC/EB-IN-01
4.2	1.0	NR	ABC/EB-IR-00
4.2	1.0	R	ABC/EB-IR-01

### Asse Angolato



Non Rotante/NR			Rotante/R
Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.6	1.0	NR	ABC/EB-IN-30
3.6	1.0	R	ABC/EB-IN-31
4.2	1.0	NR	ABC/EB-IR-30
4.2	1.0	R	ABC/EB-IR-31



COMPATIBILE

Astra® Evolution® EV

Ø 3.6 - Ø 4.2

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.6	NR	ABC/EB-BN-00
3.6	R	ABC/EB-BN-01
4.2	NR	ABC/EB-BR-00
4.2	R	ABC/EB-BR-01

Asse Angolato 360 CoCr TPA<sup>30°</sup>

Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Ang	NR/R	Codice
3.6	15°	NR	ABC/EB-BN-10
3.6	15°	R	ABC/EB-BN-11
3.6	25°	NR	ABC/EB-BN-20
3.6	25°	R	ABC/EB-BN-21
4.2	15°	NR	ABC/EB-BR-10
4.2	15°	R	ABC/EB-BR-11
4.2	25°	NR	ABC/EB-BR-20

## PSD Compatibile Locator




Ø	Alt.	Codice
4.2	1	ABC/EB-LR-01
4.2	3	ABC/EB-LR-03
4.2	5	ABC/EB-LR-05

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00


## Strumenti e Accessori

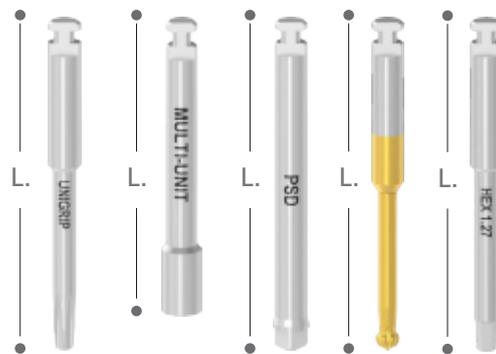


Unigrip M-Unit 0° PSD TPA Esa

Punta	L.	Codice
Unigrip	18 mm.	ABC/PU-00-18
Unigrip	25 mm.	ABC/PU-00-25
Unigrip	32 mm.	ABC/PU-00-32
M-Unit 0°	20 mm.	ABC/LL-AB-00
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01
Esagonale 1.27	18 mm.	ABC/PH-27-18
Esagonale 1.27	25 mm.	ABC/PH-27-25
Esagonale 1.27	32 mm.	ABC/PH-27-32

← TORNA ALL'INDICE

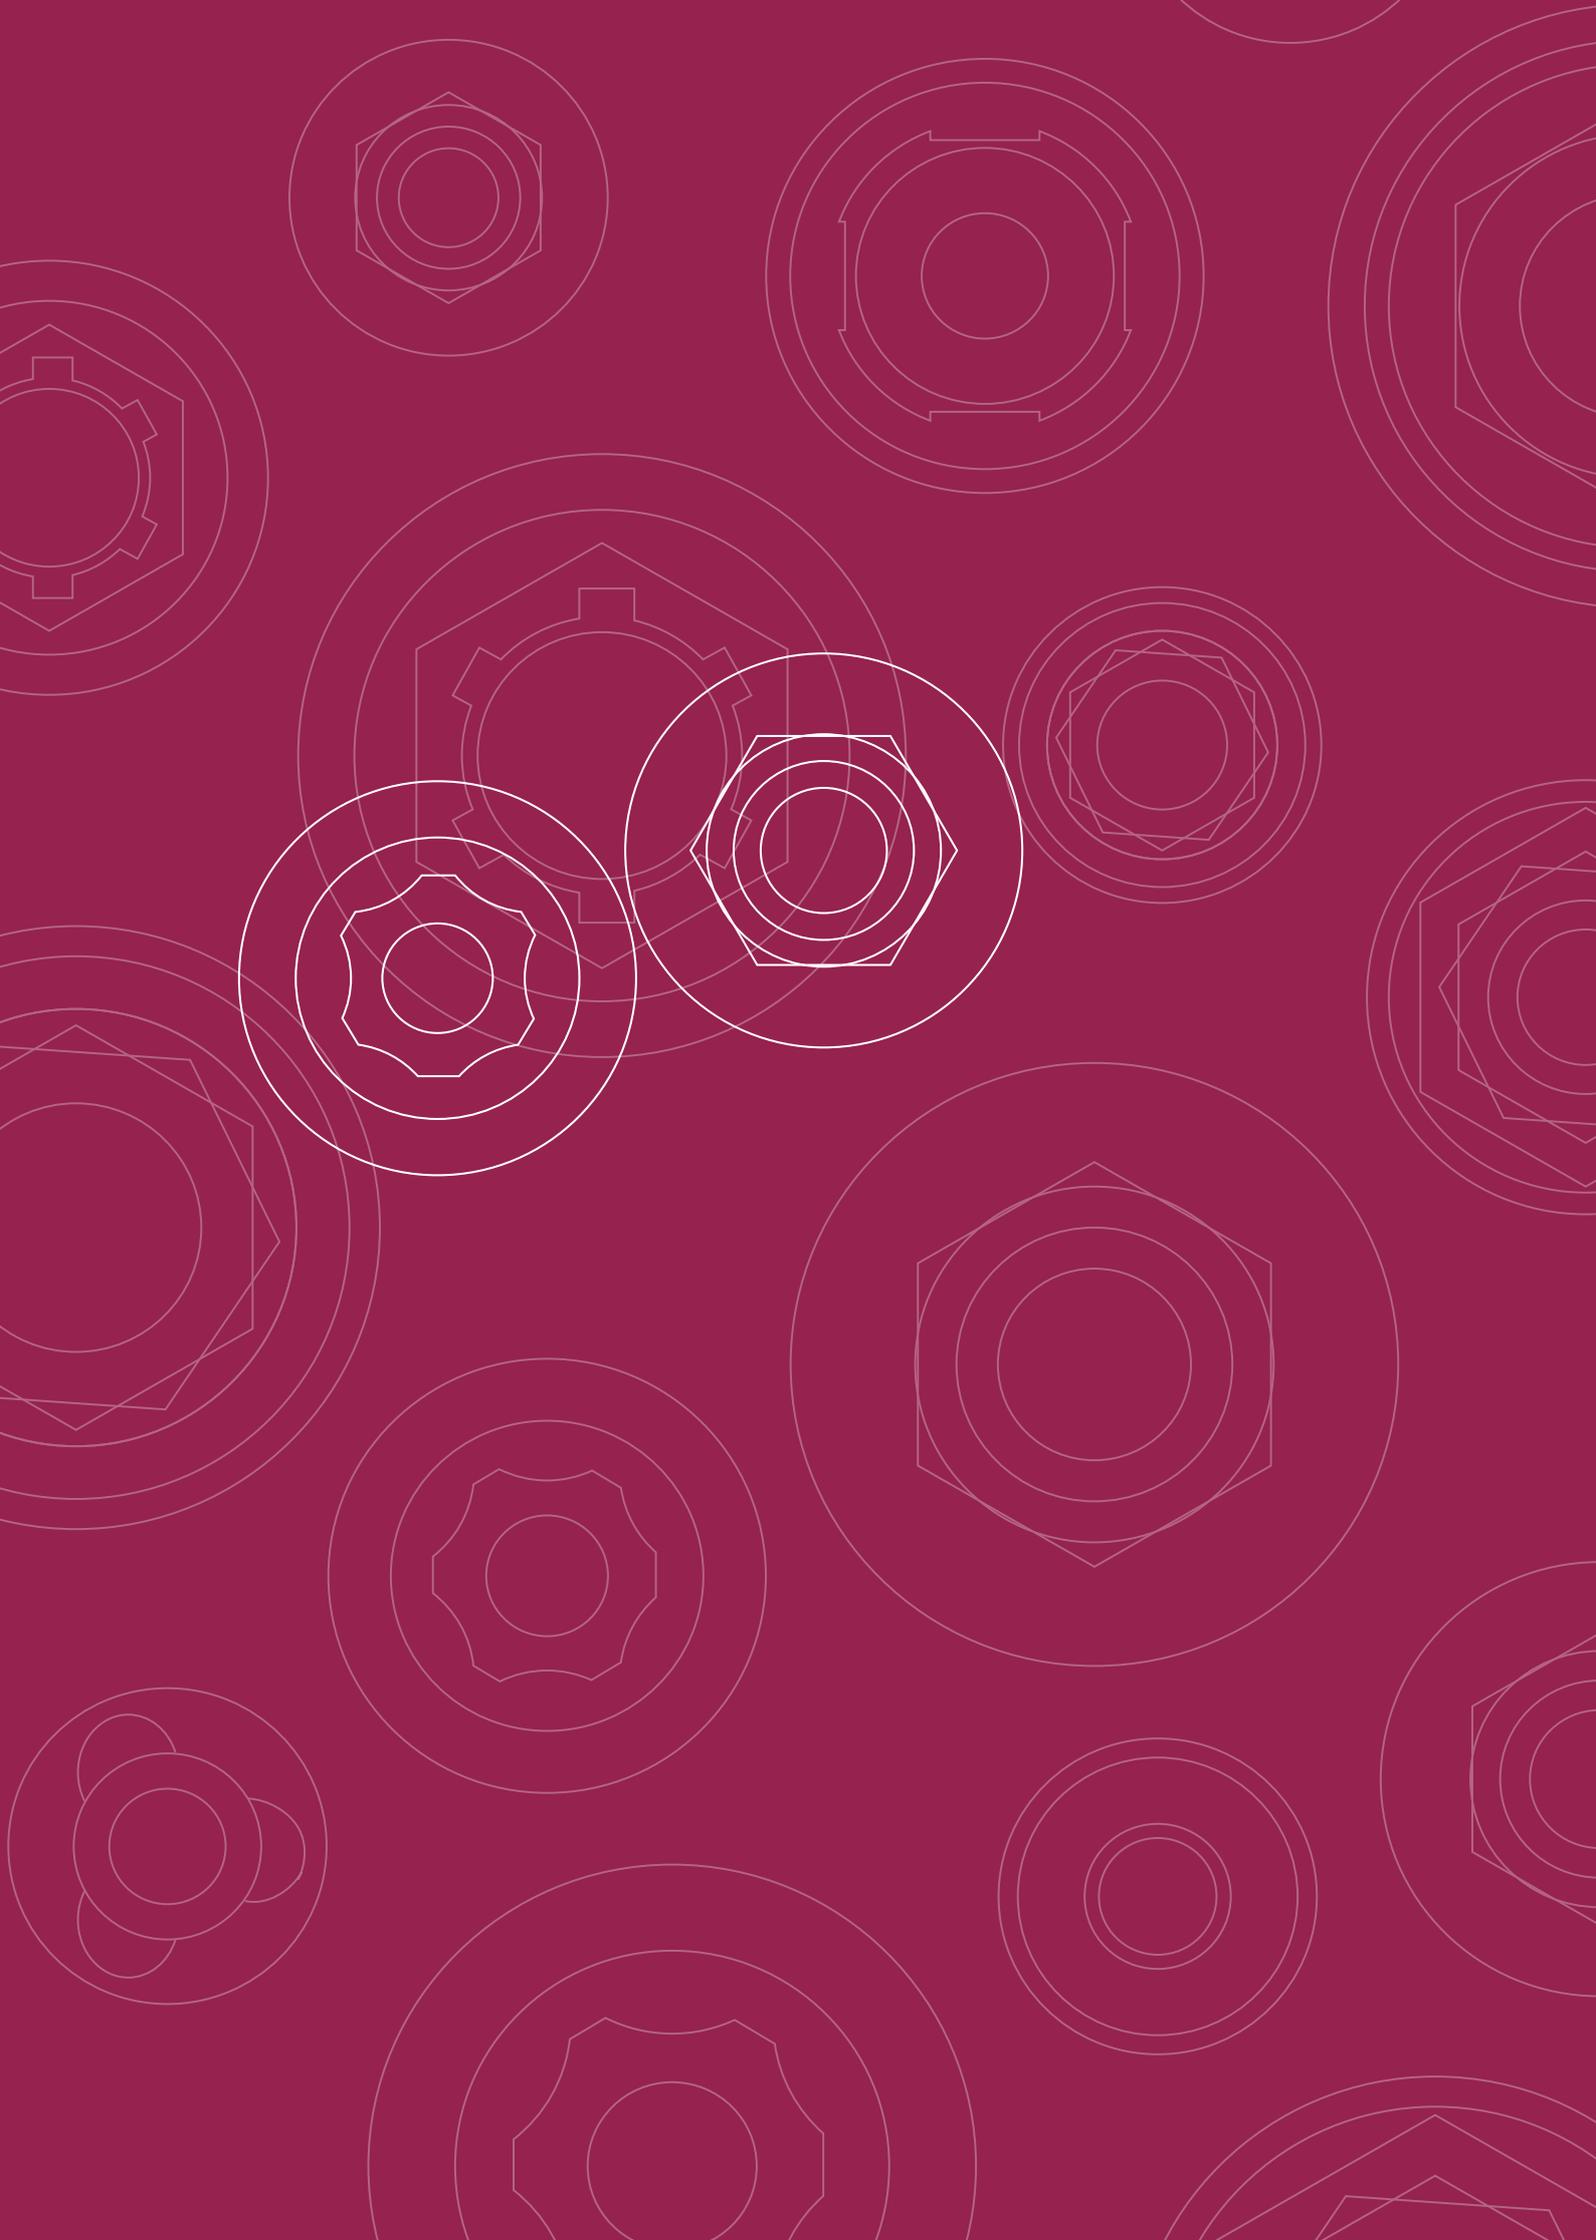

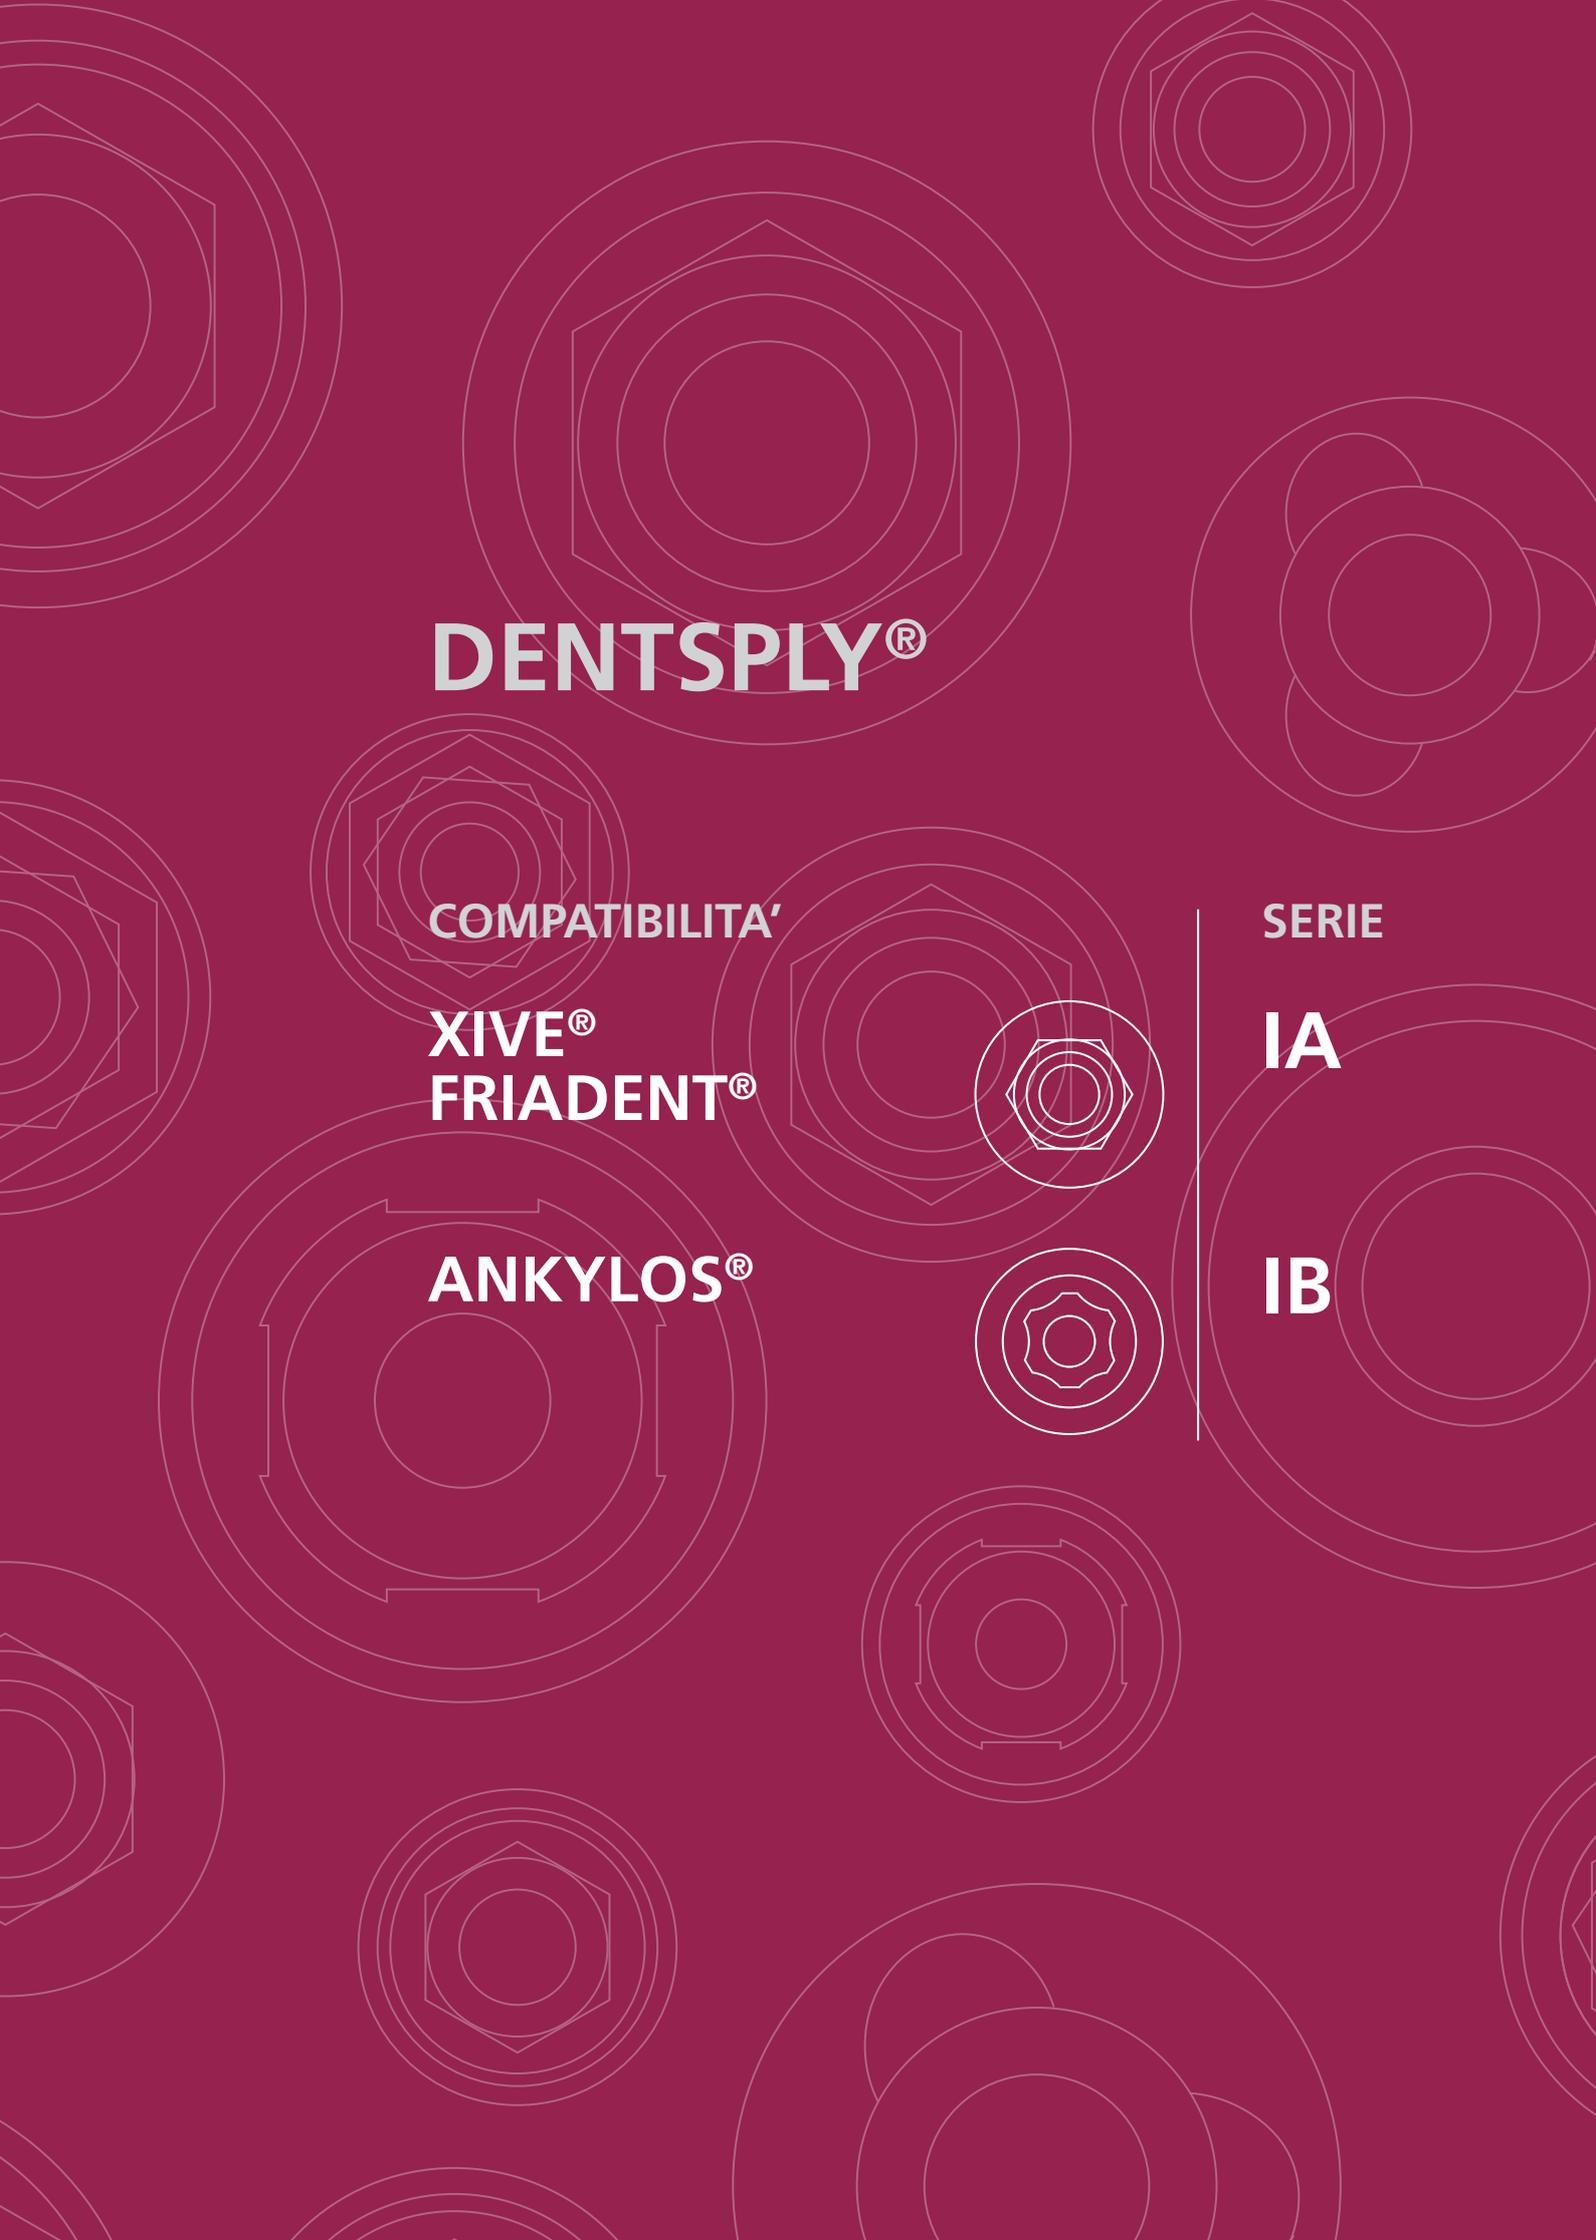

**DENTSPLY®**

**COMPATIBILITA'**

**XIVE®  
FRIADENT®**

**ANKYLOS®**

**SERIE**

**IA**

**IB**



COMPATIBILE

Dentsply Friadent® Xive®

Ø 3.4 - Ø 3.8 - Ø 4.5

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

IA

## Dentsply Friadent® Xive®

Compatibile con:  
GEASS® KENTRON®

## Analogo



Ø	Codice
3.4	ABC/IA-AN-00
3.8	ABC/IA-AR-00
4.5	ABC/IA-AW-00

## Viti TPA



Ø	Codice
3.4-3.8-4.5	ABC/IA-TR-50

## Viti Esagono 1.20

TiN



Ø	Codice
3.4-3.8-4.5	ABC/IA-TR-00
3.4-3.8-4.5	ABC/IA-TR-00/TiN

## Incollaggio



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.4	1.0	NR	ABC/IA-IN-00
3.4	1.0	R	ABC/IA-IN-01
3.8	0.5	NR	ABC/IA-IR-00
3.8	0.5	R	ABC/IA-IR-01
4.5	0.3	NR	ABC/IA-IW-00
4.5	0.3	R	ABC/IA-IW-01

## Asse Angolato



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.4	1.0	NR	ABC/IA-IN-30
3.4	1.0	R	ABC/IA-IN-31
3.8	0.5	NR	ABC/IA-IR-30
3.8	0.5	R	ABC/IA-IR-31
4.5	0.3	NR	ABC/IA-IW-30
4.5	0.3	R	ABC/IA-IW-31



COMPATIBILE

Dentsply Friadent® Xive®

Ø 3.4 - Ø 3.8 - Ø 4.5

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.4	NR	ABC/IA-BN-00
3.4	R	ABC/IA-BN-01
3.8	NR	ABC/IA-BR-00
3.8	R	ABC/IA-BR-01

AsseAngolato 360 CoCr TPA<sup>30°</sup>

Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Ang	NR/R	Codice
3.8	15°	NR	ABC/IA-BR-10
3.8	15°	R	ABC/IA-BR-11
3.8	25°	NR	ABC/IA-BR-20
3.8	25°	R	ABC/IA-BR-21

## Calcinabile




Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.4	NR	ABC/IA-HN-00
3.4	R	ABC/IA-RN-00
3.8	NR	ABC/IA-HR-00
3.8	R	ABC/IA-RR-00
4.5	NR	ABC/IA-HW-00
4.5	R	ABC/IA-RW-00

## Strumenti e Accessori

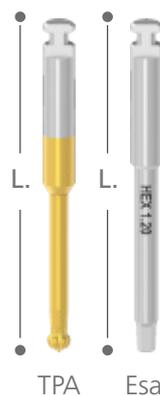

TPA Esa

Punta	L.	Codice
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01
Esagonale 1.20	18 mm.	ABC/PH-20-18
Esagonale 1.20	25 mm.	ABC/PH-20-25
Esagonale 1.20	32 mm.	ABC/PH-20-32



COMPATIBILE

Dentsply Friadent® Ankylos® C/X

Ø 3.5

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

IB

## Analogo



Ø	Codice
3.5	ABC/IB-AR-00

## Viti TPA



Ø	Codice
3.5	ABC/IB-TR-51

## Viti Esagono 1.0



Ø	Codice
3.5	ABC/IB-TR-00
3.5	ABC/IB-TR-01
3.5	ABC/IB-TR-02

ABC/IB-TR-00 • VITE PER BALANCE BASE NARROW  
 ABC/IB-TR-01 • VITE PER INCOLLAGGIO ROTANTE  
 ABC/IB-TR-02 • VITE PER MONCONI ORIGINALI ANKYLOS®

## Transfer Impronta

Cucchiaino  
Aperto

Ø	Tipo	Codice
3.5	Aperto	ABC/IB-CR-00

## Monconi di Guarigione



Ø	Alt.	Codice
3.5	3.0	ABC/IB-DR-03

## Incollaggio



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	1.0	NR	ABC/IB-IR-00
3.5	1.0	R	ABC/IB-IR-01
3.5	2.0	NR	ABC/IB-IR-02
3.5	2.0	R	ABC/IB-IR-03

## AsseAngolato



Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	1.0	R	ABC/IB-IR-31





**ZIMMER®**

**COMPATIBILITA'**

**SCREW VENT®**



**SERIE**

**FA**



COMPATIBILE

Zimmer® ScrewVent®

Ø 3.5 - Ø 4.5 - Ø 5.7

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

FA

## Zimmer® SrewVent®

Compatibile con:

ABUTMENT COMPATIBILI® ARIAL CX e LT  
 ALPHA BIO® SPI®, ICE®, DFI®, ATID® e NEO®  
 MISS® SEVEN® (Ø 3,75 - Ø 4,2 - Ø 5,0)  
 JDENTAL CARE® JDEVOLUTION® PLUS+  
 WHITEK® VECTOR®  
 NORIS MEDICAL® TUFF® e ONYX®  
 IMPLANT DIRECT® LEGACY®  
 KRUGG® INTERNAL®  
 KRISTAL® BIO IMPLANT® CORE V2® e K-CORE V2®

## Analogo



Ø	Codice
3.5	ABC/FA-AN-00
4.5	ABC/FA-AR-00
5.7	ABC/FA-AW-00

## Viti TPA



Ø	Codice
3.5-4.5-5.7	ABC/FA-TR-50

## Viti Esagono 1.25

TiN



Ø	Codice
3.5-4.5-5.7	ABC/FA-TR-00
3.5-4.5-5.7	ABC/FA-TR-00/TiN

## Incollaggio



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	0.9	NR	ABC/FA-IN-00
3.5	0.9	R	ABC/FA-IN-01
3.5	2.5	NR	ABC/FA-IN-02
3.5	2.5	R	ABC/FA-IN-03
4.5	0.1	NR	ABC/FA-IR-00
4.5	0.1	R	ABC/FA-IR-01
4.5	1.5	NR	ABC/FA-IR-02
4.5	1.5	R	ABC/FA-IR-03
4.5	2.5	NR	ABC/FA-IR-04
4.5	2.5	R	ABC/FA-IR-05

## AsseAngolato



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	0.9	NR	ABC/FA-IN-30
3.5	0.9	R	ABC/FA-IN-31
4.5	0.1	NR	ABC/FA-IR-30
4.5	0.1	R	ABC/FA-IR-31



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggi Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

FA

## Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/NR      Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.5	NR	ABC/FA-BN-00
3.5	R	ABC/FA-BN-01
4.5	NR	ABC/FA-BR-00
4.5	R	ABC/FA-BR-01

## AsseAngolato 360 CoCr TPA<sup>30°</sup>



Non Rotante/NR      Rotante/R

Ø	Ang	NR/R	Codice
3.5	15°	NR	ABC/FA-BN-10
3.5	15°	R	ABC/FA-BN-11
3.5	25°	NR	ABC/FA-BN-20
3.5	25°	R	ABC/FA-BN-21
4.5	15°	NR	ABC/FA-BR-10
4.5	15°	R	ABC/FA-BR-11
4.5	25°	NR	ABC/FA-BR-20
4.5	25°	R	ABC/FA-BR-21

## Calcinabile



Non Rotante/NR      Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.5	NR	ABC/FA-HN-00
3.5	R	ABC/FA-RN-00
4.5	NR	ABC/FA-HR-00
4.5	R	ABC/FA-RR-00
5.7	NR	ABC/FA-HW-00
5.7	R	ABC/FA-RW-00

## Monconi Provvvisori



Non Rotante/NR      Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.5	NR	ABC/FA-PN-06
3.5	R	ABC/FA-PN-07
4.5	NR	ABC/FA-PR-06
4.5	R	ABC/FA-PR-07



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

FA

## Monconi 0° - 15° - 25°



Ø	Ang.	Alt.	Codice
3.5	0°	1.0	ABC/FA-PN-00
3.5	0°	2.0	ABC/FA-PN-01
4.5	0°	1.0	ABC/DP-10-0A
4.5	0°	2.0	ABC/DP-10-1A
4.5	0°	3.0	ABC/DP-10-2A

Ø	Ang.	Alt.	Codice
3.5	15°	1.0	ABC/FA-PN-02
3.5	15°	2.0	ABC/FA-PN-03
4.5	15°	2.0	ABC/DP-02-C

Ø	Ang.	Alt.	Codice
3.5	25°	1.0	ABC/FA-PN-04
3.5	25°	2.0	ABC/FA-PN-05

## Monconi di Guarigione



Ø	Alt.	Codice
3.5	1.5	ABC/FA-DN-01
3.5	3.0	ABC/FA-DN-03
3.5	5.0	ABC/FA-DN-05
4.5	1.5	ABC/FA-DR-01
4.5	3.0	ABC/FA-DR-03
4.5	5.0	ABC/FA-DR-05

## Transfer Impronta



Cucchiaio  
Aperto

Ø	Tipo	Codice
3.5		ABC/FA-CN-00
4.5		ABC/FA-CR-00
5.7		ABC/FA-CW-00

## PSD Compatibile Locator



Ø	Alt.	Codice
3.5	1	ABC/FA-LN-01
3.5	2	ABC/FA-LN-02
3.5	3	ABC/FA-LN-03
3.5	4	ABC/FA-LN-04
3.5	5	ABC/FA-LN-05
4.5	1	ABC/FA-LR-01
4.5	3	ABC/FA-LR-03
4.5	5	ABC/FA-LR-05

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00

ULTERIORI ACCESSORI E RICAMBI VEDERE PAGINA 91



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

### MultiUnit 0° - 17° - 30°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5	1.5	0°	ABC/FA-MN-01
3.5	2.5	0°	ABC/FA-MN-02
3.5	3.5	0°	ABC/FA-MN-03
3.5	4.5	0°	ABC/FA-MN-04
4.5	1.5	0°	ABC/FA-MR-01
4.5	2.5	0°	ABC/FA-MR-02
4.5	3.5	0°	ABC/FA-MR-03
4.5	4.5	0°	ABC/FA-MR-04

Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5	2.5	17°	ABC/FA-MN-12
3.5	3.5	17°	ABC/FA-MN-13
4.5	3.0	17°	ABC/FA-MR-13
4.5	4.0	17°	ABC/FA-MR-14
3.5	3.5	30°	ABC/FA-MN-33
3.5	4.5	30°	ABC/FA-MN-34
4.5	3.5	30°	ABC/FA-MR-33
4.5	4.5	30°	ABC/FA-MR-34

### Strumenti e Accessori



Punta	L.	Codice
Unigrip	18 mm.	ABC/PU-00-18
Unigrip	25 mm.	ABC/PU-00-25
Unigrip	32 mm.	ABC/PU-00-32
M-Unit 0°	20 mm.	ABC/LL-AB-00
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01
Esagonale 1.25	18 mm.	ABC/PH-25-18
Esagonale 1.25	25 mm.	ABC/PH-25-25
Esagonale 1.25	32 mm.	ABC/PH-25-32

### MultiUnit System



Codice	Analogo
ABC/AB-AR-00	



Codice	Incollaggio
ABC/AB-IR-01	



Codice	CoCr
ABC/AB-BR-01	



Ang.	Codice	CoCr 360
15°	ABC/AB-BR-11	TPA <sup>30°</sup>
25°	ABC/AB-BR-21	



Codice	Calcinabile
ABC/AB-RR-00	



Codice	Provisori Ti
ABC/AB-PR-00	



Tipo	Codice	Viti
Unigrip	ABC/AB-TR-00	
TiN	ABC/AB-TR-00/TiN	
TPA	ABC/AB-TR-50	



Tipo	Codice	Transfer Impronta
Aperto	ABC/AB-CR-00	
Chiuso	ABC/AB-CR-01	



Tipo	Codice	Guarigione
Plastica	ABC/AB-DR-00	
Titanio	ABC/AB-DR-01	



# BIOHORIZONS®

COMPATIBILITA'

TAPERED  
INTERNAL



SERIE

LB



COMPATIBILE

Biohorizons® Tapered Internal®

Ø 3.0 - Ø 3.5 - Ø 4.5 - Ø 5.7

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

LB

## Biohorizons® Tapered Internal®

Compatibile con:  
JDENTAL CARE® JDEVOLUTION®

## Analogo



Ø	Codice
3.0	ABC/LB-AT-00
3.5	ABC/LB-AN-00
4.5	ABC/LB-AR-00
5.7	ABC/LB-AW-00

## Viti TPA



Ø	Codice
3.0-3.5-4.5-5.7	ABC/LB-TR-50

## Viti Esagono 1.25

TiN



Ø	Codice
3.0-3.5-4.5-5.7	ABC/LB-TR-00
3.0-3.5-4.5-5.7	ABC/LB-TR-00/TiN

## Incollaggio



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	0.9	NR	ABC/LB-IN-00
3.5	0.9	R	ABC/LB-IN-01
4.5	0.1	NR	ABC/LB-IR-00
4.5	0.1	R	ABC/LB-IR-01

## AsseAngolato



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.5	0.9	NR	ABC/LB-IN-30
3.5	0.9	R	ABC/LB-IN-31
4.5	0.1	NR	ABC/LB-IR-30
4.5	0.1	R	ABC/LB-IR-31



COMPATIBILE

Biohorizons® Tapered Internal®

Ø 3.0 - Ø 3.5 - Ø 4.5 - Ø 5.7

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

LB

### Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/NR      Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.0	NR	ABC/LB-BT-00
3.0	R	ABC/LB-BT-01
3.5	NR	ABC/LB-BN-00
3.5	R	ABC/LB-BN-01
4.5	NR	ABC/LB-BR-00
4.5	R	ABC/LB-BR-01

### Asse Angolato 360 CoCr **TPA<sup>30°</sup>**



Non Rotante/NR      Rotante/R

Ø	Ang	NR/R	Codice
3.0	15°	NR	ABC/LB-BT-10
3.0	15°	R	ABC/LB-BT-11
3.0	25°	NR	ABC/LB-BT-20
3.0	25°	R	ABC/LB-BT-21
3.5	15°	NR	ABC/LB-BN-10
3.5	15°	R	ABC/LB-BN-11
3.5	25°	NR	ABC/LB-BN-20
3.5	25°	R	ABC/LB-BN-21
4.5	15°	NR	ABC/LB-BR-10
4.5	15°	R	ABC/LB-BR-11
4.5	25°	NR	ABC/LB-BR-20
4.5	25°	R	ABC/LB-BR-21

### Calcinabile



Non Rotante/NR      Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.5	NR	ABC/LB-HN-00
3.5	R	ABC/LB-RN-00
4.5	NR	ABC/LB-HR-00
4.5	R	ABC/LB-RR-00
5.7	NR	ABC/LB-HW-00
5.7	R	ABC/LB-RW-00

### Monconi Provvisori



Non Rotante/NR      Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.5	NR	ABC/LB-PN-06
3.5	R	ABC/LB-PN-07
4.5	NR	ABC/LB-PR-06
4.5	R	ABC/LB-PR-07



COMPATIBILE

Biohorizons® Tapered Internal®

Ø 3.0 - Ø 3.5 - Ø 4.5 - Ø 5.7

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

LB

## Monconi di Guarigione



Ø	Alt.	Codice
3.5	1.5	ABC/FA-DN-01
3.5	3.0	ABC/FA-DN-03
3.5	5.0	ABC/FA-DN-05
4.5	1.5	ABC/FA-DR-01
4.5	3.0	ABC/FA-DR-03
4.5	5.0	ABC/FA-DR-05

## Transfer Impronta

Cucchiaio  
Aperto

Ø	Tipo	Codice
3.5		ABC/LB-CN-00
4.5		ABC/LB-CR-00
5.7		ABC/LB-CW-00

## PSD Compatibile Locator



Ø	Alt.	Codice
3.5	1	ABC/FA-LN-01
3.5	2	ABC/FA-LN-02
3.5	3	ABC/FA-LN-03
3.5	4	ABC/FA-LN-04
3.5	5	ABC/FA-LN-05
4.5	1	ABC/FA-LR-01
4.5	3	ABC/FA-LR-03
4.5	5	ABC/FA-LR-05

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00

ULTERIORI ACCESSORI E RICAMBI VEDERE PAGINA 91



COMPATIBILE

Biohorizons® Tapered Internal®

Ø 3.0 - Ø 3.5 - Ø 4.5 - Ø 5.7

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

LB

## MultiUnit 0° - 17° - 30°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5	1.5	0°	ABC/FA-MN-01
3.5	2.5	0°	ABC/FA-MN-02
3.5	3.5	0°	ABC/FA-MN-03
3.5	4.5	0°	ABC/FA-MN-04
4.5	1.5	0°	ABC/FA-MR-01
4.5	2.5	0°	ABC/FA-MR-02
4.5	3.5	0°	ABC/FA-MR-03
4.5	4.5	0°	ABC/FA-MR-04

Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.5	2.5	17°	ABC/LB-MN-12
3.5	3.5	17°	ABC/LB-MN-13
3.5	3.5	30°	ABC/LB-MN-33
3.5	4.5	30°	ABC/LB-MN-34

## MultiUnit System



Codice	Analogo
ABC/AB-AR-00	



Codice	Incollaggio
ABC/AB-IR-01	



Codice	CoCr
ABC/AB-BR-01	



Ang.	Codice	CoCr 360
15°	ABC/AB-BR-11	TPA <sup>30°</sup>
25°	ABC/AB-BR-21	



Codice	Calcinabile
ABC/AB-RR-00	



Codice	Provisori Ti
ABC/AB-PR-00	



Tipo	Codice	Viti
Unigrip	ABC/AB-TR-00	
TiN	ABC/AB-TR-00/TiN	
TPA	ABC/AB-TR-50	



Tipo	Codice	Transfer Impronta
Aperto	ABC/AB-CR-00	
Chiuso	ABC/AB-CR-01	




Tipo	Codice	Guarigione
Plastica	ABC/AB-DR-00	
Titanio	ABC/AB-DR-01	

## Strumenti e Accessori



Punta	L.	Codice
Unigrip	18 mm.	ABC/PU-00-18
Unigrip	25 mm.	ABC/PU-00-25
Unigrip	32 mm.	ABC/PU-00-32
M-Unit 0°	20 mm.	ABC/LL-AB-00
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01
Esagonale 1.27	18 mm.	ABC/PH-27-18
Esagonale 1.27	25 mm.	ABC/PH-27-25
Esagonale 1.27	32 mm.	ABC/PH-27-32

← TORNA ALL'INDICE

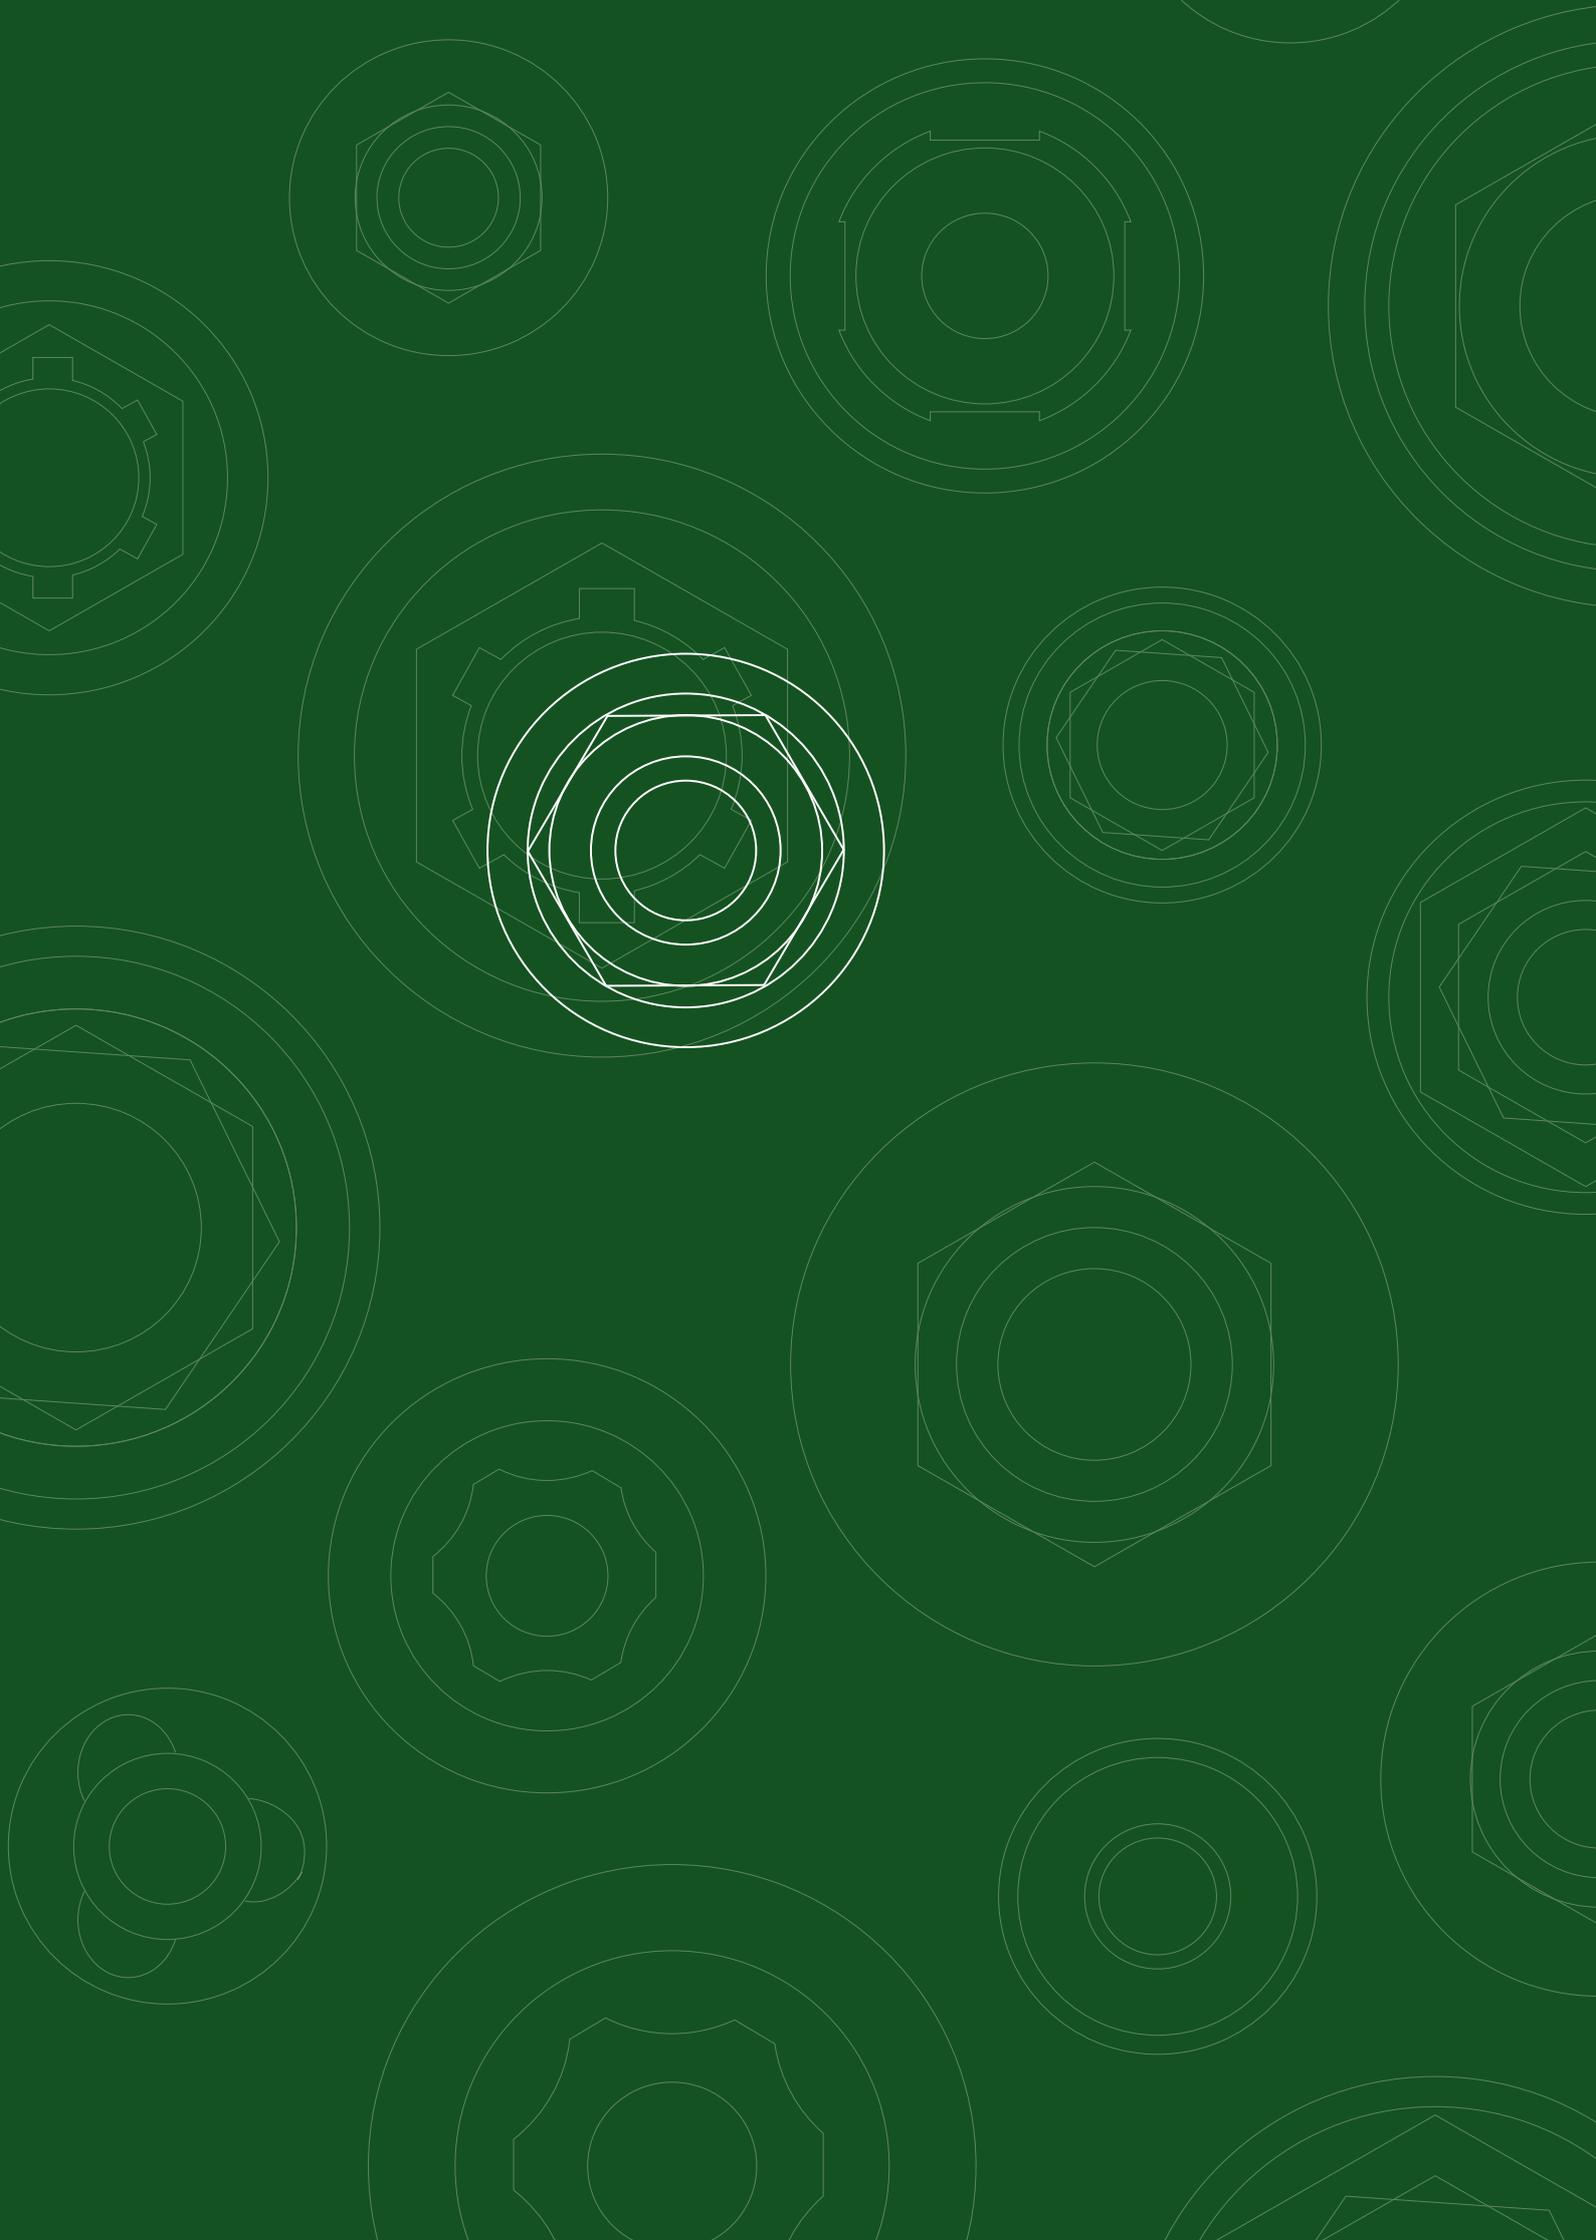

# SWEDEN & MARTINA®

COMPATIBILITA'

PREMIUM™  
KOHNO®



SERIE

MB



COMPATIBILE

Sweden&Martina® Premium Kohno®

Ø 3.3 - Ø 3.8  
Ø 4.25 - Ø 5.0

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

MB

## Sweden&Martina® Premium Kohno®

Compatibile con:  
SWEDEN&MARTINA® SHELTA®

## Analogo



Ø	Codice
3.3	ABC/MB-AT-00
3.8	ABC/MB-AN-00
4.25	ABC/MB-AR-00
5.0	ABC/MB-AW-00

## Viti TPA



Ø	Codice
3.3-3.8	ABC/MB-TN-50
4.25-5.0	ABC/MB-TR-50

## Viti Esagono 1.27

TiN



Ø	Codice
3.3-3.8	ABC/MB-TN-00
3.3-3.8	ABC/MB-TN-00/TiN
4.25-5.0	ABC/MB-TR-00
4.25-5.0	ABC/MB-TR-00/TiN

## Incollaggio



Non Rotante/NR			Rotante/R
Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.8	0.65	NR	ABC/MB-IN-00
3.8	0.65	R	ABC/MB-IN-01
4.25	0.65	NR	ABC/MB-IR-00
4.25	0.65	R	ABC/MB-IR-01

## AsseAngolato



Non Rotante/NR			Rotante/R
Ø	Alt.	NR/R	Codice
3.8	0.65	NR	ABC/MB-IN-30
3.8	0.65	R	ABC/MB-IN-31
4.25	0.65	NR	ABC/MB-IR-30
4.25	0.65	R	ABC/MB-IR-31



COMPATIBILE

Sweden&Martina® Premium Kohno®

Ø 3.3 - Ø 3.8  
Ø 4.25 - Ø 5.0

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

MB

### Cromo Cobalto CoCr



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.3	NR	ABC/MB-BT-00
3.3	R	ABC/MB-BT-01
3.8	NR	ABC/MB-BN-00
3.8	R	ABC/MB-BN-01
4.25	NR	ABC/MB-BR-00
4.25	R	ABC/MB-BR-01
5.0	NR	ABC/MB-BW-00
5.0	R	ABC/MB-BW-01

### AsseAngolato 360 CoCr TPA<sup>30°</sup>



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	Ang.	NR/R	Codice
3.8	15°	NR	ABC/MB-BN-10
3.8	15°	R	ABC/MB-BN-11
3.8	25°	NR	ABC/MB-BN-20
3.8	25°	R	ABC/MB-BN-21
4.25	15°	NR	ABC/MB-BR-10
4.25	15°	R	ABC/MB-BR-11
4.25	25°	NR	ABC/MB-BR-20
4.25	25°	R	ABC/MB-BR-21
5.0	15°	NR	ABC/MB-BW-10
5.0	15°	R	ABC/MB-BW-11
5.0	25°	NR	ABC/MB-BW-20
5.0	25°	R	ABC/MB-BW-21

### Calcinabile



Non Rotante/NR

Rotante/R

Ø	NR/R	Codice
3.3	NR	ABC/MB-HT-00
3.3	R	ABC/MB-RT-00
3.8	NR	ABC/MB-HN-00
3.8	R	ABC/MB-RN-00
4.25	NR	ABC/MB-HR-00
4.25	R	ABC/MB-RR-00
5.0	NR	ABC/MB-HW-00
5.0	R	ABC/MB-RW-00

### Monconi Provvisori



Ø NR/R Codice

3.8	NR	ABC/MB-PN-06
3.8	R	ABC/MB-PN-07
4.25	NR	ABC/MB-PR-06
4.25	R	ABC/MB-PR-07



COMPATIBILE

Sweden&amp;Martina® Premium Kohno®

Ø 3.3 - Ø 3.8

Ø 4.25 - Ø 5.0

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

MB

## Monconi 0° - 15° - 25°



Ø	Ang.	Alt.	Codice
3.3	0°	1	ABC/KO-33-MT1
3.3	0°	2	ABC/KO-33-MT2
3.8	0°	1	ABC/KO-38-MT1
3.8	0°	2	ABC/KO-38-MT2
3.8	0°	4	ABC/KO-38-MT4
4.25	0°	1	ABC/KO-42-MT1
4.25	0°	2	ABC/KO-42-MT2
4.25	0°	4	ABC/KO-42-MT4
5.0	0°	1	ABC/KO-50-MT1
5.0	0°	2	ABC/KO-50-MT2

Ø	Ang.	Alt.	Codice
3.3	15°	2	ABC/KO-33-AG-15
3.8	15°	2	ABC/KO-38-AG-15
3.8	25°	2	ABC/KO-38-AG-25
4.25	15°	2	ABC/KO-42-AG-15
4.25	25°	2	ABC/KO-42-AG-25
5.0	15°	2	ABC/KO-50-AG-15

## Monconi di Guarigione



Ø	Alt.	Codice
3.8	2	ABC/MB-DN-02
3.8	3	ABC/MB-DN-03
3.8	4	ABC/MB-DN-04
4.25	2	ABC/MB-DR-02
4.25	3	ABC/MB-DR-03
4.25	4	ABC/MB-DR-04

## Transfer Impronta

Cucchiaio  
Aperto

Ø	Tipo	Codice
3.3	Aperto	ABC/KO-33-CO
3.8	Aperto	ABC/MB-CN-00
4.25	Aperto	ABC/MB-CR-00
5.0	Aperto	ABC/KO-50-CO

## PSD Compatibile Locator



Ø	Alt.	Codice
3.8	1	ABC/MB-LN-01
3.8	3	ABC/MB-LN-03
3.8	5	ABC/MB-LN-05
4,25	1	ABC/MB-LR-01
4,25	3	ABC/MB-LR-03
4,25	5	ABC/MB-LR-05

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00

ULTERIORI ACCESSORI E RICAMBI VEDERE PAGINA 91



COMPATIBILE

Sweden&amp;Martina® Premium Kohno®

Ø 3.3 - Ø 3.8  
Ø 4.25 - Ø 5.0

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

MB

## P.A.D. 0° - 17° - 30°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.8	1	0°	ABC/KO-38-M1
3.8	2	0°	ABC/KO-38-M2
3.8	3	0°	ABC/KO-38-M3
4.25	1	0°	ABC/KO-42-M1
4.25	2	0°	ABC/KO-42-M2
4.25	3	0°	ABC/KO-42-M3

Ø	Alt.	Ang.	Codice
3.8	2	17	ABC/KO-38-M17
3.8	3	30	ABC/KO-38-M30
4.25	2	17	ABC/KO-42-M17
4.25	3	30	ABC/KO-42-M30

## P.A.D. System



Codice	Analogo
ABC/KO-01-MU	



Codice	Incollaggio
ABC/KO-05-MU	



Codice	Calcinabile
ABC/KO-02-MU	



Codice	Provisori Ti
ABC/KO-03-MU	

Unigrip




Tipo	Codice	Viti
Unigrip	ABC/DP-13-KV	

Aperto



Tipo	Codice	Transfer Impronta
Aperto	ABC/KO-06-MU	

## Strumenti e Accessori

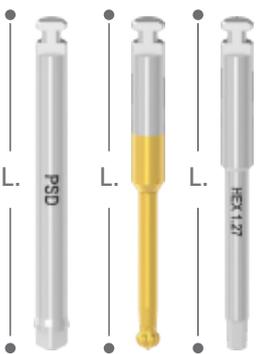

PSD TPA Esa

Punta	L.	Codice
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01
Esagonale 1.27	18 mm.	ABC/PH-27-18
Esagonale 1.27	25 mm.	ABC/PH-27-25
Esagonale 1.27	32 mm.	ABC/PH-27-32

← TORNA ALL'INDICE



**B.T.I.®**

COMPATIBILITA'

**INTERNA  
UNIVERSAL®**



SERIE

**GB**



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

GB

### Analogo



Ø	Codice
4.1	ABC/GB-AR-00
5.5	ABC/GB-AW-00

### Viti TPA



Ø	Codice
4.1 -5.5	ABC/GB-TR-50

### Viti Esagono 1.20

TiN



Ø	Codice
4.1 -5.5	ABC/GB-TR-00
4.1 -5.5	ABC/GB-TR-00/TiN

### Incollaggio



Ø	Alt.	NR/R	Codice
4.1	0.3	NR	ABC/GB-IR-00
4.1	0.3	R	ABC/GB-IR-01
4.1	1.5	NR	ABC/GB-IR-02
4.1	1.5	R	ABC/GB-IR-03
4.1	2.5	NR	ABC/GB-IR-04
4.1	2.5	R	ABC/GB-IR-05

### AsseInclinato



Ø	Alt.	NR/R	Codice
4.1	0.3	NR	ABC/GB-IR-30
4.1	0.3	R	ABC/GB-IR-31



COMPATIBILE

BTI® Interna® Universal®

Ø 4.1 - Ø 5.5 wide

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

### Cromo Cobalto CoCr



Ø	NR/R	Codice
4.1	NR	ABC/GB-BR-00
4.1	R	ABC/GB-BR-01

### AsseInclinato 360 CoCr



GB



Ø	Alt.	NR/R	Codice
4.1	15°	NR	ABC/GB-BR-10
4.1	15°	R	ABC/GB-BR-11
4.1	25°	NR	ABC/GB-BR-20
4.1	25°	R	ABC/GB-BR-21

### Calcinabile



Ø	NR/R	Codice
4.1	NR	ABC/GB-HR-00
4.1	R	ABC/GB-RR-00
5.5	R	ABC/GB-RW-00

### Monconi Provisorori



Ø	NR/R	Codice
4.1	NR	ABC/GB-PR-06
4.1	R	ABC/GB-PR-07



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

GB

## Monconi di Guarigione



Ø	Alt.	Codice
4.1	1.0	ABC/GB-DR-01
4.1	3.0	ABC/GB-DR-03
4.1	5.0	ABC/GB-DR-05

## Transfer Impronta



Ø	Tipo	Codice
4.1	Aperto	ABC/GB-CR-00

## PSD Compatibile Locator



Ø	Alt.	Codice
4.1	1	ABC/GB-LR-01
4.1	3	ABC/GB-LR-03
4.1	5	ABC/GB-LR-05

## Ritenzioni PSD



Qty.	Tipo	Codice
Kit 1x	Soft, Medium, Hard Laboratorio e Titanio	ABC/KA-CL-02
8x	Azzurri (Soft)	ABC/KA-CL-10
8x	Grigi (Medium)	ABC/KA-CL-11
8x	Trasparenti (Hard)	ABC/KA-CL-12
8x	Neri (Laboratorio)	ABC/KA-CL-13
1x	Titanio	ABC/KA-CL-00

ULTERIORI ACCESSORI E RICAMBI VEDERE PAGINA 91



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

### MultiUnit 0° - 17° - 30°



Ø	Alt.	Ang.	Codice
4.1	1	0°	ABC/GB-MR-01
4.1	2	0°	ABC/GB-MR-02
4.1	3	0°	ABC/GB-MR-03
4.1	4	0°	ABC/GB-MR-04
4.1	5	0°	ABC/GB-MR-05
<hr/>			
Ø	Alt.	Ang.	Codice
4.1	2	17°	ABC/GB-MR-12
4.1	3	17°	ABC/GB-MR-13
4.1	4	17°	ABC/GB-MR-14
4.1	4	30°	ABC/GB-MR-34
4.1	5	30°	ABC/GB-MR-35

### MultiUnit System



Codice	Analogo
ABC/AB-AR-00	



Codice	Incollaggio
ABC/AB-IR-01	



Codice	CoCr
ABC/AB-BR-01	



Ang.	Codice	CoCr 360
15°	ABC/AB-BR-11	<b>TPA</b> <sup>30°</sup>
25°	ABC/AB-BR-21	



Codice	Calcinabile
ABC/AB-RR-00	



Codice	Provisori Ti
ABC/AB-PR-00	



Tipo	Codice	Viti
Unigrip	ABC/AB-TR-00	
TiN	ABC/AB-TR-00/TiN	
TPA	ABC/AB-TR-50	



Tipo	Codice	Transfer Impronta
Aperto	ABC/AB-CR-00	
Chiuso	ABC/AB-CR-01	



Tipo	Codice	Guarigione
Plastica	ABC/AB-DR-00	
Titanio	ABC/AB-DR-01	

### Strumenti e Accessori




Unigrip M-Unit 0° PSD TPA Esa

Punta	L.	Codice
Unigrip	18 mm.	ABC/PU-00-18
Unigrip	25 mm.	ABC/PU-00-25
Unigrip	32 mm.	ABC/PU-00-32
M-Unit 0°	20 mm.	ABC/LL-AB-00
PSD	25 mm.	ABC/LL-PS-00
TPA	25 mm.	ABC/KA-CT-00
TPA	32 mm.	ABC/KA-CT-01
Esagonale 1.20	18 mm.	ABC/PH-20-18
Esagonale 1.20	25 mm.	ABC/PH-20-25
Esagonale 1.20	32 mm.	ABC/PH-20-32



Multi Unit MUA  
Sistema PSD  
Sistema IPD  
Asse Angolato  
Viti TPA  
Strumenti & Accessori

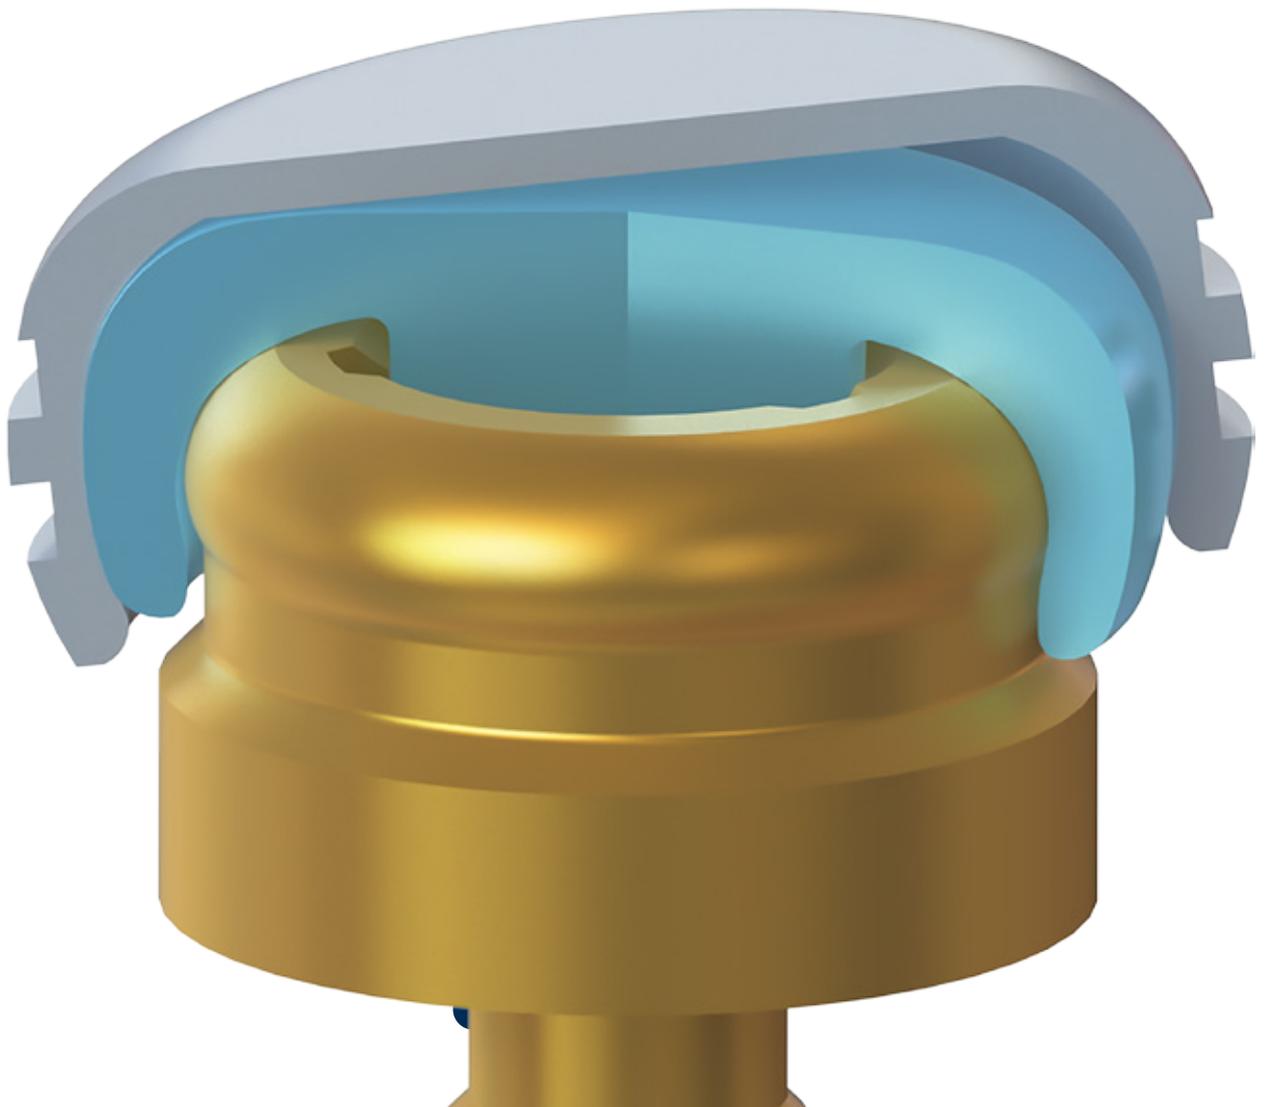



Le vite TPA per la protesi angolata permettono di correggere l'asse implantare riportandolo in una posizione protesica più corretta, al fine di migliorare la funzionalità e l'estetica.

Le vite sono utilizzate con un cacciavite "Torx ellittico" che consente di avvitare fino ad un angolo di 28°.

Il cacciavite, lungo 25 mm, ha un punto di rottura controllato il quale assicura che in caso di serraggio eccessivo non si vada a danneggiare la vite mentre sarà il cacciavite a fratturarsi in detto punto.

Tutte le vite TPA mantengono lunghezze ed ingaggi invariati rispetto alle controparti originali e possono essere utilizzate con qualsiasi libreria implantare CAD-CAM compatibile con il sistema a disposizione, senza richiedere alcuna libreria o programma aggiuntivo.

Il rivestimento TiN, applicato alla vite TPA, riduce il rischio di allentamento, evita la deformazione laterale del filetto, aumenta il pre-carico e la resistenza alle fratture e, in aggiunta, riduce l'adesione batterica.

La vite TPA può essere usata sia con le basi da incollaggio coordinate che con gli abutment angolati da sovrapposizione con base in Co-Cr.



La vite TPA può essere usata sia con:

**le basi da incollaggio coordinate** che con **gli abutment angolati da sovrapposizione con base in Co-Cr.**

## AsseAngolato 360 CoCr (Cromo Cobalto da sovrapposizione)

## AsseAngolato IPD



AsseAngolato 360 CoCr 15°

AsseAngolato 360 CoCr 25°



AsseAngolato IPD  
Non Rotante

Scan Abutment  
Non Rotante

AsseAngolato IPD  
Rotante

Scan Abutment  
Rotante

# Multi Unit MUA

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.



# Multi Unit MUA

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Angolo	Altezza (mm)	Codice
<b>Nobel Biocare®</b> Branemark System® <b>Biomet®</b> 3I® Externa™ 3I® <b>Bti®</b> Hex. Ext. <b>Sweden &amp; Martina®</b> Outlink® <b>Microdent®</b> Microdent® <b>Universal™</b> <b>Klockner®</b> KL™	Ø4.1	Dritto	1	ABC/AB-MR-01
			2	ABC/AB-MR-02
			3	ABC/AB-MR-03
			4	ABC/AB-MR-04
			5	ABC/AB-MR-05
		17°	2	ABC/AB-MR-12
			3	ABC/AB-MR-13
			4	ABC/AB-MR-14
			3	ABC/AB-MR-33
			4	ABC/AB-MR-34
30°	3	ABC/AB-MR-33		
	4	ABC/AB-MR-34		
<b>Phibo®</b> TSH®	S3-S4		5	ABC/AB-MR-35
<b>Nobel Biocare®</b> Nobel Replace® Select	Ø3.5	Dritto	1	ABC/AC-MN-01
			2	ABC/AC-MN-02
			1	ABC/AC-MR-01
			2	ABC/AC-MR-02
			3	ABC/AC-MR-03
	Ø4.3	Dritto	4	ABC/AC-MR-04
			5	ABC/AC-MR-05
			2	ABC/AC-MR-12
			3	ABC/AC-MR-13
			4	ABC/AC-MR-14
	17°	Dritto	4	ABC/AC-MR-14
			4	ABC/AC-MR-34
			5	ABC/AC-MR-35
			1.5	ABC/AD-MN-01
			2.5	ABC/AD-MN-02
Ø3.5	Dritto	3.5	ABC/AD-MN-03	
		4.5	ABC/AD-MN-04	
		2.5	ABC/AD-MN-12	
		3.5	ABC/AD-MN-13	
		3.5	ABC/AD-MN-33	
30°	Dritto	4.5	ABC/AD-MN-34	
		1.5	ABC/AD-MR-01	
		2.5	ABC/AD-MR-02	
		3.5	ABC/AD-MR-03	
		4.5	ABC/AD-MR-04	
Ø4.3	Dritto	2.5	ABC/AD-MR-12	
		3.5	ABC/AD-MR-13	
		3.5	ABC/AD-MR-33	
		4.5	ABC/AD-MR-34	
		17°	3.5	ABC/AD-MR-33
30°	Dritto	4.5	ABC/AD-MR-34	
		4.5	ABC/AD-MR-34	

# Multi Unit MUA

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Angolo	Altezza (mm)	Codice		
<b>Biomet® 3I® Certain®</b>	Ø4.1	Dritto	1	ABC/BB-MR-01		
			2	ABC/BB-MR-02		
			3	ABC/BB-MR-03		
			4	ABC/BB-MR-04		
			5	ABC/BB-MR-05		
	Ø4.1	17°	2	ABC/BB-MR-12		
			3	ABC/BB-MR-13		
			4	ABC/BB-MR-14		
			30°	4	ABC/BB-MR-34	
				5	ABC/BB-MR-35	
<b>Straumann® Tissue Level</b>	Ø4.8	Dritto	0.9	ABC/DA-MR-01		
			Ø3.3	Dritto	1.5	ABC/DB-MN-01
					2.5	ABC/DB-MN-02
					3.5	ABC/DB-MN-03
					4.5	ABC/DB-MN-04
	17°	2.5			ABC/DB-MN-12	
		3.5	ABC/DB-MN-13			
	Ø3.3	30°	3.5	ABC/DB-MN-33		
			4.5	ABC/DB-MN-34		
			<b>Straumann® Bone Level</b>	Ø4.1	Dritto	1.5
2.5						ABC/DB-MR-02
3.5						ABC/DB-MR-03
4.5	ABC/DB-MR-04					
17°	2.5	ABC/DB-MR-12				
	3.5	ABC/DB-MR-13				
Ø4.1	30°	3.5	ABC/DB-MR-33			
		4.5	ABC/DB-MR-34			
		<b>Astra® OsseoSpeed®</b>	Ø3.5 / Ø4.0	Dritto	1.5	ABC/EA-MR-01
					2.5	ABC/EA-MR-02
					3.5	ABC/EA-MR-03
4.5	ABC/EA-MR-04					
17°	2.5				ABC/EA-MR-12	
	3.5		ABC/EA-MR-13			
Ø3.5 / Ø4.0	30°		3.5	ABC/EA-MR-33		
			4.5	ABC/EA-MR-34		
			Ø4.5 / Ø5.0	Dritto	1.5	ABC/EA-MW-01
2.5	ABC/EA-MW-02					
3.5	ABC/EA-MW-03					
4.5	ABC/EA-MW-04					

# Multi Unit MUA

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Angolo	Altezza (mm)	Codice
<b>Astra®</b> OsseoSpeed®	Ø4.5 / Ø5.0	17°	2.5	ABC/EA-MW-12
			3.5	ABC/EA-MW-13
		30°	3.5	ABC/EA-MW-33
			4.5	ABC/EA-MW-34
<b>Zimmer®</b> Screw Vent®	Ø3.5	Dritto	1.5	ABC/FA-MN-01
			2.5	ABC/FA-MN-02
			3.5	ABC/FA-MN-03
		17°	4.5	ABC/FA-MN-04
			2.5	ABC/FA-MN-12
			3.5	ABC/FA-MN-13
	Ø4.5	30°	3.5	ABC/FA-MN-33
			4.5	ABC/FA-MN-34
			1.5	ABC/FA-MR-01
		Dritto	2.5	ABC/FA-MR-02
			3.5	ABC/FA-MR-03
			4.5	ABC/FA-MR-04
<b>Bti®</b> Interna Universal®	Ø4.1	17°	3	ABC/FA-MR-13
			4	ABC/FA-MR-14
			3.5	ABC/FA-MR-33
			4.5	ABC/FA-MR-34
			1	ABC/GB-MR-01
		30°	2	ABC/GB-MR-02
			3	ABC/GB-MR-03
			4	ABC/GB-MR-04
			5	ABC/GB-MR-05
			2	ABC/GB-MR-12
<b>BioHorizons®</b> Tapered Internal	Ø3.5	17°	3	ABC/GB-MR-13
			4	ABC/GB-MR-14
			3	ABC/GB-MR-33
		30°	4	ABC/GB-MR-34
			5	ABC/GB-MR-35
			2.5	ABC/LB-MN-12
30°	3.5	ABC/LB-MN-13		
	3.5	ABC/LB-MN-33		
	4.5	ABC/LB-MN-34		

# Multi Unit MUA

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Analogo



Ø	Codice
4.8	ABC/AB-AR-00

## Viti Unigrip



Ø	Codice
4.8	ABC/AB-TR-00
4.8	ABC/AB-TR-00/TiN

## Incollaggio

Rotante



Ø	Codice
4.8	ABC/AB-IR-01

## AsseAngolato

Rotante



Ø	Codice
4.8	ABC/AB-IR-01/TR-50

## Cromo Cobalto CoCr

Rotante



Ø	Codice
4.8	ABC/AB-BR-01

## AsseDinamico 360 CoCr

Rotante



Ø	Ang.	Codice
4.8	15°	ABC/AB-BR-11
4.8	25°	ABC/AB-BR-21

# Multi Unit MUA

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Calcinabile

Rotante



Ø	Codice
4.8	ABC/AB-RR-00

## Monconi Provvisori

Rotante



Ø	Codice
4.8	ABC/AB-PR-00

## Transfer Impronta



Ø	Codice
4.8	ABC/AB-CR-00 Aperto
4.8	ABC/AB-CR-01 Chiuso

## Monconi di Guarigione

Plastica

Titanio



Ø	Mat.	Codice
4.8	Pla.	ABC/AB-DR-00
4.8	Tit.	ABC/AB-DR-01

## Driver C.A. Mua Dritti



L.	Codice
20 mm	ABC/LL-AB-00

## Driver C.A. Unigrip\*




L.	Codice
18 mm	ABC/PU-00-18
25 mm	ABC/PU-00-25
32 mm	ABC/PU-00-32

\*PER VITE SECONDARIA ABC/AB-TR-00

# Sistema PSD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

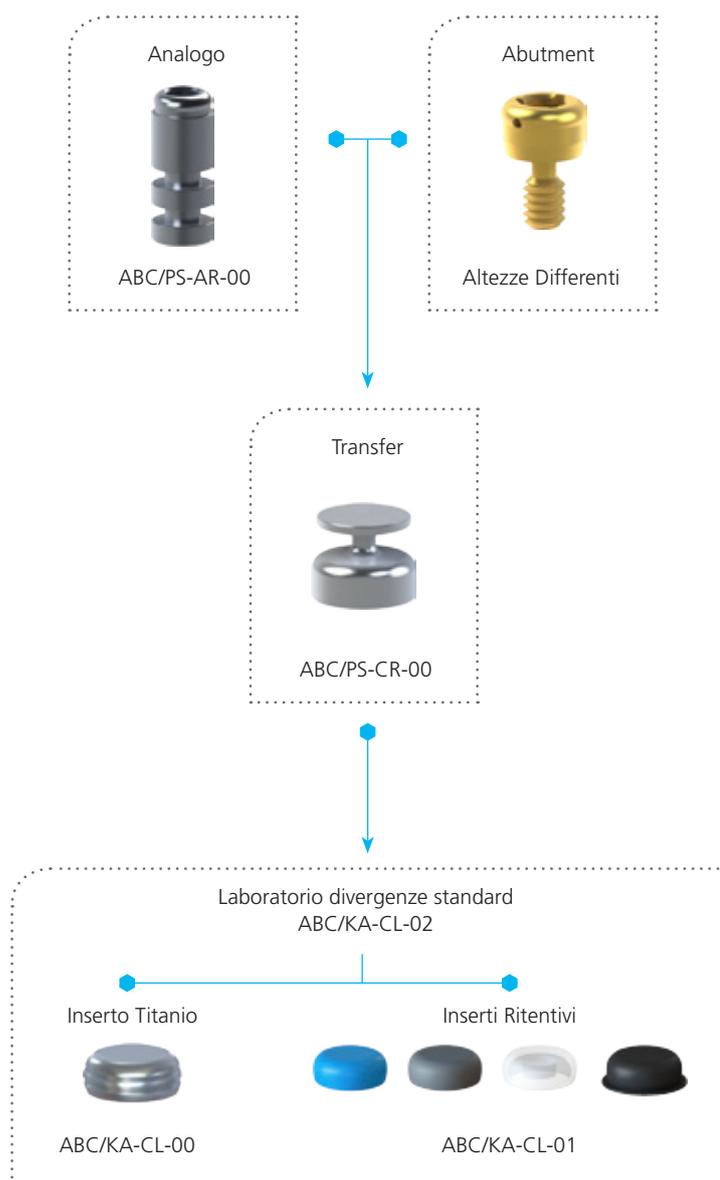

# Sistema PSD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## SISTEMA PSD

### • ANALOGO



#### CODICE

ABC/PS-AR-00

### • PER BARRA



#### CODICE

ABC/PS-LR-00

#### ALTEZZA (mm)

1

#### PASSO

2 mm

ABC/PS-LR-00 Confezione da 2 pezzi.

### • TRANSFER DA IMPRONTA



#### CODICE

ABC/PS-CR-00

### •KIT E INSERTI RITENTIVI




#### CODICE

#### DESCRIZIONE

#### RITENZIONE

	KIT per divergenze fino a 20°	
ABC-PD-8540-2	KIT: 1 Inserto in titanio + 4 Inserti ritentivi (1 Blu 1 Grigio 1 Trasparente 1 Nero)	
	KIT per divergenze fino a 40°	
ABC/KA-CL-02	KIT: 2 Inserto in titanio + 8 Inserti ritentivi (2 Verdi 2 Arancioni 2 Rosse 2 Nero)	
ABC/KA-CL-01	KIT: 4 Inserti ritentivi (1 Blu 1 Grigio 1 Trasparente 1 Nero)	
ABC/KA-CL-00	Confezione 1 Inserto in Titanio	
ABC/KA-CL-10	Confezione 8 Inserti ritentivi Blu	Leggero
ABC/KA-CL-11	Confezione 8 Inserti ritentivi Grigi	Medio
ABC/KA-CL-12	Confezione 8 Inserti ritentivi Bianchi	Forte
ABC/KA-CL-13	Confezione 8 Inserti ritentivi Neri	(per laboratorio)

### • CACCIAVITE PSD



#### CODICE

ABC/LL-PS-00

### • ACCESSORIO PSD



#### CODICE

IPD/LL-PS-01

# Sistema PSD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Altezza (mm)	Codice
<b>Nobel Biocare®</b> Branemark System® <b>Biomet®</b> 3I® Externa™ 3I® <b>Bti®</b> Hex. Ext. <b>Sweden &amp; Martina®</b> Outlink® <b>Microdent®</b> Microdent® Universal™ <b>Klockner®</b> KL™	Ø4.1	1	ABC/AA-LR-01
		2	ABC/AA-LR-02
		3	ABC/AA-LR-03
		4	ABC/AA-LR-04
		5	ABC/AA-LR-05
<b>Phibo®</b> TSH®	S3-S4		
<b>Nobel Biocare®</b> Branemark System®	Ø3.5	1	ABC/AA-LN-01
		3	ABC/AA-LN-03
		5	ABC/AA-LN-05
		1	ABC/AC-LN-01
		3	ABC/AC-LN-03
<b>Nobel Biocare®</b> Nobel Replace® Select	Ø3.5	5	ABC/AC-LN-05
		1	ABC/AC-LR-01
		3	ABC/AC-LR-03
		5	ABC/AC-LR-05
		1	ABC/AD-LN-01
<b>Nobel Biocare®</b> Nobel Active®	Ø3.5	2	ABC/AD-LN-02
		3	ABC/AD-LN-03
		4	ABC/AD-LN-04
		5	ABC/AD-LN-05
		1	ABC/AD-LR-01
	Ø4.3	2	ABC/AD-LR-02
		3	ABC/AD-LR-03
		4	ABC/AD-LR-04
		5	ABC/AD-LR-05
		1	ABC/BA-LN-01
<b>Biomet®</b> 3I® Externa™ 3I®	Ø3.4	3	ABC/BA-LN-03
		5	ABC/BA-LN-05
		1	ABC/BB-LN-01
		3	ABC/BB-LN-03
		5	ABC/BB-LN-05
<b>Biomet®</b> 3I® Certain®	Ø4.1	1	ABC/BB-LR-01
		3	ABC/BB-LR-03
		5	ABC/BB-LR-05
		1	ABC/CB-LR-01
		3	ABC/CB-LR-03
<b>Klockner®</b> Essential Cone®	Ø4.5	1	ABC/DA-LR-01
		2	ABC/DA-LR-02
		3	ABC/DA-LR-03
<b>Straumann®</b> Tissue Level	Ø4.8	2	ABC/DA-LR-02
		3	ABC/DA-LR-03
		2	ABC/ID-LR-02
<b>Osteoplus®</b> Iridium® <b>Osteoplus®</b> Argentum®	Ø4.2	4	ABC/ID-LR-04

# Sistema PSD


I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Altezza (mm)	Codice
<b>Straumann®</b> Bone Level	Ø3.3	1	ABC/DB-LN-01
		2	ABC/DB-LN-02
		3	ABC/DB-LN-03
		4	ABC/DB-LN-04
		5	ABC/DB-LN-05
	Ø4.1	1	ABC/DB-LR-01
		2	ABC/DB-LR-02
		3	ABC/DB-LR-03
		4	ABC/DB-LR-04
		5	ABC/DB-LR-05
<b>Astra®</b> OsseoSpeed®	Ø3.5 / Ø4.0	1	ABC/EA-LR-01
		3	ABC/EA-LR-03
		5	ABC/EA-LR-05
	Ø4.5 / Ø5.0	1	ABC/EA-LW-01
		3	ABC/EA-LW-03
		5	ABC/EA-LW-05
<b>Astra®</b> Evolution®	Ø4.2	1	ABC/EB-LR-01
		3	ABC/EB-LR-03
		5	ABC/EB-LR-05
<b>Zimmer®</b> Screw Vent®	Ø3.5	1	ABC/FA-LN-01
		2	ABC/FA-LN-02
		3	ABC/FA-LN-03
		4	ABC/FA-LN-04
		5	ABC/FA-LN-05
	Ø4.5	1	ABC/FA-LR-01
		3	ABC/FA-LR-03
		5	ABC/FA-LR-05
<b>Bti®</b> Interna Universal®	Ø4.1	1	ABC/GB-LR-01
		3	ABC/GB-LR-03
		5	ABC/GB-LR-05
<b>Camlog®</b> Camlog®	Ø3.8	1	ABC/JA-LR-01
		3	ABC/JA-LR-03
		5	ABC/JA-LR-05
	Ø3.8	1	ABC/MB-LN-01
		3	ABC/MB-LN-03
<b>Sweden &amp; Martina®</b> Premium™Kohno®	Ø4.25	5	ABC/MB-LN-05
		1	ABC/MB-LR-01
	Ø4.25	3	ABC/MB-LR-03
		5	ABC/MB-LR-05
<b>Phibo®</b> TSH®	S2	1	ABC/NA-LN-01
		3	ABC/NA-LN-03
		5	ABC/NA-LN-05

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Schema di lavoro

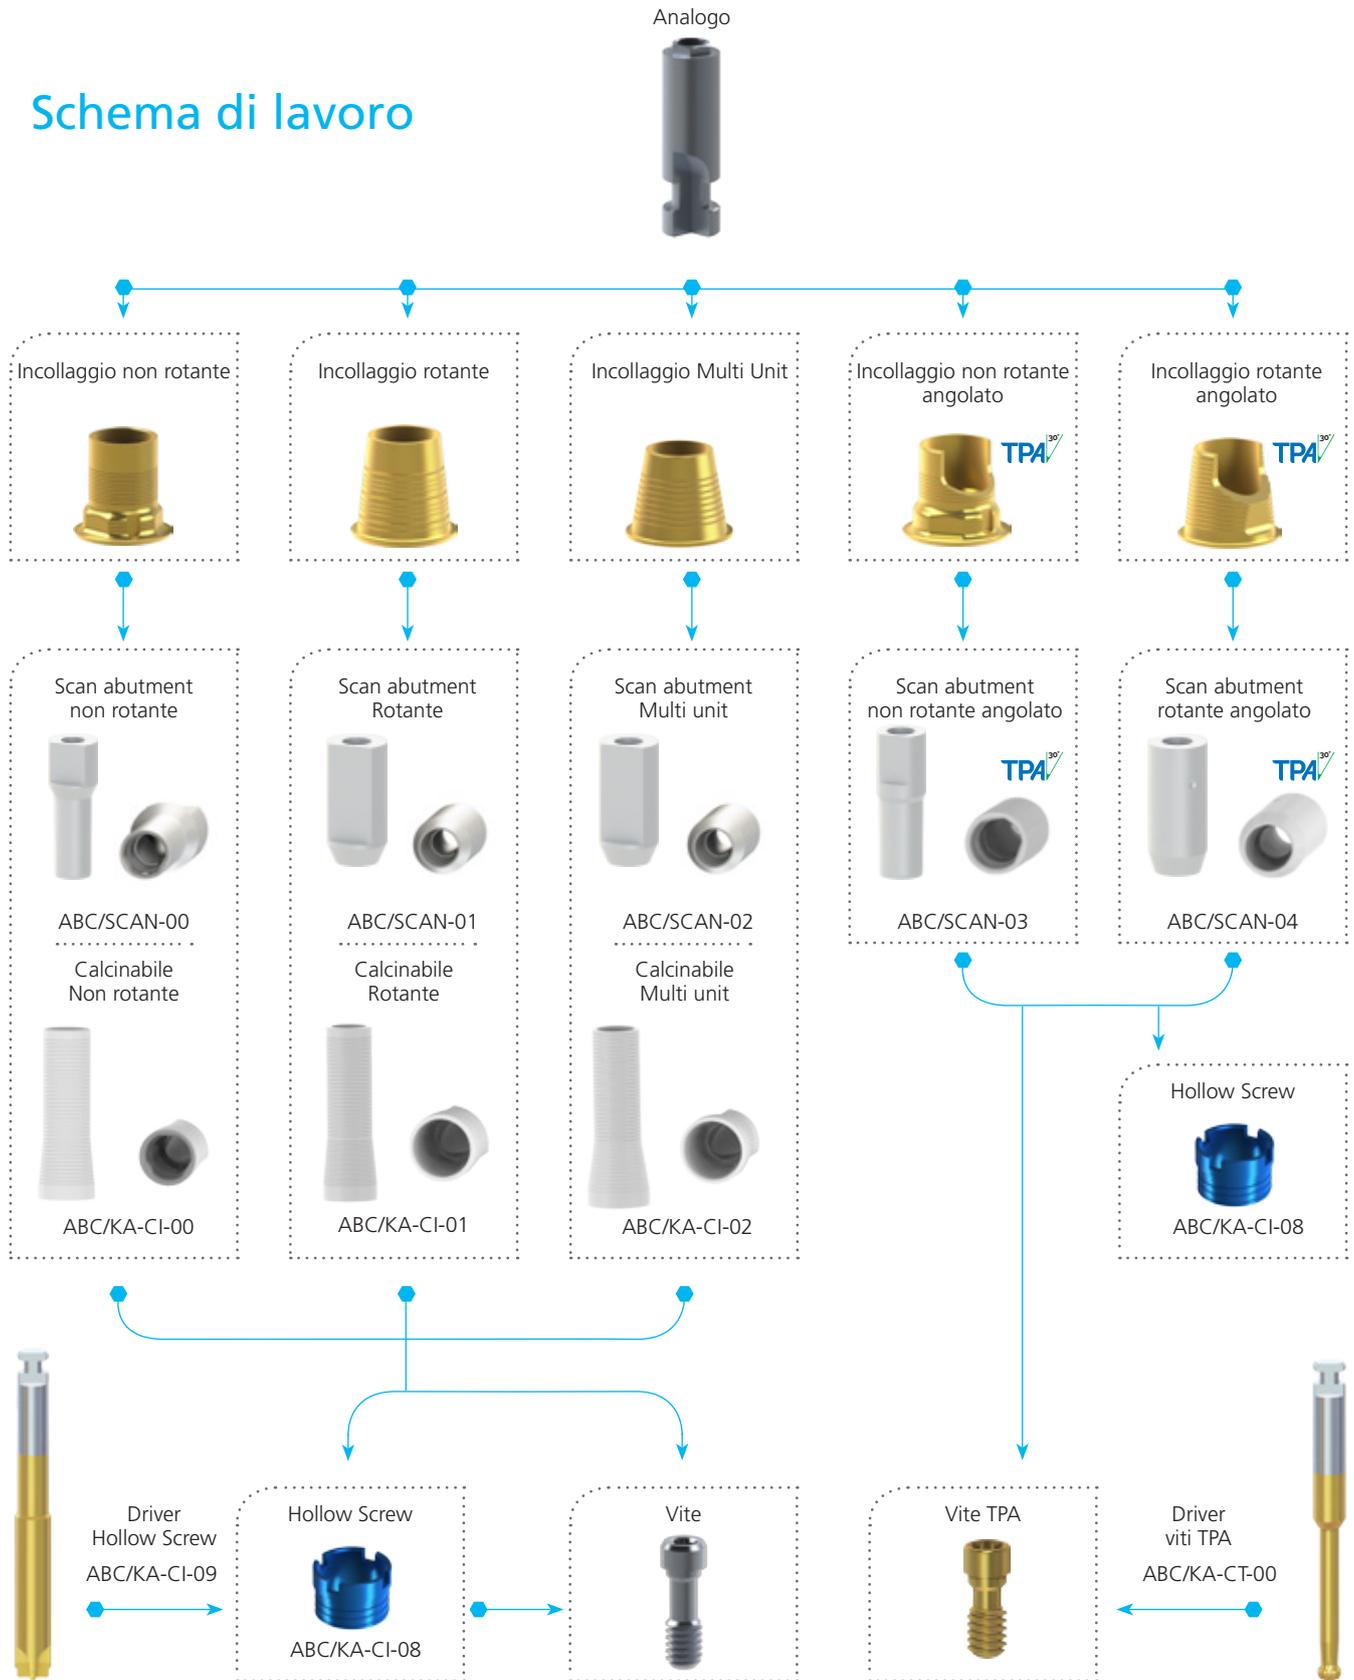

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Scan Body



Scan abutment non rotante

ABC/SCAN-00



Scan abutment rotante

ABC/SCAN-01



Scan abutment Multi Unit

ABC/SCAN-02



Scan abutment non rotante angolato

TPA<sup>30°</sup>

ABC/SCAN-03



Scan abutment rotante angolato

TPA<sup>30°</sup>

ABC/SCAN-04

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Calcinabili



Calcinabile Non rotante

ABC/KA-CI-00



Calcinabile rotante

ABC/KA-CI-01



Calcinabile Multi Unit

ABC/KA-CI-02

## Hollow Screw



ABC/KA-CI-08

## Driver Hollow Screw




ABC/KA-CI-09


# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## Librerie CAD-CAM disponibili per i principali sistemi

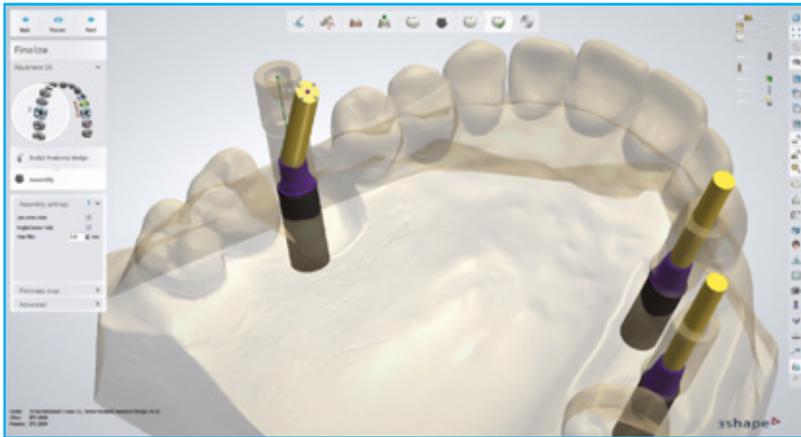

3shape®

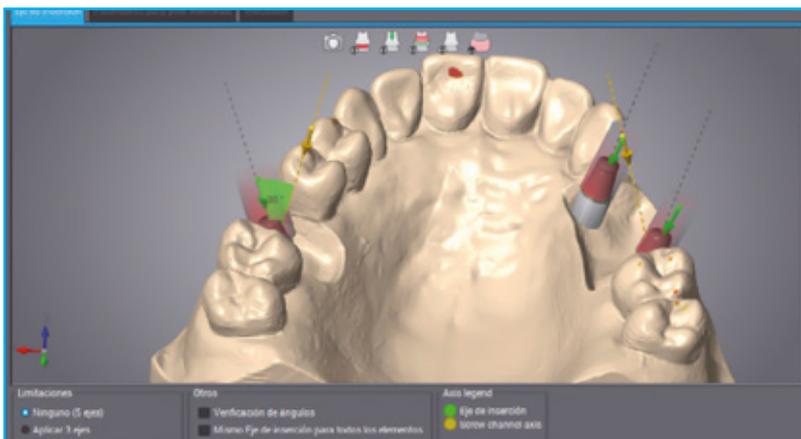

dental wings®



exocad®

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Tipo Connessione	Versione	Altezza (mm)	Codice			
<b>Nobel Biocare®</b> Branemark System® <b>Biomet®</b> 3I® Externa™ 3I® <b>Bti®</b> Hex. Ext. <b>Sweden &amp; Martina®</b> Outlink® <b>Microdent®</b> Microdent® Universal™ <b>Klockner®</b> KL™	Ø4.1	Non Rotante	Dritto	0.2	ABC/AA-IR-00			
			Dritto	1.5	ABC/AA-IR-02			
			Dritto	2.5	ABC/AA-IR-04			
			Angolato	0.2	ABC/AA-IR-30			
			Angolato	0.2	ABC/AA-IR-01			
		Rotante	Dritto	1.5	ABC/AA-IR-03			
			Dritto	2.5	ABC/AA-IR-05			
			Angolato	0.2	ABC/AA-IR-31			
			<b>Nobel Biocare®</b> Branemark System® <b>Klockner®</b> KL™	Ø3.5	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/AA-IN-00
						Dritto	2.5	ABC/AA-IN-02
Angolato	1.0	ABC/AA-IN-30						
Dritto	1.0	ABC/AA-IN-01						
Dritto	2.5	ABC/AA-IN-03						
Rotante	Angolato	1.0			ABC/AA-IN-31			
	Dritto	0.2			ABC/AB-IR-01			
	<b>Nobel Biocare®</b> Nobel Replace® Select	Ø4.3			Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/AC-IN-00
						Dritto	2.5	ABC/AC-IN-02
						Angolato	3.5	ABC/AC-IN-30
Dritto			1.0	ABC/AC-IN-01				
Dritto			2.5	ABC/AC-IN-03				
Rotante			Angolato	3.5	ABC/AC-IN-31			
			Dritto	0.2	ABC/AC-IR-00			
			Dritto	1.5	ABC/AC-IR-02			
			Dritto	2.5	ABC/AC-IR-04			
			Angolato	0.2	ABC/AC-IR-30			
<b>Nobel Biocare®</b> Nobel Replace® Select	Ø5.0	Non Rotante	Dritto	0.2	ABC/AC-IR-01			
			Dritto	1.5	ABC/AC-IR-03			
			Dritto	2.5	ABC/AC-IR-05			
			Angolato	0.2	ABC/AC-IR-31			
			Dritto	0.2	ABC/AC-IW-00			
		Rotante	Dritto	1.5	ABC/AC-IW-02			
			Dritto	2.5	ABC/AC-IW-04			
			Angolato	0.2	ABC/AC-IW-30			
			Dritto	0.2	ABC/AC-IW-01			
			Dritto	1.5	ABC/AC-IW-03			
Angolato	Dritto	2.5	ABC/AC-IW-05					
	Angolato	0.2	ABC/AC-IW-31					

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Tipo Connessione	Versione	Altezza (mm)	Codice
<b>Nobel Biocare® Nobel Active®</b>	Ø3.5	Non Rotante	Dritto	0.9	ABC/AD-IN-00
				2.5	ABC/AD-IN-02
			Angolato	0.9	ABC/AD-IN-30
		Rotante	Dritto	0.9	ABC/AD-IN-01
				2.5	ABC/AD-IN-03
			Angolato	0.9	ABC/AD-IN-31
	Ø4.3	Non Rotante	Dritto	0.9	ABC/AD-IR-00
				2.5	ABC/AD-IR-02
			Angolato	1.0	ABC/AD-IR-30
		Rotante	Dritto	0.9	ABC/AD-IR-01
				2.5	ABC/AD-IR-03
			Angolato	1.0	ABC/AD-IR-31
<b>Biomet® 3I® Externa™ 3I®</b>	Ø3.4	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/BA-IN-00
				2.5	ABC/BA-IN-02
			Angolato	1.0	ABC/BA-IN-30
		Rotante	Dritto	1.0	ABC/BA-IN-01
				2.5	ABC/BA-IN-03
			Angolato	1.0	ABC/BA-IN-31
	Ø5.0	Non Rotante		0.2	ABC/BA-IW-00
			Dritto	1.5	ABC/BA-IW-02
				2.5	ABC/BA-IW-04
		Rotante	Angolato	0.2	ABC/BA-IW-30
			Dritto	0.2	ABC/BA-IW-01
				1.5	ABC/BA-IW-03
<b>Biomet® 3I® Certain®</b>	Ø3.4	Non Rotante		2.5	ABC/BA-IW-05
			Angolato	0.2	ABC/BA-IW-31
			Dritto	0.9	ABC/BB-IN-00
		Rotante		2.5	ABC/BB-IN-02
			Angolato	0.9	ABC/BB-IN-30
			Dritto	0.9	ABC/BB-IN-01
	Ø4.1	Non Rotante		2.5	ABC/BB-IN-03
			Angolato	0.9	ABC/BB-IN-31
			Dritto	0.3	ABC/BB-IR-00
		Rotante		1.5	ABC/BB-IR-02
				2.5	ABC/BB-IR-04
			Angolato	0.3	ABC/BB-IR-30
	Rotante	Dritto	0.3	ABC/BB-IR-01	
			1.5	ABC/BB-IR-03	
			2.5	ABC/BB-IR-05	
		Angolato	0.3	ABC/BB-IR-31	

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Tipo Connessione	Versione	Altezza (mm)	Codice
<b>Biomet® 3I® Certain®</b>	Ø5.0	Non Rotante	Dritto	0.3	ABC/BB-IW-00
			Dritto	1.5	ABC/BB-IW-02
			Dritto	2.5	ABC/BB-IW-04
		Rotante	Angolato	0.9	ABC/BB-IW-30
			Dritto	0.3	ABC/BB-IW-01
			Dritto	1.5	ABC/BB-IW-03
<b>Klockner® Essential Cone®</b>	Ø4.5	Non Rotante	Angolato	0.9	ABC/BB-IW-31
			Dritto	0.3	ABC/CB-IR-00
		Rotante	Angolato	0.35	ABC/CB-IR-30
			Dritto	0.3	ABC/CB-IR-01
		Non Rotante	Angolato	0.35	ABC/CB-IR-31
			Dritto	0.85	ABC/DA-IR-00
<b>Straumann® Tissue Level</b>	Ø4.8	Non Rotante	Angolato	0.85	ABC/DA-IR-30
			Dritto	0.85	ABC/DA-IR-01
		Rotante	Angolato	0.85	ABC/DA-IR-11
			Dritto	0.85	ABC/DA-IR-11
		Non Rotante	Angolato	1.0	ABC/DA-IR-31
			Dritto	1.0	ABC/DB-IN-00
<b>Straumann® Bone Level</b>	Ø3.3	Non Rotante	Angolato	2.5	ABC/DB-IN-02
			Dritto	1.0	ABC/DB-IN-30
		Rotante	Angolato	1.0	ABC/DB-IN-01
			Dritto	2.5	ABC/DB-IN-03
		Non Rotante	Angolato	1.0	ABC/DB-IN-31
			Dritto	1.0	ABC/DB-IR-00
<b>Astra® OsseoSpeed®</b>	Ø4.1	Non Rotante	Angolato	2.5	ABC/DB-IR-02
			Dritto	1.0	ABC/DB-IR-30
		Rotante	Angolato	1.0	ABC/DB-IR-01
			Dritto	2.5	ABC/DB-IR-03
		Non Rotante	Angolato	1.0	ABC/DB-IR-31
			Dritto	1.5	ABC/EA-IN-00
<b>Astra® OsseoSpeed®</b>	Ø3.0	Non Rotante	Angolato	2.5	ABC/EA-IN-02
			Dritto	1.5	ABC/EA-IN-30
		Rotante	Angolato	1.5	ABC/EA-IN-01
			Dritto	2.5	ABC/EA-IN-03
		Non Rotante	Angolato	1.5	ABC/EA-IN-31
			Dritto	1.1	ABC/EA-IR-00
<b>Astra® OsseoSpeed®</b>	Ø3.5/4.0	Non Rotante	Angolato	2.5	ABC/EA-IR-02
			Dritto	1.1	ABC/EA-IR-30
		Rotante	Angolato	1.1	ABC/EA-IR-01
			Dritto	2.5	ABC/EA-IR-03
		Non Rotante	Angolato	1.1	ABC/EA-IR-31
			Dritto	1.1	ABC/EA-IR-31

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Tipo Connessione	Versione	Altezza (mm)	Codice
<b>Astra® OsseoSpeed®</b>	Ø4.5/5.0	Non Rotante	Dritto	0.9	ABC/EA-IW-00
			Angolato	2.5	ABC/EA-IW-02
			Angolato	0.9	ABC/EA-IW-30
		Rotante	Dritto	0.9	ABC/EA-IW-01
			Angolato	2.5	ABC/EA-IW-03
			Angolato	0.9	ABC/EA-IW-31
<b>Astra® Evolution®</b>	Ø3.6	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/EB-IN-00
			Angolato	1.0	ABC/EB-IN-30
		Rotante	Dritto	1.0	ABC/EB-IN-01
	Ø4.2	Non Rotante	Angolato	1.0	ABC/EB-IN-31
			Dritto	1.0	ABC/EB-IR-00
		Rotante	Angolato	1.0	ABC/EB-IR-01
<b>Zimmer® Screw Vent®</b>	Ø3.5	Non Rotante	Angolato	1.0	ABC/EB-IR-31
			Dritto	0.9	ABC/FA-IN-00
			Angolato	2.5	ABC/FA-IN-02
		Rotante	Angolato	0.9	ABC/FA-IN-30
			Dritto	0.9	ABC/FA-IN-01
			Angolato	2.5	ABC/FA-IN-03
<b>Bti® Tiny Bti®</b>	Ø3.5	Non Rotante	Angolato	0.9	ABC/FA-IN-31
			Dritto	0.1	ABC/FA-IR-00
			Angolato	1.5	ABC/FA-IR-02
		Rotante	Angolato	2.5	ABC/FA-IR-04
			Dritto	0.1	ABC/FA-IR-30
			Angolato	0.1	ABC/FA-IR-01
<b>Bti® Externa Ancha</b>	Ø5.5	Non Rotante	Dritto	1.5	ABC/FA-IR-03
			Angolato	2.5	ABC/FA-IR-05
			Angolato	0.1	ABC/FA-IR-31
		Rotante	Dritto	1.0	ABC/GA-IN-00
			Angolato	2.5	ABC/GA-IN-02
			Angolato	1.0	ABC/GA-IN-30
<b>Bti® Externa Ancha</b>	Ø5.5	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/GA-IN-01
			Angolato	2.5	ABC/GA-IN-03
			Angolato	1.0	ABC/GA-IN-31
		Rotante	Dritto	1.6	ABC/GA-IW-00
			Angolato	1.6	ABC/GA-IW-30
			Angolato	1.6	ABC/GA-IW-01
			Angolato	1.6	ABC/GA-IW-31

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

Compatibilità	Piattaforma	Tipo Connessione	Versione	Altezza (mm)	Codice
<b>Bti®</b> Interna Universal®	Ø5.5	Non Rotante	Dritto	0.3	ABC/GB-IR-00
			Dritto	1.5	ABC/GB-IR-02
			Dritto	2.5	ABC/GB-IR-04
		Rotante	Angolato	0.3	ABC/GB-IR-30
			Dritto	0.3	ABC/GB-IR-01
			Dritto	1.5	ABC/GB-IR-03
			Dritto	2.5	ABC/GB-IR-05
			Angolato	0.3	ABC/GB-IR-31
			Angolato	1.0	ABC/GB-IR-30
<b>Dentsply®</b> Xive® Friadent®	Ø3.4	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/IA-IN-00
			Angolato	1.0	ABC/IA-IN-30
		Rotante	Dritto	1.0	ABC/IA-IN-01
	Angolato		1.0	ABC/IA-IN-31	
	Ø3.8	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/IA-IR-00
			Angolato	1.0	ABC/IA-IR-30
		Rotante	Dritto	0.5	ABC/IA-IR-01
	Angolato		0.5	ABC/IA-IR-31	
	Ø4.5	Non Rotante	Dritto	0.3	ABC/IA-IW-00
Angolato			0.3	ABC/IA-IW-30	
Rotante		Dritto	0.3	ABC/IA-IW-01	
	Angolato	0.3	ABC/IA-IW-31		
<b>Dentsply®</b> Ankylos®	C/X	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/IB-IR-00
			Dritto	2.0	ABC/IB-IR-02
		Rotante	Dritto	1.0	ABC/IB-IR-01
			Dritto	2.0	ABC/IB-IR-03
			Angolato	1.0	ABC/IB-IR-31
<b>Camlog®</b> Camlog®	Ø3.3	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/JA-IN-00
		Rotante	Dritto	1.0	ABC/JA-IN-01
	Ø3.8	Non Rotante	Dritto	0.7	ABC/JA-IR-00
		Rotante	Dritto	0.7	ABC/JA-IR-01
	Ø4.3	Non Rotante	Dritto	0.3	ABC/JA-IW-00
		Rotante	Dritto	0.3	ABC/JA-IW-01
<b>BioHorizons®</b> Tapered Internal	Ø3.5	Non Rotante	Dritto	0.9	ABC/LB-IN-00
			Angolato	0.9	ABC/LB-IN-30
		Rotante	Dritto	0.9	ABC/LB-IN-01
	Angolato		0.9	ABC/LB-IN-31	
	Ø4.5	Non Rotante	Dritto	0.1	ABC/LB-IR-00
			Angolato	0.1	ABC/LB-IR-30
		Rotante	Dritto	0.1	ABC/LB-IR-01
			Angolato	0.1	ABC/LB-IR-31

# Sistema Interface IPD

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.


Compatibilità	Piattaforma	Tipo Connessione	Versione	Altezza (mm)	Codice
<b>Sweden &amp; Martina</b> ® Premium™Kohno®	Ø3.8	Non Rotante	Dritto	0.7	ABC/MB-IN-00
			Angolato	0.65	ABC/MB-IN-30
	Rotante	Dritto	0.7	ABC/MB-IN-01	
		Angolato	0.65	ABC/MB-IN-31	
	Ø4.25	Non Rotante	Dritto	0.7	ABC/MB-IR-00
			Angolato	0.65	ABC/MB-IR-30
Rotante	Dritto	0.7	ABC/MB-IR-01		
	Angolato	0.65	ABC/MB-IR-31		
<b>Phibo</b> ® TSH®	S2	Non Rotante	Dritto	1.0	ABC/NA-IN-00
			Angolato		ABC/NA-IN-30
		Rotante	Dritto	1.0	ABC/NA-IN-01
			Angolato		ABC/NA-IN-31



## Viti TPA & Standard



# Viti TPA



Diametro della testa 2.3 mm  
eccetto ABC/AA-TW-50

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.



CODICE	COMPATIBILITA'	PIATTAFORMA	BATTUTA	TESTA DIAMETRO	METRICA	TESTA (L1)	CORPO (L2)	TOTALE (LT)	CHIAVE UTENSILE	TORQUE
ABC/AA-TN-50	Nobel Biocare® Branemark System®	Ø3.5	70°	2.3	M1.6x0.35	2.08	4.72	6.8	TPA	20
	Nobel Biocare® Nobel Active®	Ø3.5								
ABC/AA-TR-50	Nobel Biocare® Branemark System®	Ø4.1	75°	2.3	M2x0.4	2.02	3.78	5.8	TPA	20
	Sweden & Martina® Outlink®	Ø4.1								
	Phibo® TSH®	S3-S4								
ABC/AA-TR-52	Nobel Biocare® Branemark System®	Ø4.1	Plano	2.3	M2x0.4	1.4	4.4	5.8	TPA	25
	Biomet® 3I® Externa™ 3I®	Ø3.25 / Ø4.1 / Ø5.1								
	Bti® Hexágono externo	Ø4.1 / Ø5.5								
ABC/AA-TW-50	Nobel Biocare® Branemark System®	Ø5.1	72°	2.85	M2.5x0.45	1.61	4.8	6.41	TPA	25
ABC/AB-TR-50	Multi-unit	Ø4.8	Piatto	2.3	M1.4x0.3	1.5	2.1	3.6	TPA	15
ABC/AC-TN-50	Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	Ø3.5	Piatto	2.25	M1.8x0.35	1.4	6.1	7.5	TPA	25
ABC/AC-TN-51	Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	Ø3.5	Piatto	2.25	M1.8x0.35	1.4	5.4	6.8	TPA	25
ABC/AC-TR-50	Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	Ø4.3 / Ø5.0	Piatto	2.3	M2x0.4	1.4	7.4	8.8	TPA	25
	Astra® OsseoSpeed®	Ø4.5 / Ø5.0								
ABC/AC-TR-51	Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	Ø4.3 / Ø5.0	Piatto	2.3	M2x0.4	1.3	6.6	7.9	TPA	25
ABC/AD-TR-50	Nobel Biocare® Nobel Active®	Ø4.3	75°	2.3	M2x0.4	2.02	4.98	7	TPA	25
ABC/AD-TT-50	Nobel Biocare® Nobel Active®	Ø3.0	70°	2.30	M1.4x0.3	1.99	5.01	7	TPA	15
ABC/BB-TR-51	Biomet® 3I® Certain®	Ø3.4 / Ø4.1 / Ø5.0	Piatto	2.25	M1.6x0.35	1.35	6.25	7.6	TPA	20
ABC/CA-TR-50	Klockner® SK2-NK2	Ø4.2	90°	2.3	M1.8x0.35	1.50	3.00	4.5	TPA	25
ABC/CB-TR-50	Klockner® Essential Cone®	Ø4.5	90°	2.3	M1.8x0.35	1.65	4.85	6.5	TPA	25
ABC/DA-TR-50	Straumann® Tissue Level (SynOcta® level)	Ø4.8 / Ø6.0	90°	2.3	M2x0.4	1.65	3.32	4.97	TPA	25
ABC/DA-TR-51	Straumann® Tissue Level (Implant level)	Ø4.8 / Ø6.0	30°	2.3	M2x0.4	2.65	3.65	6.3	TPA	25
ABC/DB-TR-50	Straumann® Bone Level	Ø3.3 / Ø4.1	30°	2.3	M1.6x0.35	2.15	5.55	7.7	TPA	20
ABC/EA-TN-50	Astra® OsseoSpeed®	Ø3.0	120°	2.25	M1.4x0.35	1.65	5.45	7.1	TPA	15
ABC/EA-TR-50	Astra® OsseoSpeed®	Ø3.5 / Ø4.0	Piatto	2.3	M1.6x0.35	1.50	6.30	7.8	TPA	20
ABC/EA-TR-51	Astra Uni 20° / 45°	Tutti	Piatto	2.3	M1.4x0.3	1.50	2.90	4.4	TPA	15
ABC/EB-TN-50	Astra® Evolution®	Ø3.6	60°	2.3	M1.6x0.35	2.19	5.11	7.3	TPA	20
ABC/EB-TR-50	Astra® Evolution®	Ø4.2	100°	2.3	M1.8x0.35	1.88	5.72	7.6	TPA	25
ABC/FA-TR-50	Zimmer® Screw Vent®	Ø3.5 / Ø4.5 / Ø5.7	140°	2.3	UNF 1-72	1.73	4.97	6.7	TPA	25
ABC/GA-TN-50	Bti® Externa Universal	Ø3.5	Piatto	2.3	M2x0.4	1.5	3.6	5.1	TPA	25
ABC/GB-TR-50	Bti® Interna	Universal® Ø4.1 / Ancha Ø5.5	Piatto	2.3	M1.8x0.35	1.5	5.0	6.5	TPA	25
ABC/HA-TN-50	Microdent® Microdent® System	Ø3.5	140°	2.3	M1.8x0.35	1.59	4.01	5.6	TPA	25
ABC/HA-TR-50	Microdent® Microdent® System	Ø4.2 / Ø5.1	120°	2.3	M2x0.4	1.85	4.15	6	TPA	25
ABC/IA-TR-50	Dentsply® Xive® Friadent®	Ø3.8	90°	2.3	M1.6x0.35	1.66	5.44	7.1	TPA	20
ABC/IB-TR-51	Dentsply® Ankylos®	C/X	60°	2.3	M1.8x0.35	1.82	6.88	8.7	TPA	25
IPD/LB-TR-50	BioHorizons® Tapered Internal	Ø3.0 / Ø3.5 / Ø4.5 / Ø5.7	90°	2.3	M1.8x0.35	1.89	4.61	6.5	TPA	25
IPD/MB-TN-50	Sweden & Martina® Premium™ Kohno®	Ø3.3 / Ø3.8	120°	2.3	M1.8x0.35	1.52	5.08	6.6	TPA	25
IPD/MB-TR-50	Sweden & Martina® Premium™ Kohno®	Ø4.25 / Ø5.0	120°	2.3	M2x0.4	1.55	4.85	6.4	TPA	25

# Viti STANDARD



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.



CODICE	COMPATIBILITA'	PIATTAFORMA	BATTUTA	TESTA DIAMETRO	METRICA	TESTA (L1)	CORPO (L2)	TOTALE (LT)	CHIAVE UTENSILE	TORQUE
ABC/AA-TN-00	Nobel Biocare® Branemark System®	Ø3.5	70°	2.25	M1.6x0.35	2.15	5.15	7.30	Unigrip	35
	Nobel Biocare® Nobel Active®	Ø3.7								
ABC/AA-TR-00	Nobel Biocare® Branemark System®	Ø4.1	75°	2.4	M2x0.4	1.5	5.85	7.35	Unigrip	35
	Nobel Biocare® Nobel Active®	Ø4.3								
ABC/AA-TR-01	Hexágono Externo (Plat. Regular)	Ø4.1	75°	2.5	M2x0.4	1.67	4.6	6.27	Esag. 1.20	20
ABC/AA-TR-02	Nobel Biocare® Branemark System®	Ø4.1	Piatta	2.40	M2x0.4	1.45	5.9	7.35	Unigrip	35
	Nobel Biocare® Nobel Active®	Ø4.3								
ABC/AA-TW-00	Nobel Biocare® Branemark System®	Ø5.1	72°	3.40	M2.5x0.45	1.37	5.33	6.7	Unigrip	35
ABC/AB-TR-00	Multi-unit	Ø4.8	Piatta	2,00	M1.4x0.3	1.35	2.1	3.45	Unigrip	15
ABC/AC-TN-00	Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	Ø3.5	Piatta	2.4	M1.8x0.35	1.8	6.5	8.3	Unigrip	35
ABC/AC-TR-00	Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	Ø4.3 / Ø5.0	Piatta	2.4	M2x0.4	1.55	8.35	9.9	Unigrip	35
ABC/AD-TT-00	Nobel Biocare® Nobel Active®	Ø3.0	70°	1.8	M1.4x0.3	2	5	7	Unigrip	15
ABC/BA-TR-00	Biomet® 3I® Externa™ 3I® (Plat. R)	Ø4.1	75°	2.4	M2x0.4	1.79	5.81	7.6	Esag. 1.20	20
ABC/BA-TR-01	Biomet® 3I® Externa™ 3I® (Plat. R)	Ø4.1	75°	2.4	M2x0.4	1.79	5.81	7.6	Esag. 1.25	35
ABC/BA-TR-02	Biomet® 3I® Externa™ 3I®	Ø3.25/ Ø4.1 / Ø5.0	Piatta	2.4	M2x0.4	1.65	6.15	7.8	Quad. 1.30	35
ABC/BB-TR-01	Biomet® 3I® Certain®	Ø3.4/ Ø4.1 / Ø5.0	Piatta	2,00	M1.6x0.35	1.9	6.5	8.4	Esag. 1.20	20
ABC/BB-TR-02	Biomet® 3I® Certain®	Ø4.1 / Ø5.0	140°	2.30	M1.6x0.35	2.05	6.35	8.4	Esag. 1.20	20
ABC/CA-TR-00	Klockner® SK2-NK2	Ø4.2	90°	2.45	M1.8x0.35	2.39	3.56	5.95	Esag. 1.70	30
ABC/CA-TR-01	Klockner® SK2-NK2	Ø4.2	90°	2.45	M1.8x0.35	0.72	3.58	4.3	Croce	30
ABC/CB-TR-00	Klockner® Essential Cone®	Ø4.5	90°	2.18	M1.8x0.35	2.3	4.9	7.2	Stella	30
ABC/DA-TR-00	Straumann® Tissue Level (SynOcta® level)	Ø4.8	90°	2.4	M2x0.4	1.2	3.3	4.5	Torx	15
ABC/DA-TR-01	Straumann® Tissue Level (Implant level)	Ø4.6 / Ø6.0	30°	2.4	M2x0.4	3.03	3.67	6.7	Torx	35
ABC/DA-TR-02	Straumann® Tissue Level	Ø4.8	Piatta	2.52	M2x0.4	1.45	5.9	7.35	Torx	35
ABC/DA-TR-03	Straumann® Tissue Level	Ø4.8	30°	2.57	M2x0.4	3.05	3.65	6.7	Torx	35
ABC/DB-TR-00	Straumann® Bone Level	Ø3.3 / Ø4.1	30°	2.1	M1.6x0.35	2.31	5.54	7.85	Torx	35
ABC/EA-TN-00	Astra® OsseoSpeed®	Ø3.0	120°	2.1	M1.4x0.3	2	5.5	7.5	Esag. 1.27	15
ABC/EA-TR-00	Astra OsseoSpeed®	Ø3.5 - Ø4.0	Piatta	2.35	M1.6x0.35	1.95	6.3	8.25	Esag. 1.27	20
ABC/EA-TR-01	Astra® Cono 20°	Ø3.5-Ø4.0 / 4.5-Ø5.0	Piatta	2.25	M1.4x0.3	1.85	2.95	4.8	Esag. 1.27	15
ABC/EA-TW-00	Astra OsseoSpeed®	Ø4.5 - Ø5.0	Piatta	2.35	M2x0.4	1.9	8.4	10.3	Esag. 1.27	25
ABC/EB-TN-00	Astra® Evolution®	Ø3.6	60°	2.15	M1.6x0.35	2.12	5.33	7.45	Esag. 1.27	20
ABC/EB-TR-00	Astra® Evolution®	Ø4.2	100°	2.35	M1.8x0.35	1.92	5.70	7.62	Esag. 1.27	20
ABC/FA-TR-00	Zimmer® Screw Vent®	Ø3.5/ Ø4.5 / Ø5.7	140°	2.1	M1.8x0.35	2.54	5.66	8.2	Esag. 1.25	30
ABC/FB-TR-00	Zimmer® SwissPlus®	Ø4.8	140°	2.3	M2x0.4	2.55	6.75	9.3	Esag. 1.25	30
ABC/FB-TR-01	Zimmer® SwissPlus®	Ø4.8	30°	2.4	M2x0.4	3.03	3.87	6.9	Esag. 1.25	30
ABC/GA-TN-00	Bti® Hexágono Externo	Ø3.5	Piatta	2.4	M2x0.4	1.7	3.85	5.55	Esag. 1.20	20
ABC/GA-TW-00	Bti® Hexágono Externo	Ø5.5	Piatta	2.55	M2x0.4	1.7	6.15	7.85	Esag. 1.20	20

# Viti STANDARD



I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.



CODICE	COMPATIBILITA'	PIATTAFORMA	BATTUTA	TESTA DIAMETRO	METRICA	TESTA (L1)	CORPO (L2)	TOTALE (LT)	CHIAVE UTENSILE	TORQUE
ABC/GB-TR-00	Bti® Interna Universal®	Universal® Ø4.1 / Ancha Ø5.5	Piatta	2.4	M1.8x0.35	1.85	5.2	7.05	Esag. 1.20	20
ABC/HA-TN-00	Microdent® Microdent® System	Ø3.5	140°	2.5	M1.8x0.35	2.13	3.87	6	Esag. 1.20	20
ABC/HA-TR-00	Microdent® Microdent® System	Ø4.2 / Ø5.1	120°	2.7	M2x0.4	2.5	5.5	8	Esag. 1.75	30
ABC/IA-TR-00	Dentsply® Xive® Friadent®	Ø3.4 / Ø3.8 / Ø4.5	90°	2.05	M1.6x0.35	2.1	6.75	8.85	Esag. 1.20	25
ABC/IB-TR-00	Dentsply® Ankylos® Balance Base Narrow	C/X	60°	2.4	M1.6x0.35	1.66	3.04	4.7	Esag. 1.0	15
ABC/IB-TR-01	Dentsply® Ankylos®	C/X	60°	2.05	M1.8x0.35	2	6.15	8.15	Esag. 1.0	25
ABC/IB-TR-02	Dentsply® Ankylos®	C/X	120°	2.35	M1.8x0.35	2.65	8.45	11.1	Esag. 1.0	25
ABC/ID-TT-00	Osteoplus® Iridium™ Argentum®	Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.2 / Ø4.8	120°	2.40	M1.8x0.35	1.69	5.83	7.52	Esag. 1.25	25
ABC/JA-TR-00	Camlog® Camlog® Implant System	Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.3	90°	2.1	M1.6x0.35	2.35	8.1	10.45	Esag. 1.25	20
ABC/KA-CI-08	Hollow Screw	-	Piatta	2.8	M2.65x0.3	0.7	1.4	2.1	Croce IPD	10
<b>ABC/LB-TR-00</b>	<b>BioHorizons® Tapered Internal</b>	<b>Ø3 / Ø3.5 / Ø4.5 / Ø5.7</b>	<b>90°</b>	<b>2.40</b>	<b>M1.8x0.35</b>	2.42	<b>4.83</b>	7.25	<b>Esag. 1.27</b>	35
ABC/MB-TN-00	Sweden & Martina® Premium™ Kohno®	Ø3.3 / Ø3.8	120°	2.2	M1.8x0.35	1.78	6.32	8.1	Esag. 1.27	25
ABC/MB-TR-00	Sweden & Martina® Premium™ Kohno®	Ø4.25 / Ø5.0	120°	2.4	M2x0.4	1.78	6	7.78	Esag. 1.27	25
ABC/NA-TN-00	Phibo® TSH®	S2	90°	2.3	M1.8x0.35	2.1	5.55	7.65	Esag. 1.25	25
ABC/NA-TW-00	Phibo® TSH®	S5	120°	2.5	M2x0.4	2.5	5.5	8	Esag. 1.25	25
ABC/WB-TR-00	Megagen® Any Ridge®	Ø4.2	Piatta	2.1	M1.8x0.35	2	6	8	Esag. 1.20	25
ABC/XA-TR-00	Dentium® Implantium®	Ø4.0 / Ø4.5 / Ø5.0	120°	2.3	M2x0.4	2	8.20	10.2	Esag. 1.27	20
ABC/XA-TR-02	Nobel Biocare® Branemark System®	Ø4.1	Piatta	2.52	M2x0.4	1.45	5.9	7.35	Esag. 1.20	30
	Nobel Biocare® Nobel Active®	Ø4.3								
ABC/ZA-TR-00	Bredent® Blue Sky™	Ø3.5 / Ø4.5 / Ø5.5	120°	2.30	M1.8x0.35	2.2	8	10.2	Unigrip Bredent®	25



# Strumenti & Accessori



# Strumenti e Accessori

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## kit dinamometrico



Descrizione	Codici	
	ABC/KT-DI-18	ABC/KT-DI-25
	<b>Lunghezza</b>	
Cacciavite Esagonale 1.20	18 mm	25 mm
Cacciavite Esagonale 1.25	18 mm	25 mm
Cacciavite Esagonale 1.27	18 mm	25 mm
Cacciavite Esagonale 1.70	18 mm	25 mm
Cacciavite Quadrato 1.25	18 mm	25 mm
Cacciavite Unigrip	18 mm	25 mm
Cacciavite a Taglio	18 mm	25 mm
Cacciavite TPA	25 mm	25 mm
Cacciavite Torx	18 mm	25 mm
Cacciavite Multi-unit	20 mm	20 mm
<b>Cricchetto Dinamometrico</b>	<b>90 mm</b>	<b>90 mm</b>

## kit clinico



Descrizione	Codici	
	ABC/KT-MC-18	ABC/KT-MC-25
	<b>Lunghezza</b>	
Cacciavite Esagonale 1.20	18 mm	25 mm
Cacciavite Esagonale 1.25	18 mm	25 mm
Cacciavite Esagonale 1.27	18 mm	25 mm
Cacciavite Esagonale 1.70	18 mm	25 mm
Cacciavite Quadrato 1.25	18 mm	25 mm
Cacciavite Unigrip	18 mm	25 mm
Cacciavite a Taglio	18 mm	25 mm
Cacciavite TPA	25 mm	25 mm
Cacciavite Torx	18 mm	25 mm
Cacciavite Multi-unit	20 mm	20 mm
<b>Impugnatura Studio</b>	<b>16 mm</b>	<b>16 mm</b>

## kit laboratorio



Descrizione	Codici	
	ABC/KT-ML-32	
	<b>Lunghezza</b>	
Cacciavite Esagonale 1.20	32 mm	
Cacciavite Esagonale 1.25	32 mm	
Cacciavite Esagonale 1.27	32 mm	
Cacciavite Esagonale 1.70	32 mm	
Cacciavite Quadrato 1.25	32 mm	
Cacciavite Unigrip	32 mm	
Cacciavite a Taglio	32 mm	
Cacciavite TPA	32 mm	
Cacciavite Torx	32 mm	
<b>Impugnatura Laboratorio</b>	<b>70 mm</b>	

# Strumenti e Accessori

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## 1.20 Cacciavite Esagonale



CODICE	L.
ABC/PH-20-18	18 mm
ABC/PH-20-25	25 mm
ABC/PH-20-32	32 mm

## 1.25 Cacciavite Esagonale



CODICE	L.
ABC/PH-25-18	18 mm
ABC/PH-25-25	25 mm
ABC/PH-25-32	32 mm

## 1.27 Cacciavite Esagonale



CODICE	L.
ABC/PH-27-18	18 mm
ABC/PH-27-25	25 mm
ABC/PH-27-32	32 mm

## 1.70 Cacciavite Esagonale



CODICE	L.
ABC/PH-70-18	18 mm
ABC/PH-70-25	25 mm
ABC/PH-70-32	32 mm

## 1.00 Cacciavite Esagonale



CODICE	L.
ABC/PH-00-18	18 mm
ABC/PH-00-25	25 mm
ABC/PH-00-32	32 mm

## 1.25 Cacciavite Quadrato



CODICE	L.
ABC/PC-25-18	18 mm
ABC/PC-25-25	25 mm
ABC/PC-25-32	32 mm

## Cacciavite Unigrip



CODICE	L.
ABC/PU-00-18	18 mm
ABC/PU-00-25	25 mm
ABC/PU-00-32	32 mm

## Cacciavite a Taglio



CODICE	L.
ABC/PP-00-18	18 mm
ABC/PP-00-25	25 mm
ABC/PP-00-32	32 mm

## Cacciavite Torx



CODICE	L.
ABC/PT-00-18	18 mm
ABC/PT-00-25	25 mm
ABC/PT-00-32	32 mm

# Strumenti e Accessori

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.


## Cacciavite Multi-Unit



CODICE  
ABC/LL-AB-00

L.  
20 mm

## Cacciavite PSD



CODICE  
ABC/LL-PS-00

L.  
25 mm

## Cacciavite Hollow Screw



CODICE  
ABC/KA-CI-09

L.  
26 mm

## Cacciavite TPA



CODICE  
ABC/KA-CT-00  
ABC/KA-CT-01

L.  
25 mm  
32 mm

## Impugnatura Studio



CODICE  
ABC/MC-00-16

L.  
16 mm

## Impugnatura Laboratorio



CODICE  
ABC/ML-00-70

L.  
70 mm

## Cricchetto Dinamometrico



CODICE  
ABC/DI-00-90

L.  
90 mm

## Accessorio PSD



CODICE  
IPD/LL-PS-01

# Condizioni di vendita

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni sono valide esclusivamente tra la Ditta **Biaggini Medical Devices Srl**, con Sede Legale in Via della Repubblica 75 – 19032 Lerici (SP) CF/P. IVA:00704980119 e Sede Amministrativa/Uffici/Magazzini in Via Aurelia Nord 340°B – 19021 Arcola (SP), di seguito convenzionalmente denominata "**Biaggini Medical Devices Srl**" e qualsiasi persona che effettua acquisti online sul sito internet [www.AbumentCompatibili.com](http://www.AbumentCompatibili.com) di seguito denominata "CLIENTE".

I prodotti acquistati sul sito [www.AbumentCompatibili.com](http://www.AbumentCompatibili.com) sono venduti direttamente da **Biaggini Medical Devices Srl**.

Queste condizioni possono essere oggetto di modifiche e la data di pubblicazione delle stesse sul sito equivale alla data di entrata in vigore.

Le presenti condizioni disciplinano gli acquisti effettuati sul sito [www.AbumentCompatibili.com](http://www.AbumentCompatibili.com), conformemente alle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, del Codice del Consumo, D.lgs. n. 206/2005, modificato dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico.

### ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto

Con le presenti condizioni generali di vendita, **Biaggini Medical Devices Srl** vende e il CLIENTE acquista a distanza i beni mobili materiali indicati ed offerti in vendita sul sito [www.AbumentCompatibili.com](http://www.AbumentCompatibili.com). Il contratto si conclude esclusivamente attraverso la rete internet, mediante l'accesso del CLIENTE all'indirizzo [www.AbumentCompatibili.com](http://www.AbumentCompatibili.com) e la realizzazione di un ordine di acquisto secondo la procedura prevista dal sito stesso. Il CLIENTE si impegna a prendere visione, prima di procedere alla conferma del proprio ordine, delle presenti condizioni generali di vendita, in particolare delle informazioni precontrattuali fornite da **Biaggini Medical Devices Srl** e ad accettarle mediante conferma ordine. Nell'email di conferma dell'ordine, il CLIENTE riceverà anche indicazioni per consultare le presenti condizioni generali di vendita, così come previsto dall'art. 51 comma 1 del D.Lgs 206/2005, modificato dal D.Lgs 21/2014. Date le caratteristiche dei prodotti indicati ed offerti in vendita sul sito [www.AbumentCompatibili.com](http://www.AbumentCompatibili.com), il CLIENTE con la compilazione e la conferma dell'ordine di acquisto, dichiara di essere un Professionista/Operatore del settore dentale (Odontoiatra, Medico Chirurgo, Odontostomatologo, Odontotecnico...) assumendosi ogni responsabilità in merito a dichiarazioni mendaci ed in merito alla veridicità e correttezza dei dati fiscali forniti per la conclusione della procedura di vendita (lavorazione dell'ordine, emissione dei documenti fiscali, spedizione dei beni tramite corriere, pagamento dei beni).

### ARTICOLO 2 - Informazioni precontrattuali per il consumatore - art. 49 del D.Lgs 206/2005

Il CLIENTE prima della conclusione del contratto di acquisto, prende visione delle caratteristiche dei beni che vengono illustrate nelle singole schede prodotto al momento della scelta. Prima della conclusione del contratto di acquisto e prima della convalida dell'ordine il CLIENTE è informato relativamente a: Il prezzo totale dei beni comprensivo delle imposte di legge, con il dettaglio delle spese di spedizione e ogni altro eventuale costo aggiuntivo; Le modalità di pagamento; Il termine entro il quale **Biaggini Medical Devices Srl** si impegna a consegnare la merce; Le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso (art. 6 delle presenti condizioni) nonché modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B del D.Lgs 21/2014; Le informazioni relative alle modalità di restituzione dei beni oggetto del contratto, con avviso che il CLIENTE dovrà sostenere i costi della restituzione dei beni in caso di recesso; L'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni acquistati; Le condizioni di assistenza post vendita; Il CLIENTE può in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del contratto, prendere conoscenza delle informazioni relative a **Biaggini Medical Devices Srl**, l'indirizzo geografico, numero di telefono e fax, indirizzo di posta elettronica, informazioni che vengono riportate, anche di seguito:

#### Biaggini Medical Devices Srl

Via Aurelia Nord 340A/B • 19021 Arcola (SP) • Tel. (+39) 0187 509772-509575-503186 • Fax. (+39) 0187 599076 • [biaggini@biaggini.it](mailto:biaggini@biaggini.it) • [biaggini@pec.biaggini.it](mailto:biaggini@pec.biaggini.it)

### ARTICOLO 3 - Conclusione ed efficacia del contratto

Il contratto di vendita è considerato concluso con l'invio da parte di **Biaggini Medical Devices Srl** al CLIENTE di un'email di conferma dell'ordine. L'email di conferma dell'ordine contiene i dati del CLIENTE, il numero e la data dell'ordine, il prezzo della merce acquistata, le spese di spedizione e l'indirizzo di consegna al quale sarà inviata la merce e l'indicazione per consultare le presenti condizioni generali di vendita. Il CLIENTE si impegna a verificare la correttezza dei dati personali fiscali e commerciali forniti con la compilazione dell'ordine, che sono replicati nell'email di conferma dell'ordine. Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente ad **Biaggini Medical Devices Srl** eventuali errori, variazioni, correzioni. **Biaggini Medical Devices Srl** si impegna a descrivere e presentare gli articoli venduti sul sito nel miglior modo possibile. Ciononostante potrebbero evidenziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra il sito e il prodotto reale. Le fotografie ed i disegni dei prodotti presentati sul sito [www.AbumentCompatibili.com](http://www.AbumentCompatibili.com) non costituiscono elemento contrattuale in quanto solo rappresentativi. **Biaggini Medical Devices Srl** si impegna a consegnare la merce entro 30 giorni decorrenti dall'invio dell'email di conferma d'ordine al CLIENTE. I prodotti ordinati ed acquistati dal Cliente sono destinati esclusivamente al Paese/Nazione indicato sull'ordine. **Biaggini Medical Devices Srl** declina ogni responsabilità nel caso in cui il CLIENTE decida di immettere i prodotti ordinati ed acquistati in un Paese/Nazione diverso.

### ARTICOLO 4 - Disponibilità dei prodotti

La disponibilità dei prodotti si riferisce alla disponibilità effettiva nel momento in cui il CLIENTE effettua l'ordine. La disponibilità dei prodotti deve comunque essere considerata puramente indicativa perché, per effetto della contemporanea presenza sul sito di più utenti, i prodotti potrebbero essere venduti ad altri CLIENTI prima della conferma dell'ordine. Anche in seguito all'invio dell'email di conferma dell'ordine inviata da **Biaggini Medical Devices Srl**, potrebbero verificarsi casi di indisponibilità parziale o totale della merce. In questa eventualità, l'ordine verrà rettificato automaticamente con l'eliminazione del prodotto non disponibile e il CLIENTE verrà immediatamente informato via email.

### ARTICOLO 5 - Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento possibili sono: Contrassegno. Pagabile al Corriere che effettua la consegna, in contanti oppure con assegno bancario "Non trasferibile" intestato a **Biaggini Medical Devices Srl**;

Bonifico bancario anticipato da effettuarsi su

Banco Popolare Filiale di Arcola (SP) • ABI 05034 - CAB 49680 - CIN M - C/C 000000000039 • IBAN: IT57 M 05034 49680 000000000039 • BIC/SWIFT: BAPPIT22

Intestato a

**Biaggini Medical Devices Srl** • Via Aurelia Nord 340A/B • 19021 Arcola (SP)

Resta inteso che l'evasione degli ordini per i quali il CLIENTE ha scelto il pagamento con bonifico bancario anticipato, sarà subordinata al ricevimento della contabile bancaria recante numero di CRO.

# Condizioni di vendita

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

## ARTICOLO 6 - Prezzi

Tutti i prezzi di vendita dei prodotti indicati sono espressi in Euro e sono IVA esclusa. I costi di spedizione non sono compresi nel prezzo d'acquisto, ma sono indicati e calcolati al momento della conclusione del processo di acquisto prima dell'effettuazione del pagamento. Il CLIENTE accetta la facoltà di **Biaggini Medical Devices Srl** di modificare i suoi prezzi in qualsiasi momento, tuttavia la merce sarà fatturata sulla base dei prezzi indicati sul sito al momento della creazione dell'ordine e indicati nell'email di conferma inviata da **Biaggini Medical Devices Srl** al CLIENTE. In caso di errore informatico, manuale, tecnico, o di qualsiasi altra natura che possa comportare un cambiamento sostanziale, non previsto da **Biaggini Medical Devices Srl**, del prezzo di vendita indicato sul sito, che lo renda esorbitante o chiaramente irrisorio, l'ordine d'acquisto sarà considerato non valido e annullato e l'importo eventualmente versato dal CLIENTE sarà rimborsato entro 14 gg. dal giorno dell'annullamento.

## ARTICOLO 7 - Diritto di recesso e resi

Conformemente alle disposizioni di legge in vigore, il CLIENTE ha diritto di recedere dall'acquisto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni decorrenti dalla data di ricezione dei prodotti. Il CLIENTE che intende esercitare il diritto di recesso dovrà preventivamente comunicarlo a **Biaggini Medical Devices Srl** tramite dichiarazione esplicita, che potrà essere trasmessa a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica. Il CLIENTE potrà esercitare il diritto di recesso anche inviando una qualsiasi dichiarazione esplicita contenente la decisione di recedere dal contratto oppure alternativamente trasmettere il modulo di recesso tipo, di cui all'Allegato I, parte B, D.Lgs 21/2014 (non obbligatorio) il cui testo viene di seguito riportato: Modulo di recesso tipo ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. h) (compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto) Spettabile **Biaggini Medical Devices Srl** Con la presente io/noi (\*) notifico/notifichiamo (\*) il recesso dal mio/nostro (\*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (\*): - Ordinato il (\*)/ricevuto il (\*) - Nome del/dei consumatore(i) - Indirizzo del/dei consumatore(i) - Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è inviato in versione cartacea) - Data. In caso di esercizio del diritto di recesso, il CLIENTE è tenuto a restituire i beni entro 14 giorni dal giorno in cui ha comunicato a **Biaggini Medical Devices Srl** la propria volontà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 206/2005. I prodotti dovranno essere restituiti non utilizzati, integri, non danneggiati, nella confezione originale, completi in tutte le loro parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ecc.) e completi della documentazione fiscale annessa. **Biaggini Medical Devices Srl** si riserva la facoltà di accreditare e rimborsare ad un valore inferiore rispetto al valore di acquisto da parte del CLIENTE quanto reso, nel caso in cui le condizioni di cui sopra non siano rispettate. Fatta salva la facoltà di verificare il rispetto di quanto sopra, **Biaggini Medical Devices Srl** provvederà a rimborsare l'importo dei prodotti oggetto del recesso entro un termine massimo di 14 giorni. I prodotti dovranno essere rispediti a: **Biaggini Medical Devices Srl** • Via Aurelia Nord 340A/B • 19021 Arcola (SP) che si impegna a verificare e valutare le condizioni dei beni resi, accreditando al CLIENTE quanto dovuto con l'emissione di regolare documento contabile (i.e. Nota di Accredito). I costi diretti della restituzione dei prodotti sono a totale carico del CLIENTE, salvo espresso esonero da parte di **Biaggini Medical Devices Srl**, ed alla ulteriore condizione che il CLIENTE si avvalga di Corriere indicato da **Biaggini Medical Devices Srl**. Come previsto dall'art. 56 comma 3 del D.Lgs 206/2005, modificato dal D.Lgs 21/2014, **Biaggini Medical Devices Srl** può sospendere il rimborso fino al ricevimento dei beni oppure fino all'avvenuta dimostrazione da parte del CLIENTE di aver rispedito i beni a **Biaggini Medical Devices Srl**. **Biaggini Medical Devices Srl** eseguirà il rimborso con bonifico bancario e qualora il CLIENTE intenda esercitare il proprio diritto di recesso, dovrà fornire a **Biaggini Medical Devices Srl**, le coordinate bancarie complete: IBAN, SWIFT e BIC e tutti gli altri dati ritenuti necessari all'effettuazione del rimborso.

## ARTICOLO 8 - Garanzia legale di conformità

In caso di ricezione di prodotti non rispondenti all'uso previsto o difettosi, il CLIENTE ha diritto al ripristino senza spese della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione del prodotto. Il CLIENTE può esercitare tale diritto se il difetto si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene e denuncia il difetto a **Biaggini Medical Devices Srl** entro due mesi dalla scoperta.

## ARTICOLO 9 Assistenza ed assistenza post-vendita

Per l'assistenza e per l'assistenza post-vendita il CLIENTE può rivolgersi a:

### Biaggini Medical Devices Srl

Via Aurelia Nord 340A/B • 19021 Arcola (SP) • Tel. (+39) 0187 509772-509575-503186 • Fax. (+39) 0187 599076 • [biaggini@biaggini.it](mailto:biaggini@biaggini.it) • [biaggini@pec.biaggini.it](mailto:biaggini@pec.biaggini.it)

## ARTICOLO 10 - Modalità di consegna e documenti fiscali

I prodotti ordinati saranno consegnati tramite corriere espresso all'indirizzo indicato dal CLIENTE al momento dell'ordine entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricezione da parte del CLIENTE dell'email di conferma ordine inviata da **Biaggini Medical Devices Srl**. Per ogni ordine evaso è emessa idonea documentazione fiscale (DDT oppure fattura accompagnatoria) in accompagnamento alla merce spedita. La documentazione fiscale emessa riporta le informazioni fornite dal CLIENTE durante la procedura di acquisto. Dopo l'emissione della fattura, non sarà possibile apportare alcuna modifica ai dati indicati nella stessa.

## ARTICOLO 11 - Responsabilità

**Biaggini Medical Devices Srl** non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito, anche ove dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet, nel caso in cui non riesca a dare esecuzione all'ordine nei tempi previsti dal contratto. Il CLIENTE ha diritto di accedere al sito per la consultazione e l'effettuazione degli acquisti. Non è consentito alcun altro utilizzo, in particolare commerciale, del sito o del suo contenuto.

*Come già chiaramente indicato anche sul sito: I marchi citati e i rispettivi loghi non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i loghi e marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti compatibili.*

## ARTICOLO 12 - Integralità

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono costituite dalla totalità delle clausole che le compongono. Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita è considerata non valida o dichiarata tale ai sensi della legge, della regolamentazione o in seguito a una decisione da parte di un tribunale avente giurisdizione, le altre disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.

## ARTICOLO 13 - Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana. Ogni controversia che non trova soluzione amichevole sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di La Spezia. In ogni caso, è possibile ricorrere facoltativamente alle procedure di mediazione di cui al D.Lgs 28/2010 e succ.mod., per la risoluzione di eventuali controversie insorte nell'interpretazione e nell'esecuzione delle presenti condizioni di vendita.

## IMMAGINI E DESCRIZIONI PRODOTTI

Le immagini dei prodotti sono da considerarsi puramente illustrative e non vincolanti, potrebbero subire variazioni in base a differenti esigenze produttive.



# Listino Prezzi

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.

	<b>Analogo da Gesso</b> <i>Comprensivo di vite</i>	€ 21. <sup>00</sup>		<b>Vite in Titanio</b>	€ 12. <sup>00</sup>
	<b>Incollaggio NR</b> <i>Comprensivo di vite in titanio</i>	€ 35. <sup>00</sup>		<b>Incollaggio R</b> <i>Comprensivo di vite in titanio</i>	€ 35. <sup>00</sup>
	<b>Asse Dinamico NR</b> <i>Comprensivo di vite TPA</i>	€ 40. <sup>00</sup>		<b>Asse Dinamico R</b> <i>Comprensivo di vite TPA</i>	€ 40. <sup>00</sup>
	<b>Cromo Cobalto NR</b> <i>Comprensivo di vite in titanio</i>	€ 50. <sup>00</sup>		<b>Cromo Cobalto R</b> <i>Comprensivo di vite in titanio</i>	€ 50. <sup>00</sup>
	<b>Asse Dinamico 360° CoCr NR</b> <i>Comprensivo di vite TPA</i>	€ 50. <sup>00</sup>		<b>Asse Dinamico 360° CoCr R</b> <i>Comprensivo di vite TPA</i>	€ 50. <sup>00</sup>
	<b>Calcinabile NR</b> <i>Comprensivo di vite in titanio</i>	€ 19. <sup>00</sup>		<b>Calcinabile R</b> <i>Comprensivo di vite in titanio</i>	€ 19. <sup>00</sup>
	<b>Moncone Angolato</b> <i>Comprensivo di vite in titanio</i>	€ 45. <sup>00</sup>		<b>Moncone Dritto</b> <i>Comprensivo di vite in titanio</i>	€ 35. <sup>00</sup>
	<b>Moncone di Guarigione</b>	€ 21. <sup>00</sup>		<b>Transfer da Impronta</b> <i>Comprensivo di vite in titanio</i>	€ 40. <sup>00</sup>
	<b>Moncone Provvisorio NR</b> <i>Comprensivo di vite in titanio</i>	€ 35. <sup>00</sup>		<b>Moncone Provvisorio R</b> <i>Comprensivo di vite in titanio</i>	€ 35. <sup>00</sup>
	<b>Multi Unit Dritto</b>	€ 40. <sup>00</sup>		<b>Multi Unit 17° - 30°</b> <i>Comprensivo di vite in titanio</i>	€ 73. <sup>00</sup>
	<b>Vite TPA</b>	€ 15. <sup>00</sup>			

# Listino Prezzi

I marchi citati non sono di proprietà di Biaggini Medical Devices Srl né di aziende ad essa collegate. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari e vengono citati solo per semplificare la ricerca dei prodotti.



## PSD compatibile Locator®

Non comprensivo  
di cappette ritentive € 50.<sup>00</sup>

## Ricambio in titanio PSD



1x Cuffia in titanio  
Ricambio PSD € 7.<sup>00</sup>




Analogo da Gesso PSD  
€ 21.<sup>00</sup>



PSD per barre filetto M2  
2x Pz. Non comprensivo  
di cappette ritentive € 63.<sup>00</sup>



Scan Abutment  
Comprensivo  
di anello di ancoraggio € 32.<sup>00</sup>



Driver speciali  
TPA, PSD, Multi Unit  
e Anello di ancoraggio € 50.<sup>00</sup>



Impugnatura per C.A.  
Adattatore da contrangolo  
a manuale € 34.<sup>00</sup>



Strumento Utilità PSD  
Strumento multifunzione € 71.<sup>00</sup>



## Kit ritenzioni PSD

1x Titanio, Soft, Medium,  
Hard, Laboratorio € 21.<sup>00</sup>

## Ricambio ritenzioni PSD



8x Ritenzioni in plastica  
Ricambio PSD € 25.<sup>00</sup>

## Transfer da Impronta PSD



8x Transfer da Impronta  
€ 98.<sup>00</sup>

## Anello di Ancoraggio IPD



€ 12.<sup>00</sup>



Calcinabile per Incollaggio  
Per monconi da incollaggio € 12.<sup>00</sup>



Driver per viti in titanio  
Torx, UniGrip e Esagono  
1,20-1,25-1,27 € 23.<sup>00</sup>



Cricchetto Dinamometrico  
Cricchetto dinamometrico C.A.  
Torque 0-40 N/cm. € 198.<sup>00</sup>